



DZP.281.89A.2024

Katowice 12.11.2024r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

*Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych*

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Część 33

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr 33 w poz. 1 żel o poniższym składzie w 100 g:

- Pure water
- Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose
- 2g Lidocaine Hydrochloride
- 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %
- 0.02g Methyl Hydroxybenzoate
- 0.02g Propyl Hydroxybenzoate

pojemność 11g (11 ml) w ampułko-strzykawce ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, nie określa dodatkowych parametrów.

2 PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 49 zestawu do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) wyposażonego w przetwornik z linią płuczącą z przesuwaną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50-60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami przytóżkowymi poprzez przewód z wtykiem typu „RJ”. Dodatkowo w zestawie zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej składający się z komory pomiarowej (bez wew. komór wstępnych i pośrednich) o dokładności pomiaru min. 1 ml do 20 ml i pojemności 500 ml z przezroczystymi ściankami ułatwiającymi dokładny odczyt i wizualizację moczu, workiem o pojemności 2 l, filtr hydrofobowy w komorze i worku, drenu z odpowietrzaniem o dł. 150 cm ze spiralą antyzatamianową, portu bezigłowego do pobierania próbek moczu w łączniku, uniwersalny system moczujący, do 7 dni u pacjenta, sterylne.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, nie określa dodatkowych parametrów.

3 PYTANIE

dotyczy części 25, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze CH6-CH20, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ? Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,25

4 PYTANIE

Dotyczy części 53

Czy Zamawiający w Część 53 – Noże, paski fluoresceinowe, kaniule mógłby wydzielić do osobnych części pozycje nr 1 Paski fluoresceinowe stosowane do diagnostyki zaburzeń filmu łzowego, pozycje 2,3,4,5 oraz pozycje 6,7,8? Wydzielenie pozwoliłoby na złożenie ofert większej liczbie kontrahentów i uzyskanie korzystniejszej ceny ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji do osobnej części



5 PYTANIE

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

c) w wysokości **0,5%** wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach określonych w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, niezależnie od obowiązku pokrycia przez Wykonawcę różnicy pomiędzy ceną zakupu zastępczego i ceną przetargową;

d) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.

e) w wysokości **500,00 zł (pięćset złotych 00/100)** za każdy przypadek, kiedy Wykonawca nie dokona zapłaty lub dokona nieterminowo zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w art. 439 ust 5 ustawy PZP

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

6 PYTANIE

Pakiet 13, poz. 1

Jednorazowy system ssania i płukania do zabiegów laparoskopowych z końcówką roboczą o średnicy 5 mm dł.33 cm z dwoma przyciskami do ssania i płukania z uchwytem wzdużnym?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,13

7 PYTANIE

Pakiet 13, poz. 2

Trokar optyczny o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, długość 100 mm, kaniula z automatycznym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonu oraz dysku retencyjnego o właściwościach hemostatycznych, Podwójny system uszczelek; oraz trokar o długość 110 mm, kaniula z atraumatycznym żebrowaniem, do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza częściowe rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,13

8 PYTANIE

Pakiet 13, poz. 3

Trokar optyczny o średnicy 5 mm, długość 100 mm, kaniula z automatycznym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonu oraz dysku retencyjnego o właściwościach hemostatycznych. Podwójny system uszczelek, oraz trokar z atraumatycznym żebrowaniem o średnicy 5 mm, długość 75 mm, podwójny system uszczelek

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza częściowe rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,13

9 PYTANIE

Dotyczy: DZP.281.89A.2024 część 75 pozycja 1

Czy Zamawiający w części 75 poz.1 dopuści postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.



10 PYTANIE

Dotyczy: DZP.281.89A.2024 część 75 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Link do filmu instruktażowego poniżej: <https://www.youtube.com/watch?v=N8qqokL9bW4>

Prezentacja: <https://www.youtube.com/watch?v=k6WKKpBTiol>

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu, zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania

11 PYTANIE

Pytanie do pakietu nr 4 System śrub i płytek

Czy Zamawiający dopuści śrubokręt manualny wielokrotnego użytku?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,4

12 PYTANIE

Pytanie do pakietu nr 4 System śrub i płytek

Czy Zamawiający dopuści zestaw QuikFlap AXS UN3 sterylny (3x53-34212, 6x56-15934): płytka prosta 2 otwory z odrywającym uchwytem, profil 0.4mm (3szt.) + wkręt kostny AXS 1.5x4mm samowierzący (6szt.)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,4

13 PYTANIE

Pytanie do pakietu nr 4 System śrub i płytek

Czy Zamawiający dopuści zestaw QuikFlap AXS UN3 sterylny (2x53-34212, 53-34520, 10x56-15934): płytka do otworu 20mm z odrywającym uchwytem, profil 0.4mm (1szt.) + płytka prosta 2 otwory z odrywającym uchwytem, profil 0.4mm (2szt.) + wkręt kostny AXS 1.5x4mm samowierzący (10szt.)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,4

14 PYTANIE

Pytania do Części 69 - Porty naczyniowe

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści porty w całości wykonane z tworzywa wysokosprawnego- korpus portu i element ustalający są wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczonego do implantów medycznych (polisulfon), z cewnikiem 6F i przewodnikiem 7 Fr z zestawem do implantacji?



ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ


15 PYTANIE

Pakiet nr 69

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga portów naczyniowych z komorą wykonaną z tytanu. W ostatnim czasie pojawiły się na polskim rynku porty z komorą wykonaną z plastiku. Dystrybutor nazywa ten materiał „wysokosprawnym tworzywem o wytrzymałości tytanu”. Jest to oczywiście wprowadzanie w błąd Zamawiających, ponieważ producent we wszystkich materiałach pisze wprost, że komora jest wykonana z plastiku. Porty z komorą plastikową są niżej pozycjonowane niż porty z komorą tytanową i przeznaczone są na mniej



zamożne rynki, gdzie cena jest znacznie ważniejsza od jakości. Poniżej przykładowe zdjęcie komory tytanowej oraz plastikowej po wielokrotnym nakłuciu igłą.

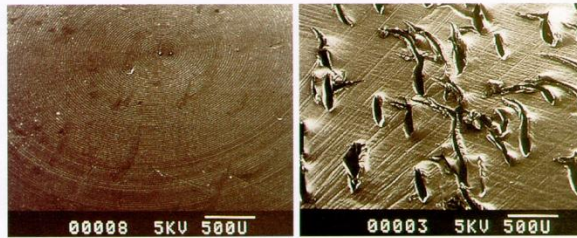

Fondo di camera in titanio (SN) e in plastica (DX) dopo uso ripetuto (30X)

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

16 PYTANIE

Część 20, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawkę na podstawie oświadczenia producenta strzykawkę o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu pompy należy używać strzykawkę. Oznaczenie takie znajduje się również na każdym opakowaniu jednostkowym strzykawkę

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

17 PYTANIE

Część 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe z drenem o długości 200 cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

18 PYTANIE

Część 25, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 50-60cm.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ (zakres 50-60 cm mieści się w parametrach opisanych w SWZ)

19 PYTANIE

Część 25, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z PCV z drenem 200cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,25

20 PYTANIE

Część 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z trójpłaszczyznowym uniwersalnym ostrym kolcem gwarantującym szczelne i pewne połączenie z pojemnikami.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,28

21 PYTANIE

Część 36, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z tłokiem w kontrastującym kolorze niebieskim.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,36



22 PYTANIE

Część 36, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z rozszerzeniem 10-12ml, 20-24ml, 2-3ml.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,36

23 PYTANIE

Część 36, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe bez rozszerzenia pozostałe wymagania zgodne z SWZ

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze ZMIENIONYM Załącznikiem 4,36

24 PYTANIE

Część 36, poz. 1,3,4

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie w formularzu asortymentowo cenowym strzykawek dwuczęściowych 10ml, 2ml, 5ml na opakowania po 100 sztuk

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu , zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania.

25 PYTANIE

Część 36, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie w formularzu asortymentowo cenowym strzykawek dwuczęściowych 20ml na opakowania po 50 sztuk.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu , zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania.

26 PYTANIE

Część 36, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie w formularzu asortymentowo cenowym strzykawek dwuczęściowych 20ml na opakowania po 80 sztuk.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu , zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania.

27 PYTANIE

Część 36, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny, których identyfikacja jest po nazwie handlowej, nie posiada numeru katalogowego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

28 PYTANIE

Czy Zamawiający w części nr 13 pozycja 2 dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, o długości 100 mm, kaniuła żebrowana oraz gładka z systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika oraz dysku mocującego. W przypadku kaniul z balonem informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Wyraźne, liczbowe oznaczenie średnicy umieszczone na obturatorze i kaniuli, podwójny system uszczeltek; Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,13



29 PYTANIE

Czy Zamawiający w części nr 13 pozycja 3 dopuści jednorazowy trokar optyczny o średnicy 5 mm, o długości 100 mm, kaniula żebrowana oraz gładka z systemem fiksacji w powłokach przy pomocy balonika oraz dysku mocującego. W przypadku kaniul z balonem informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli. Wyraźne, liczbowe oznaczenie średnicy umieszczone na obturatorze i kaniuli, podwójny system uszczelek; Do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,13

30 PYTANIE

Pytanie 1 do Pakietu 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowy obwód oddechowy typu rura dzielona na pół (tzw. podwójne D) sterylny lub czysty biologicznie dla dorosłych. Długość obwodu 3 m, dodatkowa rura rozciągalna 1,5 m, worek 2l.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,35

31 PYTANIE

Dotyczy Pakiet 64.

Czy Zamawiający dopuści Pierścień do mechanicznego rozszerzenia źrenicy w czasie operacji zaćmy wstępnie załadowany do jednorazowego injektora, wykonany z jednolitego, niebieskobarwionego polipropylenu w kształcie kwadratu z bezpiecznymi zaokrągleniami i otworami w narożnikach, średnica pierścienia 6,25 mm ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

32 PYTANIE

Dotyczy Pakietu 82 - Sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3 – prosimy o zgodę na zaoferowanie probówek do OB, które nie są kompatybilne z aparatem Sedi-40, ale są kompatybilne ze statywami z pozycji nr 22

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu Zmieniony Załącznik 4,82

33 PYTANIE

Dotyczy Pakietu 82 - Sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 7: prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzenie opisanego audytu przy użyciu papierowych formularzy, które zawierają wszystkie istotne punkty procesu przedanalizy i spełniają tak samo dobrze swoją funkcję, jak aplikacja mobilna. Dane z formularzy są opracowywane statystycznie i przedstawiane w raporcie.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu Zmieniony Załącznik 4,82

34 PYTANIE

Dotyczy Pakietu 82 - Sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. 8: prosimy o dopuszczenie uchwytów, na których znajduje się albo logo producenta albo nazwa systemu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu Zmieniony Załącznik 4,82

35 PYTANIE

Dotyczy Pakietu 82 - Sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej Prosimy o ujednoczenie wymogów z: Punktu 5 Opisu przedmiotu zamówienia oraz §2 pkt. 17 Umowy, dotyczących możliwości dostarczenia kart charakterystyki produktu niebezpiecznego w języku polskim lub języku angielskim.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki produktu niebezpiecznego zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,82



36 PYTANIE

Czy Zamawiający wydzieli z części 13 do odrębnego pakietu i dopuści?

Poz. 2

Trokar optyczny o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, długość 100 mm, kaniula z automatycznym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy atraumatycznej kotwiczki oraz dysku retencyjnego o właściwościach hemostatycznych, Zintegrowany filtr gazów. Podwójny system uszczelek.

Poz. 3

Trokar optyczny o średnicy 5 mm, długość 100 mm, kaniula z automatycznym systemem fiksacji w powłokach przy pomocy atraumatycznej kotwiczki oraz dysku retencyjnego o właściwościach hemostatycznych. Zintegrowany filtr gazów. Podwójny system uszczelek

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji do osobnej części.

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze Zmienionym Załącznikiem 4,13

37 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w części 37?

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zastonową. Wykonaną z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry: szerokość 1,1 cm (+/-1mm), długość 45cm, grubość min 0,34 mm, gramatura 45g/m², wielkość porów 1x1,25 mm. Taśma w plastikowej dwuczęściowej ostonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty oferujemy bezpłatne użyczenie 4 narzędzi wielorazowych do implantacji taśm, do wyboru Zamawiającego. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, rozwiązania opisanego w pytaniu nie dopuszcza.

38 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w części 41?

System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet

Parametry:

System całkowicie jednorazowy, sterylny

Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:

szerokość – 1,2 cm wypustka w środkowej części, ramiona 0,8 cm, grubość - 0,34 mm, gramatura - 45g/m²

Laserowo zgrzewane brzegi taśmy

Implantacja z dostępu przez otwory zastonione w technice out-in oraz in-out

W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty oferujemy bezpłatne użyczenie 4 narzędzi wielorazowych do implantacji taśm, do wyboru Zamawiającego. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, rozwiązania opisanego w pytaniu nie dopuszcza.

39 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w części 42?

Poz. 1,2

System do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej ostonce, dł. ramion od 18,5-20 cm z każdej strony, do wyboru 4 rozmiary korpusu: o wysokości 5 cm, 6 cm, 7,5 cm, 9 cm do wyboru Zamawiającego; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm.

W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty oferujemy bezpłatne użyczenie 2 narzędzi wielorazowych do implantacji taśm, do wyboru Zamawiającego. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.

Implantacja za pomocą kotwic z tworzywa sztucznego w przypadku nieprawidłowej implantacji (zawsze mogące się zdarzyć niezamierzone powikłania pooperacyjne) i następowe pooperacyjne bóle u pacjentki = brak technicznych możliwości usunięcia takiego implantu.

Proponowane przez nas implanty kotwiczone za pomocą nici, w przypadku nieprawidłowego umieszczenia, są możliwe do łatwego usunięcia u pacjentki.



ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, rozwiązania opisanego w pytaniu nie dopuszcza.

40 PYTANIE

Czy Zamawiający wydzieli z części 44 do odrębnego pakietu pozycję nr 1 lub dopuści w tej części w pozycji nr 2 i 3?

System do naprawy dna miednicy mniejszej

Siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami.

Ramiona zakończone żytkami w różnych kolorach


-Wysokość: 9,1 cm

- Szerokość: 4/6 cm

- Porowatość średnia: 55-60%

- Gramatura 45g/m²

- Grubość: 0,34mm



W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty oferujemy bezpłatne użyczenie 2 narzędzi wielorazowych do implantacji taśm, do wyboru Zamawiającego. Użycie narzędzi wielorazowych oszczędza środowisko poprzez zmniejszenie produkcji odpadów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, rozwiązania opisanego w pytaniu nie dopuszcza

41 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w części 45?

Aspirator ssący do biopsji endometrium. Długość całkowita 28 cm, średnica zewn. ok 3,5 mm, średnica wewnętrzna ok. 2,5. Posiada 4 boczne otwory o średnicy ok 2,1. Oznaczony skalą 4-20 cm. Ruchomy wewnętrzny tłok.

Ze względu na to, iż zabieg przeprowadzany jest najczęściej bez USG, wymaga większej dokładności w umieszczeniu go w badanej okolicy, w związku z tym użycie 4-otworowego aspiratora daje gwarancję większej precyzji w pobraniu materiału z endometrium.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądaný efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik - dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, rozwiązania opisanego w pytaniu nie dopuszcza

42 PYTANIE

Dotyczy części 80 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby igły były zakończone trokarowym ostrzem?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga aby igły były zakończone trokarowym ostrzem. W załączeniu zmieniony załącznik 4,80

43 PYTANIE

Dotyczy części 80 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby igły posiadały obrotowy nóż tnący?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga aby igły posiadały obrotowy nóż tnący. W załączeniu zmieniony załącznik 4,80



44 PYTANIE

Dotyczy części 80 poz. 1

Czy zamawiający wymaga aby system umożliwił ustawienie rozmiaru okna tnącego igły w zakresie 4 różnych rozmiarów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dokonuje zmiany opisu w Załączniku 4,80/ Tabela nr 2
W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,80

45 PYTANIE

Dotyczy części 80 poz. 2

Czy zamawiający wymaga aby oprócz wymiennych pojemników próżniowych była możliwość zastosowania również wielorazowego pojemnika próżniowego?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wymaga rozwiązania opisanego w pytaniu.

46 PYTANIE

Dotyczy części 80 tabela 2.

Czy zamawiający wymaga by system umożliwił ustawienie kilku poziomów siły podciśnienia w zakresie od 15kPa do 80kPa?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dokonuje zmiany opisu w Załączniku 4,80/ Tabela nr 2
W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,80

47 PYTANIE

Dotyczy części 80 tabela 2.

Czy zamawiający wymaga by system umożliwił stałe włączenie podciśnienia, które pozostaje włączone niezależnie od procesu wycinania, pobierania i transportu biopłatów do koszyka?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dokonuje zmiany opisu w Załączniku 4,80/ Tabela nr 2
W załączeniu ZMIENIONY Załącznik 4,80

48 PYTANIE

Część 37

Czy Zamawiający zgodzi się na taśmę 26g/m², o szerokości 1,1 cm, porowatości 0,6mm², grubości 0,08mm, bez ostonki i z kompletem narzędzi wielorazowych ze stali martenzytycznej?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, rozwiązania opisanego w pytaniu nie dopuszcza.

49 PYTANIE

Część 41

Czy Zamawiający zgodzi się na taśmę 26g/m², o szerokości 1,1 cm, porowatości 0,6mm², grubości 0,08mm, bez ostonki i z kompletem narzędzi wielorazowych ze stali martenzytycznej?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, rozwiązania opisanego w pytaniu nie dopuszcza.

50 PYTANIE

Zwracam się z prośbą o wskazane minimalnego gwarantowanego procentowego zużycia umowy. Pozwoli to na dokładne oszacowanie kosztów Wykonawcy.

ODPOWIEDZ

Zamawiający w §2 pkt 11 wskazuje : „... Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia w zakresie nie mniejszym aniżeli 50 % wartości pierwotnej umowy...”

51 PYTANIE

Część 33 – Czy Zamawiający dopuści żel w opakowaniu jednostkowym określonym mililitrami, tj. żel o pojemności 11ml, co w przeliczeniu jednostki mieści się w granicach 11 – 12,5g?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.



52 PYTANIE

Część 39 - Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

53 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w części nr 62 pozycja nr 1 punch próżniowy jednorazowy, zbudowany z unikalnej podstawy zapewniającej stabilną platformę, którą dzięki specjalnemu miejscu na palce można łatwo utrzymać w miejscu podczas przygotowywania dawcy, silikonowy łącznik do strzykawki 5 ml ze sprężynką, okna wizualizacji 360° dla większej dokładności cięcia, dwustronne ostrze, otwory na znaczniki służące do kontrolowania płatk. Rozmiar: 6,5mm-6,75mm-7,0mm-7,25mm-7,5mm-7,75mm-8,0mm-8,25mm-8,5mm-8,75mm-9,0mm-9,5mm.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

54 PYTANIE

Dotyczy części nr 63

Czy Zamawiający dopuści również produkt o parametrach wymienionych poniżej:

Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy C10F18 (perfluorodekalina) w szklanej fiolce 5 ml, czysty płyn, nie zawiera konserwantów ani żadnych innych składników, chemicznie obojętny, nie miesza się z wodą i jest nietoksyczny w przyrodzie. Jałowy, apirogenny, optycznie przezroczysty, wysoce oczyszczony, 100% fluorowany cieczą perfluorowęglowodorową, czysty płyn, ciężar właściwy w temperaturze 25 stopni C 1,91 +- 0,02, współczynnik załamania światła w temp. 25st.C 1.3100 do 1,3150, lepkość w temperaturze 25 stopni C +-2 stopnie C od 2.66cSt do 3.00 cSt, napięcie powierzchniowe w temp. 25 st.C od 17 do 27 mN/m, temperatura wrzenia 142 st.C, stosowany podczas zabiegów chirurgii witreoretinalnej, w zabiegu chirurgicznego leczenia odwarstwienia siatkówki. Sterylizacja parą wodną.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

55 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Części 70 glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska, umożliwiającą jego bezdotykowe usuwanie? Taka funkcja zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu wykonującego pomiar, gdyż eliminuje konieczność wyciągania z glukometru rękami zużytego, zabrudzonego krwią paska.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

56 PYTANIE

Czy Zamawiający zaoferowania w Części 70 glukometru umożliwiającego ustawienie odpowiedniej jednostki pomiarowej (mg/dl lub mmol/l) przez użytkownika?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

57 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe zaoferowane w Części 70 były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych zapewnia kompletność i ciągłość dostaw, gdyż wymusza na dostawcy utrzymywanie stałej dostępności pasków testowych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

58 PYTANIE

Testy paskowe do glukometrów są wyrobem medycznym wymagającym zachowania specjalnych warunków przechowywania (temperatura i wilgotność w zakresie ściśle określonym przez producenta, wskazanym na każdym opakowaniu pasków). Przechowywanie pasków w nieodpowiednich warunkach skutkuje uzyskaniem zafałszowanych wyników pomiarów stężenia glukozy we krwi, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Wykonawca, który przechowuje paski w warunkach nieodpowiadających wymogom producenta, szczególnie latem lub zimą (np. w starej szopie lub nieogrzewanym garażu), nie zagwarantuje prawidłowego działania takiego wyrobu. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą na w Część 70 certyfikatu jednostki notyfikowanej wystawionego dla zgłoszonego w Polsce dystrybutora/importera lub reprezentującego go



wykonawcy, potwierdzającego spełnienie normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania testów diagnostycznych?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

59 PYTANIE

(część 62, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści punche próżniowe dla dawcy, składające się z podstawy próżni połączonej ze strzykawką 5 ml ze sprężynką, prowadnicy, standardowego trepanu, pierścienia kompresji i pokrywy ochronnej. Posiadające 4-stalowe prowadnice umożliwiające poprawny kierunek trepanowania. Część stanowiąca podłoże dla rogówki dawcy posiada 1 otwór centralny i 4 paracentralne.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

60 PYTANIE

(część 62, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści trepan próżniowy do rogówki biorcy w rozmiarze: 6,0/6,5/7,0/7,25/7,75/8,0/8,25/8,5/8,75/9,0mm, posiadający 360 stopniową komorę próżniową z 16 znacznikami, strzykawkę aspiracyjną, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

61 PYTANIE

(część 63) Czy Zamawiający dopuści dekalinę o lepkości 5 mPas w temperaturze 25 st C, gęstości 1,92-1,94 w temperaturze 25 st C,, temperaturze wrzenia 141-143 st C w temperaturze 25 st C,

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

62 PYTANIE

(55, pkt. 1 a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,2% wartości niedostarczonego towaru?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

63 PYTANIE

Czy zamawiający dopuści w części 74 pozycji nr 2 produkt Hyalobarrier Gel Endo z kaniulą 30 cm zamiast Hyalobarrier Gel z kaniulą 5 cm, ponieważ w obecnej chwili została zaprzestana dystrybucja tego produktu na terenie Polski?

ODPOWIEDZ

Zamawiający zmienia opis w części 74 poz. 2. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 4,74

64 PYTANIE

Pakiet nr 16, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla noworodków mikrobiologicznie czysty (reszta zgodna z SWZ) oraz dla dzieci o objętości 12ml (pozostałe parametry zgodne z SWZ)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

65 PYTANIE

Pakiet nr 16, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści objętość 70ml, wagę 36,5g, opór przepływu 1,0 hPa przy 30 l/min?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

66 PYTANIE

Pakiet nr 16, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml



- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z ze zmienionym załącznikiem 4,16.

67 PYTANIE

Pakiet nr 16, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z ze zmienionym załącznikiem 4,16.

68 PYTANIE

Pakiet nr 35, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści obwód bez worka?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,35 .

69 PYTANIE


Pakiet nr 35, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści worek 2l dołączony osobno?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,35 .

70 PYTANIE

Pakiet nr 35, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy typu rura w rurze, sterylnej, dla dorosłych, z rurą główną rozciągliwą do 180cm oraz ramieniem bocznym rozciągliwym do 50cm?



ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,35 .



71 PYTANIE

Dot. Część 58 - Sprzęt do przeszczepu warstwowego rogówki do ultracienkiego DSAEK - projekt Umowy. Proszę o wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych (Par.2 pkt. 7). Proszę o zmianę karnych odsetek w Par. 5 pkt. 1a na 0,2%.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wydłuża termin dostawy do 10 dni roboczych, w zakresie części 58. Pozostałe zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

72 PYTANIE

Dotyczy Pakiet 46 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę podpajęczynówkową do znieczuleń w dwóch rozmiarach - 26G, 27G długość 130cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4.46

73 PYTANIE

Dotyczy Pakietu Nr 19

Prosimy Zamawiającego w wyłączenie pozycji: 1, 3, 4 do osobnego pakietu, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty, a Państwu możliwość większego wyboru najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji do osobnej części

74 PYTANIE

Dotyczy Pakietu Nr 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do infuzji z: pierścieniem na części walcowatej komory, ułatwiający wktucie do pojemnika, zamiast opisanych „dodatkowych skrzydełek dociskowych”.

Spełniający pozostałe wymogi SWZ.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w załączeniu Zmieniony załącznik 4,28

75 PYTANIE

Dotyczy Pakietu Nr 28

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy kolec biorczy ma być dwukanałowy wzmocniony (z ABS), ścięty dwupłaszczyznowo, ułatwiający wktucie w pojemnik i lepszy drenaż?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w załączeniu Zmieniony załącznik 4,28

76 PYTANIE

Dotyczy Pakietu Nr 28

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przyrząd ma być bez PCV w komorze kroplowej oraz bez szkodliwych substancji tzn. ftalanów DEHP, BBP, DBP (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,28

77 PYTANIE

Dotyczy Pakietu Nr 28

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy opakowanie ma posiadać kod UDI (co ułatwi Zamawiającemu logistykę i gospodarkę oraz odczyt nr serii i datę ważności)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wymaga kodów UDI na opakowaniu.

78 PYTANIE

Dotyczy Pakietu Nr 28

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przyrząd ma posiadać zatyczką „prime stop” na końcu drenu, która umożliwi bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,28, dodatkowych parametrów nie określa



79 PYTANIE

Dotyczy Pakietu Nr 36

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z rozszerzoną skalą do 12ml, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty, a Państwu możliwość większego wyboru najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w załączeniu Zmieniony załącznik 4,36

80 PYTANIE

Dotyczy Pakietu Nr 36

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z rozszerzoną skalą do 3ml, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty, a Państwu możliwość większego wyboru najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w załączeniu Zmieniony załącznik 4,36

81 PYTANIE

Dotyczy Pakietu Nr 38

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy aparat do przygotowania i pobierania leków ma posiadać filtr 0,2um i łącznik Luer-Lock z zaworem bezigtowym?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, dodatkowych parametrów nie określa.

82 PYTANIE

Część 15, poz. 20,21,24,26

Czy zamawiający wydzieli poz. 20,21,24,26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji do osobnej części

83 PYTANIE

Część 15, poz.21

Czy zamawiający dopuści dren min. 200 cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w załączeniu Zmieniony załącznik 4,15

84 PYTANIE

Część 15, poz. 24

Czy zamawiający dopuści kieliszki tylko bezbarwne/przeźroczyste?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu, w załączeniu Zmieniony załącznik 4,15. Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu, zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania

85 PYTANIE

Część 15, poz.26

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawkę bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawkę. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta,



podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt. Czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml lub co 2 ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,15

86 PYTANIE

Część 19, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji do osobnej części

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu, zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania

87 PYTANIE

Część 25, poz. 3

Czy zamawiający dopuści dren min. 200 cm?

Czy zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela wskazanej pozycji do osobnej części

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,25

88 PYTANIE

Część 27, poz. 10,15-16,27-28,30

Czy zamawiający wydzieli poz. 10,15-16,27-28,30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji do osobnej części

89 PYTANIE

Część 27, poz. 10,15,16,28,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu, zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania

90 PYTANIE

Część 27, poz. 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu, zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania

91 PYTANIE

Część 27, poz. 30

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?



ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,27.

92 PYTANIE

Część 28

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm), bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,28.

93 PYTANIE

Część 50

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu, zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania

94 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6b) § 2 ust. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę miejsca dostawy zamawianego asortymentu z apteki szpitalnej na np. magazyn Zamawiającego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

95 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6b) § 5 ust. 1 lit. e

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

96 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6b) § 5 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

97 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6b) § 2 ust. 17 oraz formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4.82) opis przedmiotu zamówienia pkt. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyki produktu niebezpiecznego w zamian za udostępnienie strony internetowej, z której Zamawiający samodzielnie, w łatwy i szybki sposób, będzie mógł pobrać potrzebne dokumenty.



ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu . W załączeniu zmieniony załącznik 4,82.

§ 2 ust. 17 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca wraz z pierwszą dostawą Wyrobów medycznych dostarczy (dostarczy lub udostępni stronę internetową z której Zamawiający będzie mógł pobrać potrzebne dokumenty) karty charakterystyki produktu niebezpiecznego w języku polskim oraz będzie każdorazowo dostarczał wszelkie niezbędne aktualizacje w/w kart w sytuacji, gdy pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.”

98 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4.82) tabela poz. 4

Czy Zamawiający dopuści próbówki z trombiną bez znacznika pobierania na etykiecie, jest to odczynnik, którego stężenie nie wpływa na wyniki badań a jedynie na czas krzepnięcia, ponadto maksymalną ilość pobieranego materiału zapewnia kalibrowana na etapie produkcji próżnia?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu . W załączeniu zmieniony załącznik 4,82.

99 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4.82) tabela poz. 6, 17

Czy Zamawiający dopuści, aby próbówki z cytrynianem z poz.6 i 17 posiadały znacznik minimalnej objętości pobrania w postaci pierścienia wokół próbówki, co pozwala Personelowi na kontrolę ilości pobranej krwi, a tym samym zachowanie proporcji między krwią a odczynnikiem?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu . W załączeniu zmieniony załącznik 4,82.

100 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4.82) tabela poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje zaoferowania takiej samej ilości igieł bezpiecznych jak i uchwytów lub igieł oraz uchwytów bezpiecznych – czyli po 4000szt.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia w ilości wskazane w SWZ

101 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4.82) tabela poz. 21

Czy Zamawiający dopuści próbówki do OB. o obj. 1,28ml i znacznikiem pobrania na próbówce, nie na etykiecie? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu . W załączeniu zmieniony załącznik 4,82.

102 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4.82) opis przedmiotu zamówienia pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: „... Probówki do OB. powinny być kompatybilne z użytkowanym aparatem Sedi 40 również potwierdzone oświadczeniem.” Gdyż próbówki do aparatu Sedi40 nie są już produkowane, a Zamawiający oczekuje próbek do metody logarytmicznej.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. . W załączeniu zmieniony załącznik 4,82.



103 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4.82) opis przedmiotu zamówienia pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie uchwytu systemowego, na którym znajduje się logo producenta oraz oznakowanie produktu jednorazowego użytku.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,82.

104 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 82

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6b) § 2 ust. 4 oraz formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4.82)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czteromiesięcznego terminu ważności próbek z cytrynianem sodu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

Zmienia termin ważności na „4 miesiące dla próbek z cytrynianem sodu”

W załączeniu zmieniony załącznik 4,82.

105 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 20, 28

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6) § 2 ust. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę miejsca dostawy zamawianego asortymentu z apteki szpitalnej na np. magazyn Zamawiającego.

ODPOWIEDZ

106 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 20, 28

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6) § 5 ust. 1 lit. d

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

107 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 20, 28

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6) § 5 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

108 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 20, 28

Dotyczy przedmiotu zamówienia w pakiecie numer 28

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów i dopuszczenie przyrządu alternatywnego o poniższych parametrach:

przyrząd do infuzji grawitacyjnej, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS, igła czterokanałowa/stożek. Kompatybilny z lipidami. Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony

Objętość wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Złącze luer lock stałe. Komora kroplowa o długości 57mm

Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, oznakowanie kolorystyczne inne niż dla aparatów do krwi. Data ważności – 4 lata od daty produkcji. Opakowanie zbiorcze 250 szt.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego ze zmienionym załącznikiem 4.28



109 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 29

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6a) § 2 ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę miejsca dostawy zamawianego asortymentu z apteki szpitalnej na np. magazyn Zamawiającego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

110 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 29

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6a) § 8 ust. 1 lit. d

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „w wysokości 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

111 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 29

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6a) § 8 ust. 1 lit. f-h

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę wysokości kar z 50,00 zł na 30,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadkach, o których mowa w zapisach umowy

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

112 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 29

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 6) § 8 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

113 PYTANIE

PYTANIA DO PAKIETU 29

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4.29) tabela poz. 3, 7

Czy Zamawiający w poz. 3 oraz poz. 7 dopuści ilości, które są wielokrotnością 1 opakowania 12 szt. Producent dysponuje kasetami oraz kanistrami pakowanymi zbiorczo po 12 szt.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu, zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania

114 PYTANIE

Część nr 25 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z drenem min. 2 m?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,25.

115 PYTANIE

Część nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do infuzji z dwukanałowym, dwupłaszczynowym ostrym kolcem komory kroplowej?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,28

116 PYTANIE

Część nr 36 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z tłokiem w kolorze zielonym?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,36

117 PYTANIE

Część nr 36 poz. 1



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę ze skalą rozszerzoną 10(12)ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,36

118 PYTANIE

Część nr 36 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę ze skalą rozszerzoną 2(3)ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,36

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zgodnie z zapisami SWZ, tj. między innymi zgodnie z zapisami we wzorze umów §2 pkt 1 i 2

119 PYTANIE

Przesyłam pytanie do postępowania: zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw asortymentu w pakiecie 29 i 69 do maksymalnie 6 dni roboczych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wydłuża termin dostawy do 6 dni roboczych, w zakresie części 29. Część 69 pozostaje bez zmian

120 PYTANIE

Dotyczy: SWZ, Rozdział XIV, pkt 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przestania umowy drogą korespondencyjną.

ODPOWIEDZ

Zamawiający preferuje podpisywanie umowy w wersji papierowej, umowa przesyłana jest pocztą.

121 PYTANIE

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ; wzór umowy pozostałe części; § 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 14. Zamówienia złożone po godzinie 14, będą traktowane jako zamówienia złożone dnia kolejnego”.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

122 PYTANIE

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ; wzór umowy pozostałe części; § 2 ust. 7

„Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.”

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli §2 ust.5 ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający poprawia we wzorze umowy Załączniki nr 6,6a,6b do SWZ § 2 ust. 7. Zamawiający miał na myśli §2 ust.5

123 PYTANIE

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, wzór umowy pozostałe części § 2 ust. 9



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wysyłania faktury wraz z towarem, po każdorazowym zamówieniu

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga dostarczenia faktury zgodnie z zapisami umowy, rozwiązanie opisane w pytaniu dopuszcza.

124 PYTANIE

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ, wzór umowy pozostałe części; § 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić taki zapis w umowie:

Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania Przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

125 PYTANIE

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ- wzór umowy pozostałe części, §5 ust.1 ppkt. a,b

W naszej opinii zaproponowana kara umowna 0,5 % jest wysoka. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 0,2%.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

126 PYTANIE

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ -wzór umowy pozostałe części – wzór, §5

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

127 PYTANIE

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ -wzór umowy pozostałe części – wzór, §5 ust.2

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 50% jest wysoka. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30 %. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 30 % wartości umowy i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

128 PYTANIE

Dotyczy: Załączniki 4.1-4.82, formularz asortymentowo-cenowy, część 30,65

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

129 PYTANIE

Dotyczy: Załączniki 4.1-4.82, formularz asortymentowo-cenowy, część 30,65



Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

130 PYTANIE

Dotyczy: Załączniki 4.1-4.82, formularz asortymentowo-cenowy, część 30 poz.2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

131 PYTANIE

Dotyczy: Załączniki 4.1-4.82, formularz asortymentowo-cenowy, część 30

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem **Missouri firmy Ulrich**.

ODPOWIEDZ

Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga asortymentu do posiadanej strzykawki automatycznej Missouri firmy Ulrich

132 PYTANIE

Dotyczy: Załączniki 4.1-4.82, formularz asortymentowo-cenowy, część 30 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 150 cm wynosiła dokładnie 7,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 7,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznannej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

133 PYTANIE

Dotyczy: Załączniki 4.1-4.82, formularz asortymentowo-cenowy, część 30

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia producenta wstrzykiwacza kontrastu lub jego autoryzowanego dystrybutora, że oferowane wyroby medyczne są kompatybilne z wstrzykiwaczem kontrastu Missouri?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

134 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6 (część66)

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §2 ust. 11 projektu umowy, że minimalna wartość zrealizowanego zamówienia wyniesie 80% wartości umowy i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należyłą ocenę ryzyka, co jest niekorzystne dla każdej ze stron. Co więcej, w ww. zakresie Wykonawcy powinno służyć roszczenie o realizację umowy, bowiem w innym przypadku ochrona interesów Wykonawcy byłaby w zasadzie jedynie iluzoryczna.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

135 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6 (część66)



Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić § 2 ust. 12 z projektu umowy?

Uzasadnienie:

Brak podstaw do uprawnienia Zamawiającego do zwrotu dostarczonego towaru, który jest petnowartościowy. Naraża to Wykonawcę na ewentualne uszkodzenie towaru podczas transportu zwrotnego. Poza tym, nie wskazano kto ma ponosić koszt transportu zwrotnego. Poza tym, ustalony termin 30 dni na zwrot powoduje, że Wykonawca nie będzie pewny czy może wystawić fakturę na całość dostawy, a w przypadku zwrotu towaru, konieczne będzie wystawienie odpowiednich faktur korygujących. Postanowienie narusza zasadę równowagi kontraktowej stron.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

136 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6(część66)

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §2 ust. 13-14 projektu umowy, że zakup interwencyjny będzie możliwy jedynie w przypadku zwłoki w dostawie (tj. opóźnienie zawinione), po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowo terminu na dostawę oraz, że nie zmniejszy wartości umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji okoliczności, za które nie ponosi winy i na które nie ma wpływu oraz powinien mieć możliwość usunięcia uchybienia. Ponadto, dokonanie zakupu interwencyjnego nie powoduje powstania szkody po stronie Zamawiającego, wobec czego nie ma podstaw do zmniejszania wartości zamówienia.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

137 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6(część66)

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §2 ust. 16 projektu umowy, że odmowa przyjęcia dostawy dotyczyć może jedynie tej części zamówienia, która została wadliwie oznaczona/opakowana bądź jest niezgodna z ofertą Wykonawcy?

Uzasadnienie:

Uprawnienie Zamawiającego do dokonania odmowy przyjęcia zamówienia dotyczyć powinno jedynie tej części dostawy, która została zrealizowana w nieprawidłowy sposób – towar dostarczony zgodnie z umową i nie noszący wad powinien zostać odebrany.

ODPOWIEDZ

Zamawiający tak będzie to interpretował, zapisy umowy nie zmieniają się.

138 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6(część66)

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić § 3 ust. 5 z projektu umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie wyraża zgody na jednostronne potrącenie niewymagalnych należności Wykonawcy przez Zamawiającego. Postanowienie stoi w sprzeczności z przesłankami potrącenia na podstawie kodeksu cywilnego

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

139 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6(część66)

Czy Zamawiający zgodzi się w § 3 ust. 6 lit. b projektu umowy wydłużyć termin do zgłoszenia zmiany rachunku bankowego do 4 dni roboczych .

Uzasadnienie:

Ustalenie 1 dnia na poinformowanie Zamawiającego jest niewystarczające i naraża Wykonawcę na negatywne konsekwencje, zatem prośba o wydłużenie do 4 dni roboczych. Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku dlatego zasadne jest postępowanie się jednostkami roboczymi

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

140 PYTANIE



Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6 (część66)

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §4 ust. 2 i 5 projektu umowy, że termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia Wykonawcy reklamowanego towaru a koszty wysyłki obciążają Wykonawcę tylko w przypadku reklamacji zasadnych?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może rozpatrzyć reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego towaru. Zwrot kosztów wysyłki może nastąpić jedynie w przypadku reklamacji uzasadnionych – w innym bowiem wypadku Wykonawca ponosiłby straty wynikające ze składania przez Zamawiającego bezpodstawnych reklamacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

141 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6 (część66)

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §4 ust. 3 projektu umowy, że zamówienie będzie uważane za niezrealizowane co do wadliwej/brakującej części?

Uzasadnienie:

Część zamówienia zrealizowana prawidłowo powinna zostać przez Zamawiającego uwzględniona i rozliczona – bez oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji dotyczącej jego wadliwej części.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

142 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6 (część66)

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §5 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w przypadku niedostarczenia zamówienia częściowego lub stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego - w wysokości **0,2%** wartości brutto wyrobów medycznych, niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego - za każdy dzień zwłoki w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% tej wartości.**
- b) w przypadku stwierdzenia braku oznakowania dostarczonych wyrobów medycznych w sposób określony w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, wadliwości lub niezgodności dostarczonych wyrobów medycznych ze złożoną ofertą oraz zwłoki w dostarczeniu przez Wykonawcę wyrobów medycznych prawidłowo oznaczonych, wolnych od wad lub zgodnych ze złożoną ofertą - w **wysokości 0,2%** wartości brutto wyrobów medycznych dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego, których dotyczy brak oznakowania, wadliwość lub niezgodność ze złożoną ofertą - za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% tej wartości.**
- c) w **wysokości 2% wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach określonych w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, niezależnie od obowiązku pokrycia przez Wykonawcę różnicy pomiędzy ceną zakupu zastępczego i ceną przetargową;**
- d) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej wartości umowy** całej umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.
- e) w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek, kiedy Wykonawca nie dokona zapłaty lub dokona nieterminowo zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w art. 439 ust 5 ustawy PZP.”

Uzasadnienie:

- Kary umowne powinny zostać obniżone do wartości bardziej odpowiadającej wysokości ewentualnej szkody, jakiej można doznać Zamawiający, zatem Wykonawca wnosi o odpowiednie obniżenie stawek. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;



- Zasadnym jest ustanowienie osobnego górnego limitu naliczania kar umownych dla danego zdarzenia z osobna. W przeciwnym wypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć wartość danego zamówienia;
- W sytuacji zwłoki w dostawie Zamawiający może naliczyć karę umowną wg lit. a), wobec czego brak jest podstaw do zastrzegania dodatkowej kary na wypadek dokonania zakupu zastępczego. Wykonawca i tak ma obowiązek zwrotu różnicy w cenie, wobec czego Zamawiający nie poniesie szkody.
- W przypadku zakończenia umowy kara powinna być naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, bowiem w innym wypadku byłaby taka sama niezależnie od tego, czy umowa została zrealizowana w 1% czy w 99%.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

143 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6(część66)

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §5 ust. 2 projektu umowy, że maksymalna wysokość kar umownych wyniesie **20%** wartości umowy?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o obniżenie limitu naliczania kar umownych w celu uniknięcia ich wygórowania.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

144 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6(część66)

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §6 ust. 2 lit. a projektu umowy, że uprawnienie do rozwiązania umowy dotyczyć będzie tylko przypadku zawnionego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może ponosić negatywnych skutków okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności i na które nie ma wpływu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

145 PYTANIE

Pytania odnośnie SWZ do treści projektu umowy dostawy zawartego w SWZ Załącznik nr6(część66)

Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §7 projektu umowy, że zmiana ceny brutto wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku VAT nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę – bez konieczności zawarcia aneksu i bez dodatkowych obowiązków po stronie Wykonawcy?

Uzasadnienie:

Strony nie mają wpływu na wysokość stawki VAT. Wykonawca nie może też wystawić faktury z nieobowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

146 PYTANIE

dotyczy część 45

Czy zamawiający dopuści aspirator ssący ze skalą od 2-12 cm ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu , w załączeniu zmieniony załącznik 4,45

147 PYTANIE

dotyczy część 32 poz. 1

Czy zamawiający może podać model głowicy sondy oraz model aparatu USG z którą ma być kompatybilna sterylna jednorazowa prowadnica ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający posiada Aparat USG APLIO400 z głowicą dorektalną Toshiba

148 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 9



POZYCJA 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania igły kulkowej z przezroczystą końcówką Luer-Lock, w rozmiarze 1,25x81mm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu , w załączeniu zmieniony załącznik 4,9

149 PYTANIE

Dotyczy pakiet 15, poz 16. W związku z zakończeniem produkcji drenów Penrose o długości 30 cm prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów wyłącznie o długości 50cm, pozostałe parametry jak w SWZ

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,15

150 PYTANIE

Czy w zadaniu 67 pozycja nr 2 nie doszło do pomyłki drukarskiej i czy zamawiający zamawiający dopuści : Jednorazowa elektroda bipolarna sterylna (koagulacja/ablacja. Dostęp transformalny długość robocza 350 mm) Kompatybilna z radiodiatermią 4 MHz marki Richard Wolf

ODPOWIEDZ

Zamawiający poprawia w załączniku 4,67 poz. 2 (dotyczy części 67)
W załączeniu zmieniony załącznik 4,67.

151 PYTANIE

Pakiet 25 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania dostępny w rozmiarach CH6-20?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,25

152 PYTANIE

Pakiet 25 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania wyposażony w otwór centralny i 2 otwory boczne?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,25

153 PYTANIE

Pakiet 25 Pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnąta jest poprzez proces sterylizacji (np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

ODPOWIEDZ

Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego(jałowego). W załączeniu zmieniony załącznik 4,25

154 PYTANIE

Pakiet 25 Pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje sterylnych masek w opakowaniu papier/folia?

ODPOWIEDZ

Zamawiający oczekuje masek sterylnych zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,25.
Zamawiający nie określa rodzaju opakowania.

155 PYTANIE

Pakiet 27 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści butelki Redon mikrobiologicznie czyste posiadające świadectwo czystości mikrobiologicznej?

ODPOWIEDZ

Zamawiający , zgodnie z SWZ wymaga produktu sterylnego.
W załączeniu zmieniony załącznik 4,27

156 PYTANIE

Pakiet 27 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści butelki Redon w opakowaniu foliowym?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,27

157 PYTANIE

Część 27 Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnowej z trio igieł (14G, 16G oraz 19G)?



ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,27

158 PYTANIE

Część 27 Pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Thorax z PVC z trokarem z stali nierdzewnej o długości 400mm prosty i zgięty z jednym otworem centralnym oraz trzema otworami bocznymi w rozmiarach CH 16, 20, 24, 28, 32 oraz 36, z linią RTG?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,27

159 PYTANIE

Część 27 Pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Thorax z PVC z trokarem z stali nierdzewnej lub aluminium (w zależności od rozmiaru) o długości 21-34 ±1cm (w zależności od rozmiaru) prosty z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi w rozmiarach CH 16, 20, 22, 24, 28, 32 oraz 36, z linią RTG?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,27

160 PYTANIE

Część 27 Pozycja 31

Czy Zamawiający miał na myśli maski w rozmiarze 3, 4 i 5?

ODPOWIEDZ

Zamawiający miał na myśli maski w rozmiarze 3,4,5. W załączeniu zmieniony załącznik 4,27

161 PYTANIE

Część 28 Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,28

162 PYTANIE

Część 28 Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji w opakowaniu papier/folia?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,28

163 PYTANIE

Część 28 Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,28

164 PYTANIE

Część 28 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów do infuzji za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu, zapis pod tabelą określa sposób przeliczenia sztuk na opakowania

165 PYTANIE

Część 36 Pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali nominalnej o 10%?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,36

166 PYTANIE

Część 36 Pozycja 5



Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny z nakładaną igłą iniekcyjną w rozmiarze 0,45x13mm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,36

167 PYTANIE

Część 26: Drenaż komorowy Czy Zamawiający zaakceptuje Zestaw do zewnętrznego drenażu komorowego o następujących właściwościach: Kompaktowy zestaw do drenażu komorowego w komplecie z drenem komorowym, zawierającym m.in. • Dren komorowy dla dorosłych o średnicy zew. 3,0mm, śr. wew. 1,6 mm, długości 350 mm, ze znacznikami co 1 cm • Linia pacjenta o długości min 185 cm • Integralny worek drenażowy o pojemności 700 ml, wyskalowany, wyposażony w zawór spustowy. Przezroczysta komora kropelkowa zintegrowana z workiem wyposażona w filtr antybakteryjny.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,35

168 PYTANIE

Część 35 poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na obwód o długości 280 cm spełniający pozostałe wymagania?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,35

169 PYTANIE

Dotyczy Pakiet 16 poz 1

Czy Zamawiający dopuści filtry oddechowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla noworodków, objętość 8 ml - 13,5 ml i dla dzieci objętość ok.25 – 30 ml, sterylne, antybakteryjne, antywirusowe, o małej masie własnej, wysoki stopień skuteczności, port do kapnografii. Rozmiary wskazane każdorazowo w zamówieniu?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,16

170 PYTANIE

Pakiet 51

Poz 1 : Zwracamy się do Zamawiającego prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. den przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową z płaską i gładką membraną nie wymagającą dodatkowego korka. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Standardowe zakończenie luer lock- końcówka męska bez sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

171 PYTANIE

Pakiet 51

Poz 3: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji ze standardową komorą kropelową, reszta zgodna z SWZ

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

172 PYTANIE

Pakiet 28 poz 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do infuzji firmy Margomed z igłą biorczą dwukanałowa z ABS (ściętą dwupłaszczyznowo oraz komorą kropelową bez skrzydełek dociskowych (z pierścieniem ułatwiającym wbicie) . Pozostałe parametry zgodne z SWZ

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,28

173 PYTANIE

Pakiet33: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie żelu do cewnikowania o pojemnościach 8-12,5g. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by żel do cewnikowania był w opakowaniu umożliwiającym aplikację jedną ręką?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,33



174 PYTANIE

Pakiet 36:

Pozycja 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z rozszerzoną skalą do 12ml pozostałe parametry zgodne. W razie odpowiedzi odmownej prosimy o medyczne uzasadnienie.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,36

175 PYTANIE

Pakiet 36:

Pozycja 3: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z rozszerzeniem skali do 3 ml, pozostałe parametry zgodne. W razie odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,36

176 PYTANIE

Pakiet 36:

Poz,1,2,3,4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną bez rozszerzenia

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4,36

177 PYTANIE

Pakiet 49 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany zestaw ma umożliwiać manometryczny pomiar IAP bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.. W załączeniu zmieniony załącznik 4,49

178 PYTANIE

Pakiet 71 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy to, że strzykawka jest gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka ma być potwierdzone w instrukcji użycia producenta

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wymaga

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik 4,71. W załączeniu zmieniony załącznik 4,71

179 PYTANIE

Dotyczy: Część nr 80. Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §2 ust.7

Wykonawca wnosi w zakresie części nr 80, o wydłużenie terminu dostawy częściowej wskazanego w §2 ust 7 wzoru umowy z 4 do 5 dni roboczych. Wskazany we wzorze umowy termin jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydłuża terminu dostawy częściowej w zakresie części 80

180 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §2 ust.12

Wnosimy o zmianę postanowień par. 2 ust 12 wzoru umowy na poniższy:

„W uzasadnionych wypadkach Zamawiający ma prawo zgłosić chęć zwrotu części zakupionego przedmiotu zamówienia, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia dostawy, a Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku i wypadku uznania zasadności zwrotu, przyjęcia towaru. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony maksymalnie do 30 dni kalendarzowych. Przedmiot zamówienia podlegający zwrotowi w obydwu wypadkach, musi być zwrócony w pierwotnym stanie, w nieotwartych oryginalnych opakowaniach transportowych. W innym wypadku Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia zwracanego towaru.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem



181 PYTANIE

Dotyczy: Część nr 80. Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §7 ust.2

Wykonawca wnosi w zakresie części nr 80, o wydłużenie terminu wskazanego w §7 ust.2 z 3 do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Wskazany we wzorze umowy termin jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

182 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §8 ust.1 a

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w paragrafie 8 ustęp 1 a, do 0,3% wartości brutto wyrobów medycznych, niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w dostawie.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

183 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §8 ust.1 b

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w paragrafie 8 ustęp 1 b, do 0,3% wartości brutto wyrobów medycznych dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego, których dotyczy brak oznakowania, wadliwość lub niezgodność ze złożoną ofertą - za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 7 ust. 2 umowy.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

184 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §8 ust.1 c

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w paragrafie 8 ustęp 1 c, do 1% wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach określonych w § 2 ust. 13 umowy.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

185 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §8 ust.2

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie łącznej wartości kar umownych wskazanych do maksymalnie 30 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §6 ust.1

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

186 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §8 ust. 4

Kierując się zasadą równego traktowania stron umowy, wnioskujemy o wydłużenie terminu zapłaty kar umownych do 30 dni liczonych od daty otrzymania noty obciążeniowej.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

187 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §3 ust. 1

Prosimy w zakresie części nr 80 na wydłużenie na zainstalowanie i uruchomienie dzierżawionego aparatu do 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

188 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §3 ust. 5 a



Prosimy o odstąpienie od wymogu zapisanego §3 ust. 5 a w wypadku, gdy producent aparatu nie ma rekomendacji w kwestii częstotliwości przeglądów urządzenia

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

189 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §4 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu na wykonanie przeglądu technicznego, wskazanego w §4 ust. 3, z 10 do 14 dni roboczych. Wykonawca na czas przeglądu używa bezpłatnie sprzęt zastępczy, aby zapewnić ciągłość badań pacjentek.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

190 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §4 ust. 4

Prosimy o wydłużenie terminów na wykonanie napraw, wskazanych w §4 ust. 4, odpowiednio do 5 dni roboczych (bez konieczności wymiany części zamiennych), oraz do 10 dni roboczych (w przypadku konieczności wymiany części zamiennych).

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

191 PYTANIE

Pytanie nr 13 Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §8 ust.1 d

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w paragrafie 8 ustęp 1 d, do wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto całej umowy określonej w § 6 ust. 1 projektu umowy

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

192 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §8 ust.1 e i f

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej zawartej w paragrafie 8 ustęp 1 e oraz 1 f, do wysokości 30,00 zł za każdy dzień zwłoki

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

193 PYTANIE

Dotyczy: Wzór umowy dla części 3,29,31,73,80,81, §10 ust.4

Wnosimy o wyrażenie zgody dla pakietu nr 80 na uzupełnienie §10 ust 4 Wzoru Umowy poprzez dodanie ppkt i następującej treści i) zmiany wyrobu medycznego producenta na wyrób nowszej generacji, kompatybilny z urządzeniem będącym przedmiotem najmu, którego cena będzie nie wyższa niż określona w umowie

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy. Zaproponowany w pytaniu ppkt. ma przełożenie na §10 ust.4 f)

194 PYTANIE

Dotyczy umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej wyroby medyczne, bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmieni terminu § 4 ust. 2

195 PYTANIE

Dotyczy umowy § 5 ust. 1 pkt a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości wyrobów medycznych, niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego - za każdy dzień zwłoki w dostawie?



ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

196 PYTANIE

Dotyczy umowy § 5 ust. 1 pkt b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto wyrobów medycznych dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego, których dotyczy brak oznakowania, wadliwość, lub niezgodność ze złożoną ofertą i/lub umową - za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

197 PYTANIE

Dotyczy umowy § 5 ust. 1 pkt c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

198 PYTANIE

Dotyczy umowy § 5 ust. 1 pkt d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem

199 PYTANIE

część nr 28

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, ściętą trójpłaszczyznowo?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,28

200 PYTANIE

część nr 36, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 10ml z rozszerzoną skalą do 11ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,36

201 PYTANIE

część nr 36, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową 5ml z rozszerzoną skalą do 5,5ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,36

202 PYTANIE

Część 51 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren do przygotowywania leków cytostatycznych o następujących parametrach:

- dren bursztynowy, który zapewnia ochronę UV lekom cytostatycznym,
- port bezigłowy w kształcie pozwalający na wygodną obsługę portu,
- końcówka męska, bez systemu sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym,
- dren dodatkowo zabezpieczony zaworem zwrotnym, który zapobiega cofaniu się leku do drenu.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDZ



Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

203 PYTANIE

Część 51 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw drenów wielodrożny o następujących parametrach:

- dren bursztynowy, który zapewnia ochronę UV lekom cytostatyczny,
- podaż leku tylko metodą grawitacyjną,
- komora kroplowa jednoczęściowa, bursztynowa, z filtrem 15 mikrona, bez filtra typu AirStop,
- zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu bez miejsca na kolec
- dren dodatkowo zabezpieczony zaworem zwrotnym, który zapobiega cofaniu się krwi do drenu.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

204 PYTANIE

Część 51 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści aparat infuzyjny przeznaczony do podawania cytostatyków o następujących parametrach:

- dren bursztynowy, który zapewnia ochronę UV lekom cytostatyczny, bez zawartości PCV i DEHP,
- komora kroplowa jednoczęściowa, bursztynowa, z filtrem 15 mikrona, bez filtra typu AirStop,
- zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu bez miejsca na kolec
- dwa porty bezigłowe. Jedna zastawka bezigłowa nad komorą kroplową, dodatkowa druga zastawka bezigłowa do podaży bolusa. Wszystkie porty zabezpieczone korkami jednorazowymi. Możliwość stosowania do 200 aktywacji. Porty bezigłowe zapobiegają wypływowi leku po odłączeniu strzykawki/krótkiego drenu. Objętość wypełnienia portu 0,09 ml.
- dwa zaciski typu C na drenie.
- długość drenu 180 cm, mierzona od dna komory kroplowej.
- dren dodatkowo zabezpieczony zaworem zwrotnym, który zapobiega cofaniu się krwi do drenu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

205 PYTANIE

Część 51 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści aparat infuzyjny o następujących parametrach:

- zastawka bezigłowa do podaży bolusa umiejscowiony nie dalej niż 25 cm od końca drenu, możliwość stosowania do 200 aktywacji, port bezigłowy zapobiega wypływowi leku po odłączeniu strzykawki
- dren 180 cm,
- brak zacisku typu C

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

206 PYTANIE

Dotyczy części nr 3 poz. 1 .Czy w związku z faktem, że opisany w części nr 3 poz. nr 1 "Jednorazowy sensor przepływu" - łącznik flow-ree do pobierania mieszanki wdechowo/wydechowej dedykowany do badań pacjentów wentylowanych. Łącznik kompatybilny z kalorymetrem Q-nrg+ obecnie oferowany jest jako sprzęt laboratoryjny, nie jako wyrób medyczny, Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie powyższego bez stosownego certyfikatu dedykowanego wyrobom medycznym? Produkty sklasyfikowane jako sprzęt laboratoryjny nie wymagają certyfikacji, a w tym przypadku zachowują równorzędną jakość, funkcjonalność oraz poziom bezpieczeństwa.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wyraża zgodę.

207 PYTANIE

Część 40 – Pojemniki na wycinki, formalina, alkohol etylowy poz. 2 Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelnie zakręcaną nakrętką. Pojemnik przezroczysty. nakrętka biała. Pojemność 200-250 ml.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 250ml szczelnie zamykanego pokrywką na wcisk, pojemnik przezroczysty o wymiarach: średnica górna 90mm, średnica dolna 80mm, wysokość 62mm.



Pojemniki proponowane przez naszą firmę gwarantują znacznie wyższą szczelność w porównaniu do zakręcanych, łatwe otwieranie i zamykanie oraz bezproblemowe umieszczanie wycinków w pojemniku. Jednocześnie oferowane przez Nas pojemniki pozwolą na znaczne obniżenie ceny pozycji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,40

208 PYTANIE

Część 74

Ze względu na fakt, że do grudnia 2024 nie jest możliwe zapewnienie dostaw Hyalobarrier Gel Endo z datą ważności min 12m-cy (12'24 planowana nowa dostawa z datą ważności powyżej 12mcy). Obecnie posiadamy Hyalobarrier Gel Endo z datą ważności 01.2025r.

Prosimy Zamawiającego o zaakceptowanie powyższych terminów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga terminu ważności zgodnego z §2 ust 4 wzoru umowy

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapis w części 1
W konsekwencji odpowiedzi na pytania w załączeniu
ZMIENIONE Załączniki 4,1-4,82

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:
Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2024r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2024r. o godz. 10:30
Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Opublikowane Ogłoszenie o zmianie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Agata Choluż
Kierownik Działu Zamówień Publicznych