





Znak: AE/ZP-27-13/21

Tarnów, 2021-06-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie [przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 61 szt. dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.


W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji nr 1 pkt 2 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z elementami metalowymi lakierem epoksydowym z dodatkiem substancji antybakteryjnej dostępnym w tylko w kolorze jasnoszarym?
2. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 30 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafkę o konstrukcji kontenerowej wykonanej z polietylenu o gładkiej strukturze, co ułatwia czyszczenie i dezynfekcję?
3. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 31 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafkę z dodatkowym jezdny białym bocznym, kompatybilnym z oferowaną szafką?
4. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 32 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy biał boczny z regulacją wysokości w zakresie 850 – 1100 mm?
5. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 34 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafkę, która zamiast otwartej półki pod szufladą posiada uchwyt na np. ciapy pacjenta?
6. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 35 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafkę o szerokości 450 mm?
7. **Dotyczy pozycji nr 2 pkt 35 Załącznika Nr 5 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafkę o głębokości 530 mm?



8. **Dotyczy pozycji nr 1-2.** Prosimy o dopuszczenie do oceny asortyment o parametrach i cechach użytkowych opisanych w tabeli poniżej:

L.P.	Oferowane parametry łóżka
2.	Konstrukcja łóżka wykonana z elementów metalowych pokrytych powłoką epoksydową
3.	Podstawa łóżka gwarantująca stabilność leża. Leże na pantografie lub ramionach wznoszących
4.	Wymiary zewnętrzne łóżka: długość - 2100 mm, szerokość (wraz z zamontowanymi barierkami) 940 mm
5.	Leże łóżka czterosegmentowe, z czego minimum 3 segmenty ruchome (segmenty oparcia pleców, uda i podudzia)

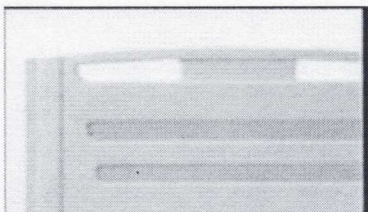6.	Segmenty leża wykonane z płyt z HPL lub tworzywa ABS. Płyty leża z otworami wentylacyjnymi. Segmenty leża odejmowane bez użycia narzędzi
7.	Minimalne wymiary leża: długość 1950 mm, szerokość 850 mm
8.	Bezpieczne obciążenie łóżka - minimum 250 kg, tj. obciążenie przy którym działają wszystkie funkcje łóżka, w tym przy użyciu pilota
9.	Łóżko sterowane przewodowym pilotem z magnetyczną blokadą funkcji oraz z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu panelu głównego. Zasilanie 230V, 50-60Hz.
10.	Elektryczna regulacja: - wysokości w zakresie 410 mm - 790 mm (w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża)
11.	Elektryczna regulacja: - kąta uniesienia oparcia pleców w zakresie 0-65° - segmentu oparcia uda minimum w 0-30° kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie 0-16° przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 0-16° - segmentu oparcia pleców - kąta
12.	Regulacja segmentu podudzia mechaniczna (ręczna)
13.	Łóżko wyposażone w mechaniczne dźwignie awaryjne CPR znajdujące się po obu stronach łóżka
14.	Szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS
15.	Szczyty łóżka, łatwo odejmowane, wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS; z możliwością wyboru wstawek kolorystycznych przez Zamawiającego. Do wyboru 4 kolory, z których jednym jest mięta (zdjęcie). 
16.	Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą jazdy i obrotu kół
17.	We wszystkich narożnikach łóżka krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniem podczas przemieszczania łóżka
18.	Łóżko wyposażone w minimum 4 uchwyty materaca, po 2 z każdej strony lub inny sposób zabezpieczenia materaca przed wypadaniem z leża
19.	Powierzchnie łóżka odporne na środki myjące i dezynfekcyjne
20.	Wyposażenie (ujęte w cenie łóżka): cztery składane barierki, materac, wieszak kroplówki, wysięgnik z uchwytem do ręki, wieszaki na worki na mocz, półka na pościel.
21.	Po dwie barierki boczne z każdej strony łóżka, łącznie na około 3/4 długości łóżka z każdej strony, z możliwością niezależnego opuszczania i składania na ramę łóżka każdej części
22.	Wysokość barierki powyżej 310 mm.
23.	Materac łóżka: wymiary dostosowane do leża łóżka, wysokość minimum 10 cm, wiskoelastyczny, dwuwarstwowy, gęstość warstwy „visco” - 50 kg/m ³ , w pokrowcu umożliwiającym łatwe jego ściąganie. Pokrowiec paroprzepuszczalny, zmywalny, odporny na: przemakanie, zanieczyszczenia organiczne, przenikanie mikroorganizmów, ścieranie. Pokrowiec łatwy do dezynfekcji i prania, wytrzymały na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, wysokie temperatury (pranie w temperaturze co najmniej do 95°C i suszenie w bębnie

24.	Wieszak kroplówki z możliwością zamontowania w co najmniej 2 punktach łóżka od strony głowy, z co najmniej dwoma haczykami, wszystkie elementy wieszaka whytrzymałe. Zamawiający dopuszcza, aby wieszak kroplówki był zintegrowany z uchwytem do ręki
25.	Wysięgnik z uchwytem do ręki z możliwością zamontowania po obu stronach łóżka od strony wezgłowia
26.	Wieszaki na worki na mocz zamontowane po obu stronach łóżka
27.	Półka na pościel chowana pod leże, po schowaniu nie wystająca poza ramy łóżka
28.	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcje w języku polskim: obsługi łóżka, postępowania w zakresie dezynfekcji łóżka, postępowania z materacem i pokrowcem w zakresie prania i suszenia oraz dezynfekcji
Parametry dla szafek przyłóżkowych	
30.	Szkielet szafki stalowa, pokryta powłoką epoksydową; fronty i blaty z płyty HPL lub tworzywa sztucznego
31.	Szafki posiadające co najmniej: jedną szufladę pod blatem, komorę z półką lub szufladę z przegrodami, blat boczny
32.	Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulację wysokości w zakresie 880-1175mm (± 50 mm) oraz regulację kąta pochylenia w zakresie 30°-45°.
33.	Co najmniej dwa boki blatu głównego oraz dwa boki blatu bocznego wyposażone w ograniczniki zabezpieczające przedmioty położone na tych blatach przed łatwym spadnięciem
34.	Dwie otwarte półki, jedna nad, a druga pod zamykaną komorą z półką lub szufladą z przegrodami
35.	Wymiary szafki włączając blat boczny:
	Wysokość 800 - 950 mm
	Szerokość 550 - 700 mm
	Głębokość 550 - 700 mm
36.	Wymiary blatu bocznego 350-450 mm x 550-650 mm
37.	Fronty szuflady i komory z półką w kolorze odcieni szarości lub czerni
38.	4 koła jezdne o średnicy co najmniej 50 mm, w tym co najmniej 2 z blokadą lub centralna blokada kół. Koła z bieżnikiem nie brudzącym i nie rysującym podłogi
39.	Powierzchnie szafek odporne na środki myjące i dezynfekcyjne

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 2 Załącznika Nr 5 do SWZ dla łóżek oferowanych w **pozycji nr 1**.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych o konstrukcji kontenerowej wykonanej z polietylenu o gładkiej strukturze, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym szkielet szafki wykonany jest z profili metalowych lakierowanych proszkowo.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji nr 2** szafek przyłóżkowych z dodatkowym blatem bocznym i podtrzymuje wymagania określone w pkt 31 Załącznika Nr 5.

Ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **pozycji 2** szafek przyłóżkowych z blatem bocznym z regulacją wysokości w zakresie 850 – 1100 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 34 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 6-7 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 35 Załącznika Nr 5 do SWZ dla szafek przyłóżkowych oferowanych w **pozycji 2**.

Ad 8 Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **pozycji 1-2**, z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania do SWZ udzielonych w dniu 15 czerwca 2021 r. oraz odpowiedzi Ad 1-7 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Z up. **DYREKTORA**


mgr piel. *Maria Bawół*
Zastępca Dyrektora

