




Kolumna pojedyncza 1 szt.

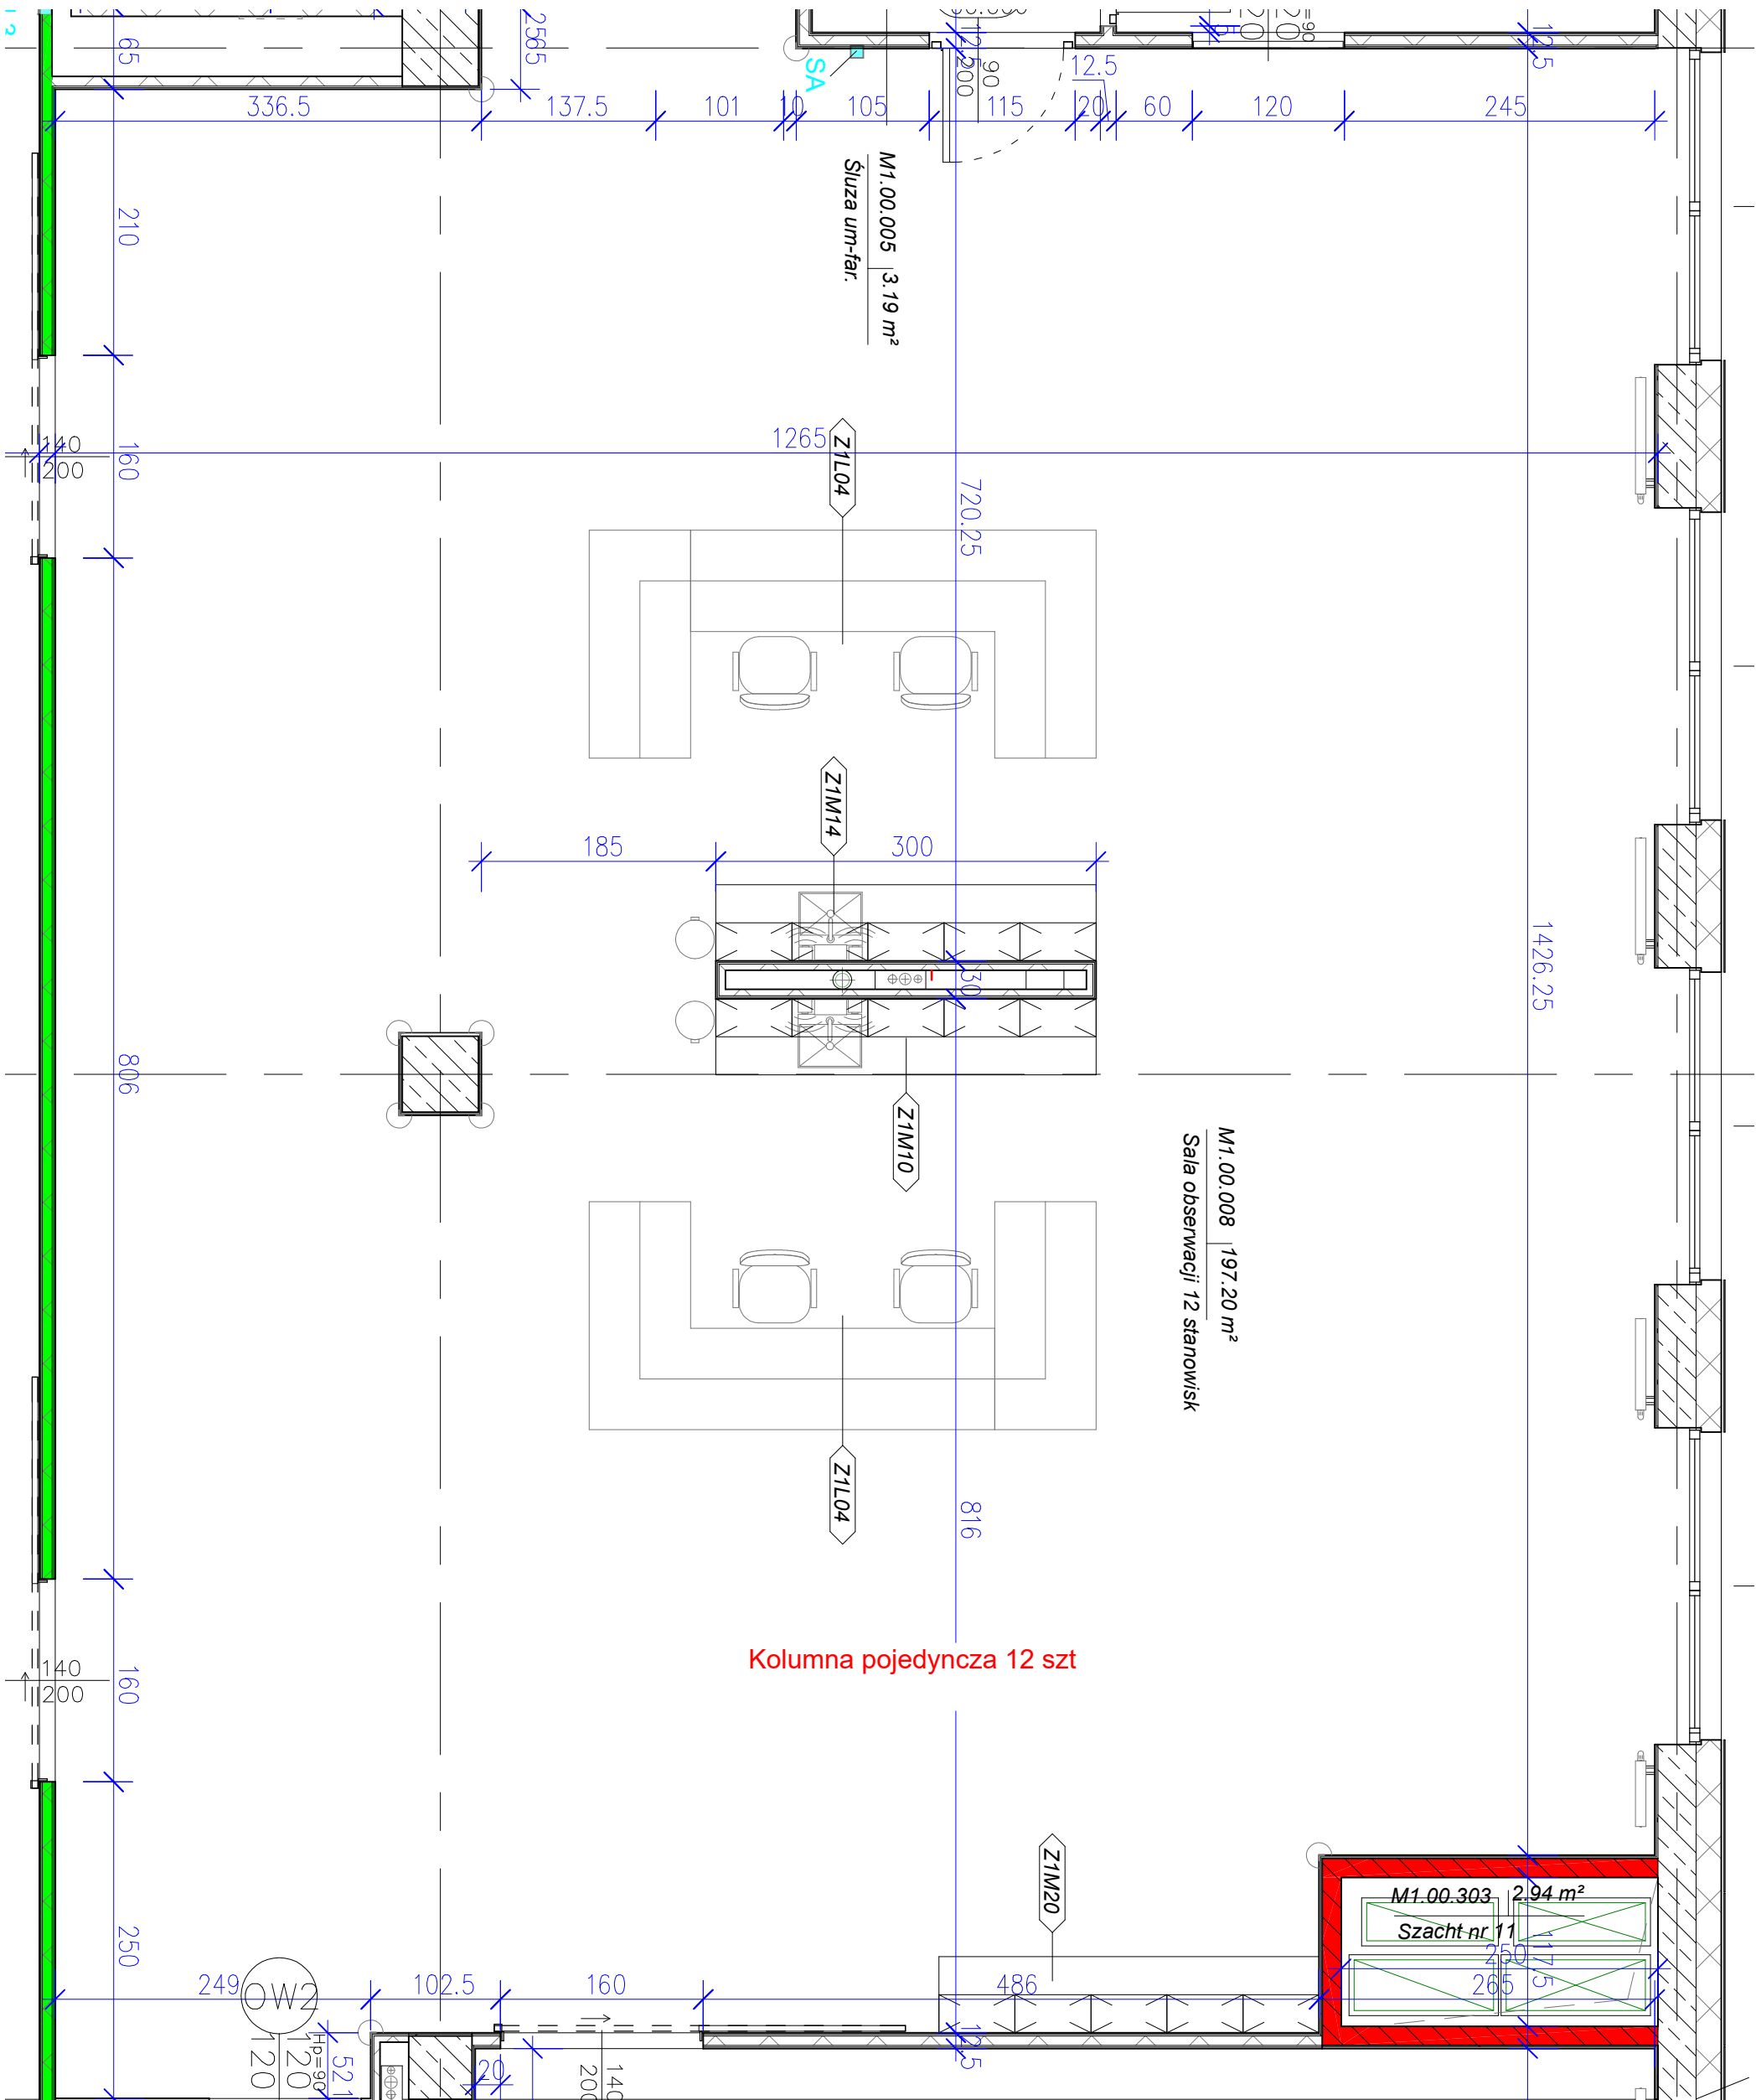


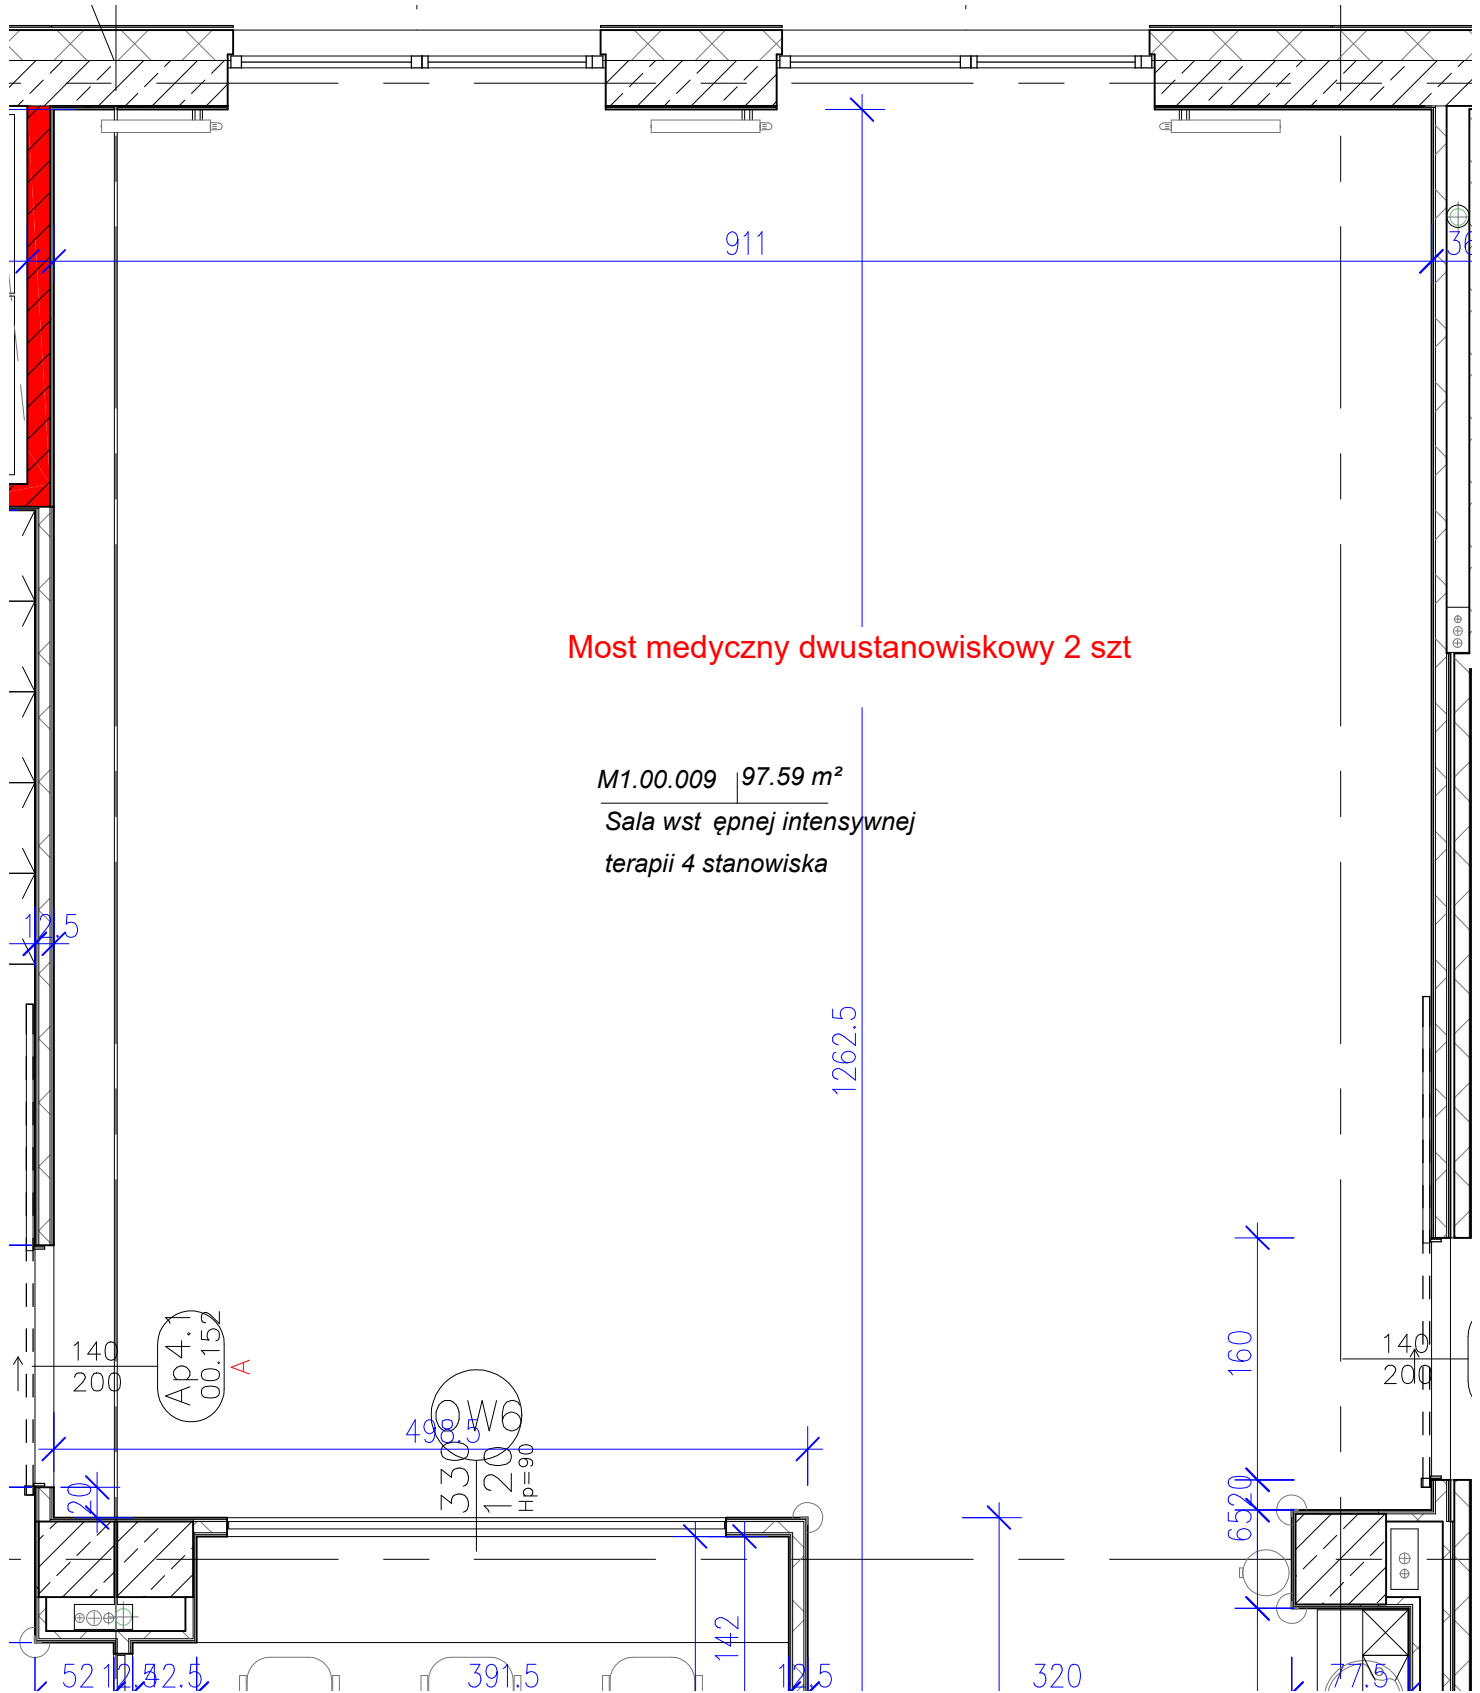


# RYSUNEK NR 4

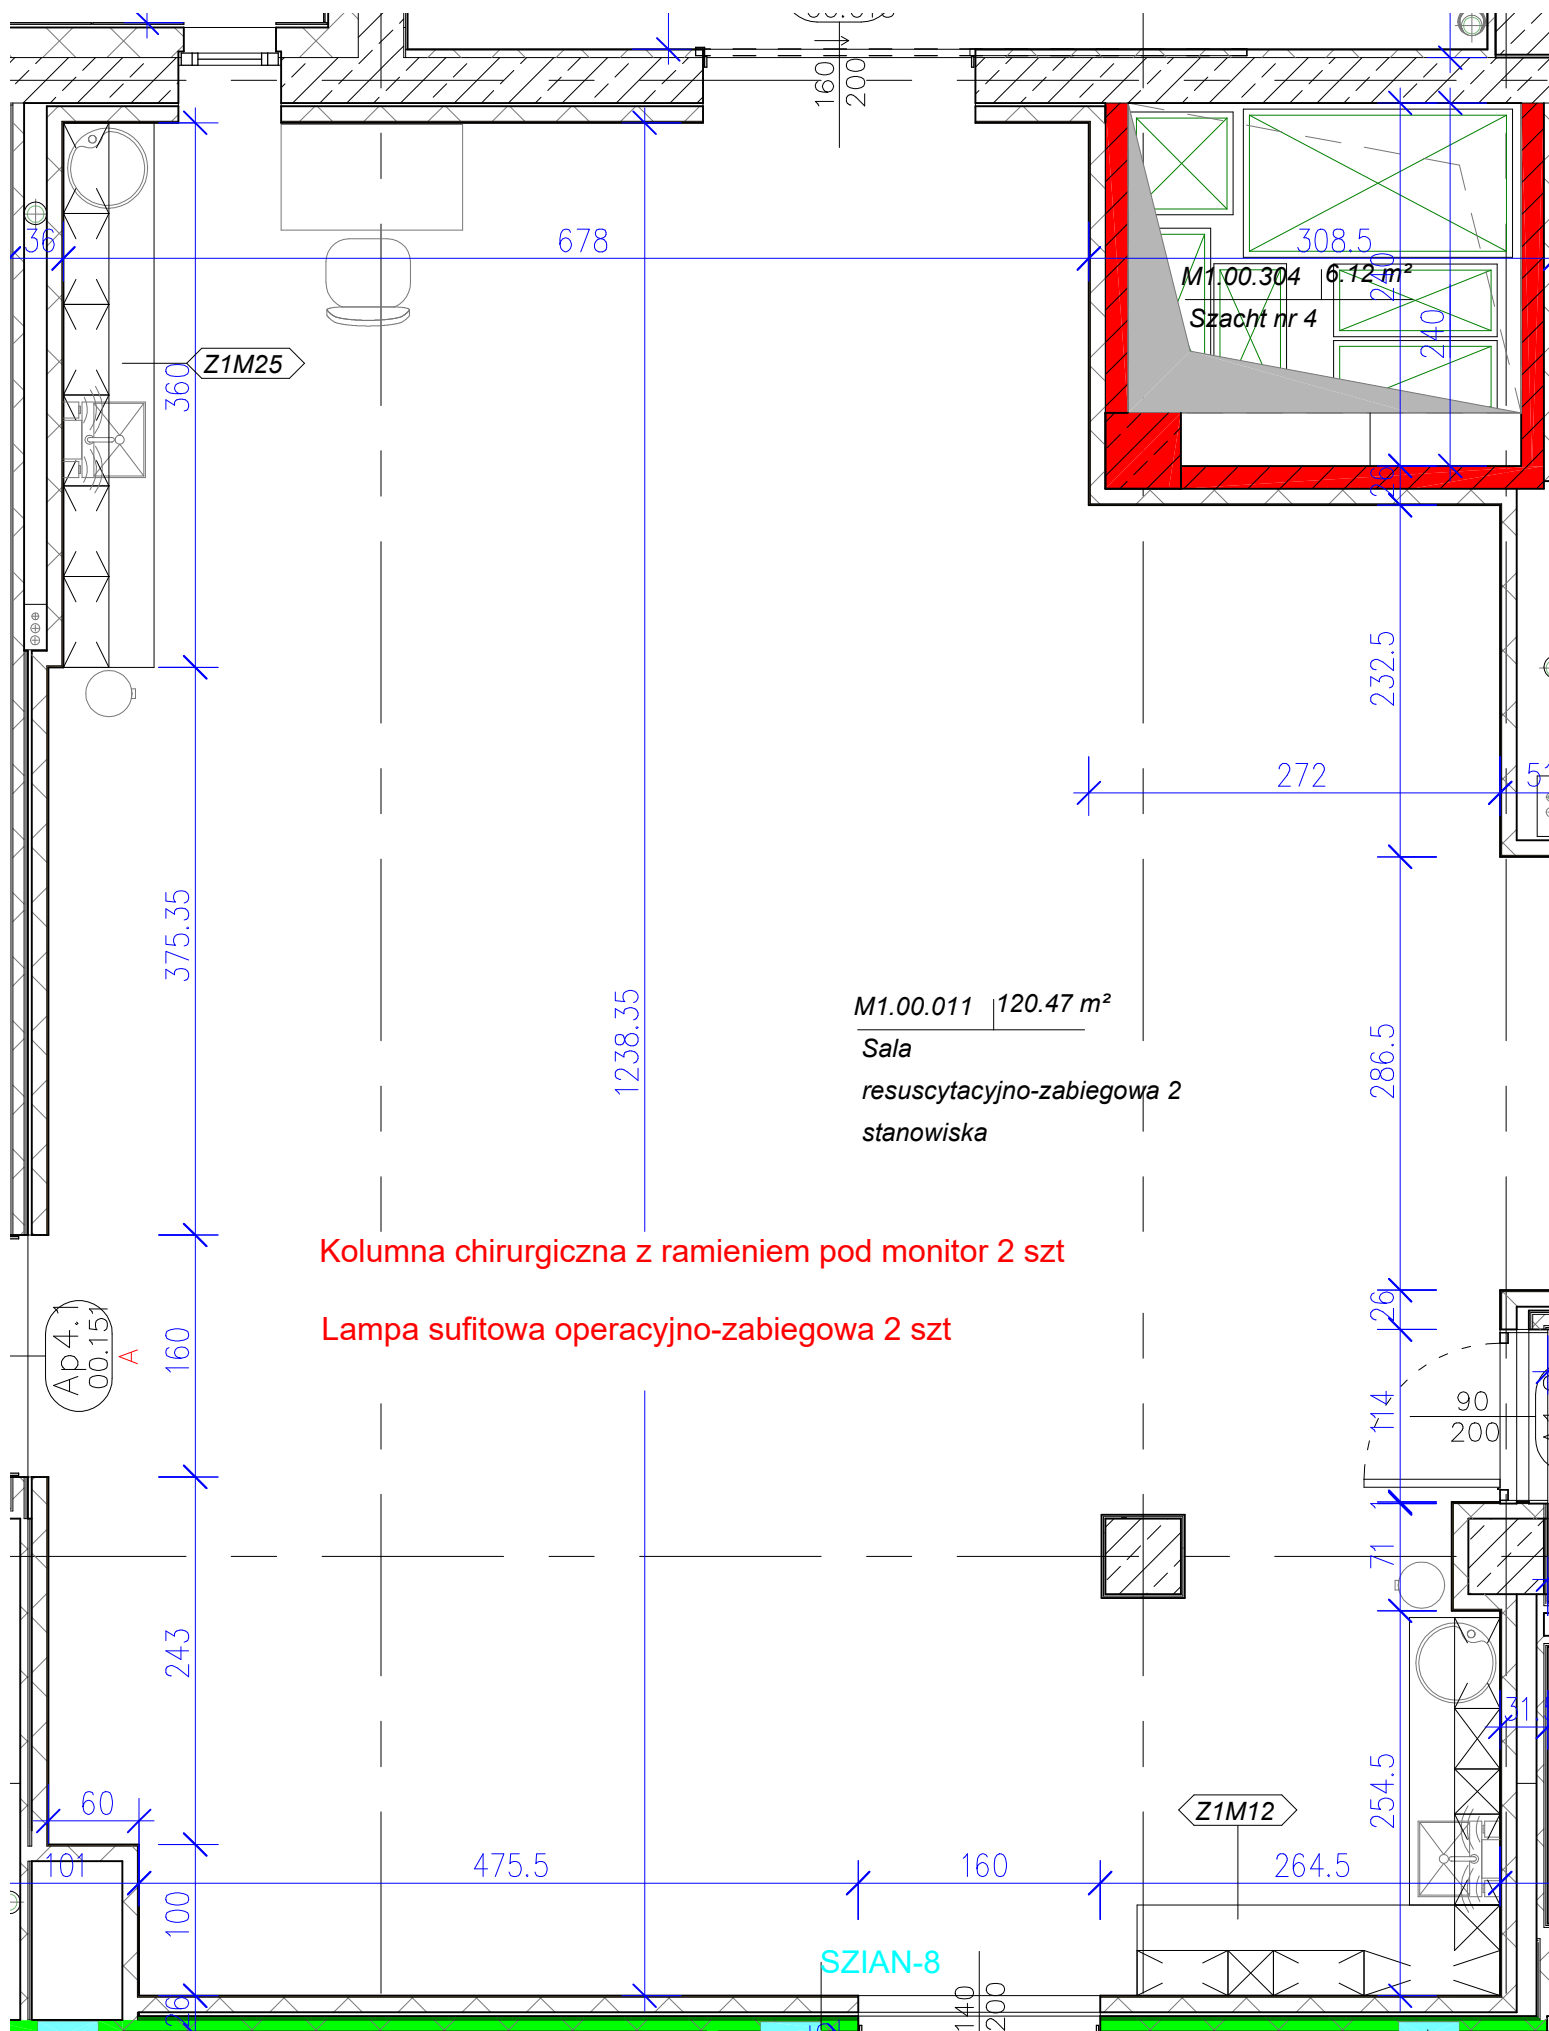







Myjnia do kaczek i basenów 1 szt

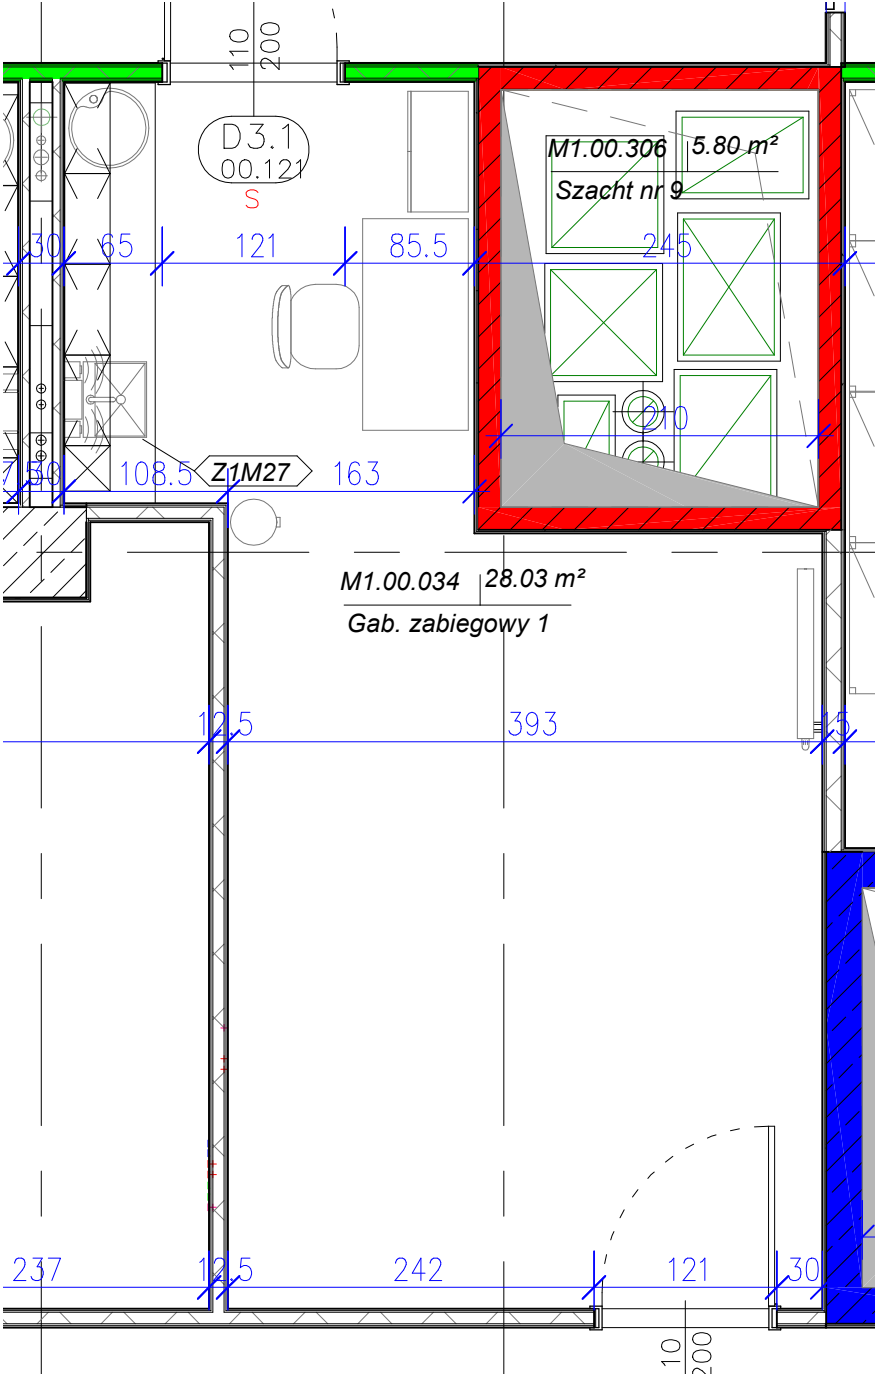

Lampa zabiegowa 1 szt




Lampa zabiegowa 1 szt




Lampa zabiegowa 1 szt






Lampa zabiegowa 1 szt



Myjnia do kaczek i basenów 1 szt


Kolumna pojedyncza 5 szt






Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Lampa operacyjna 1 szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Lampa operacyjna 1szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Lampa operacyjna 1 szt



Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt



Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt





Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt

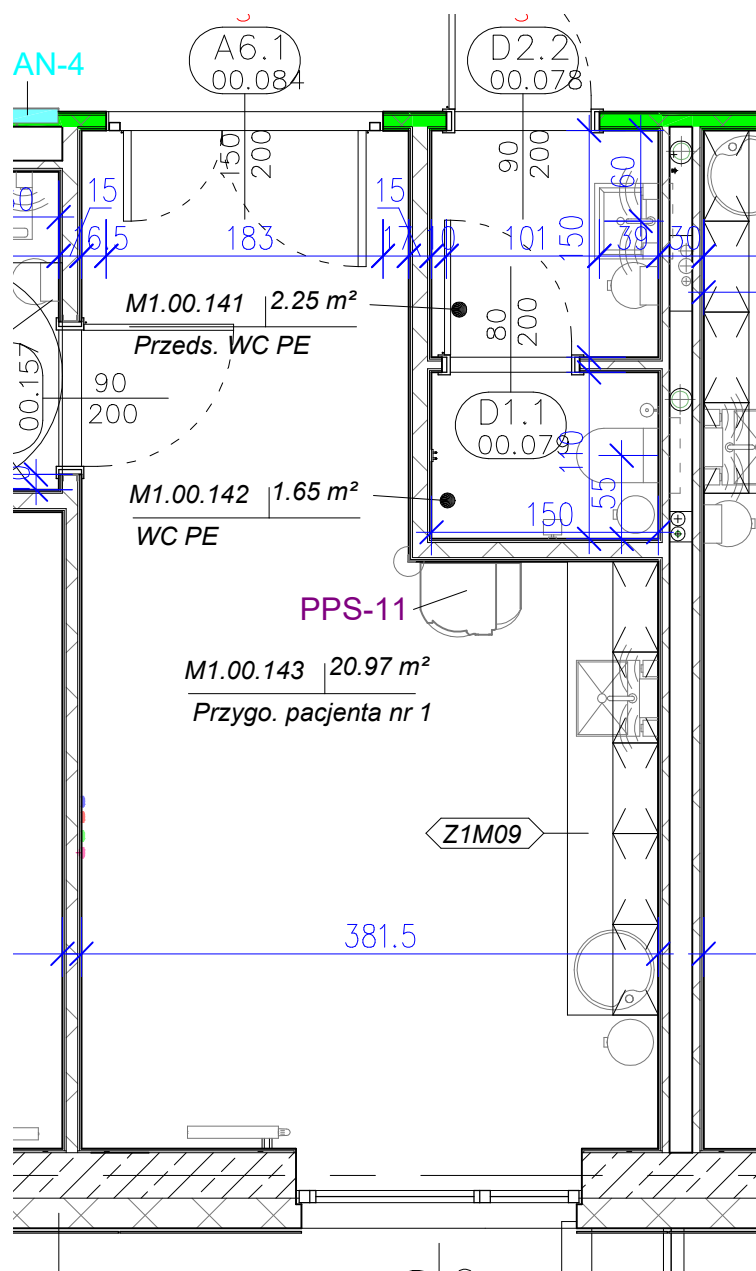


Kolumna pojedyncza 1 szt


Lampa zabiegowa 1 szt



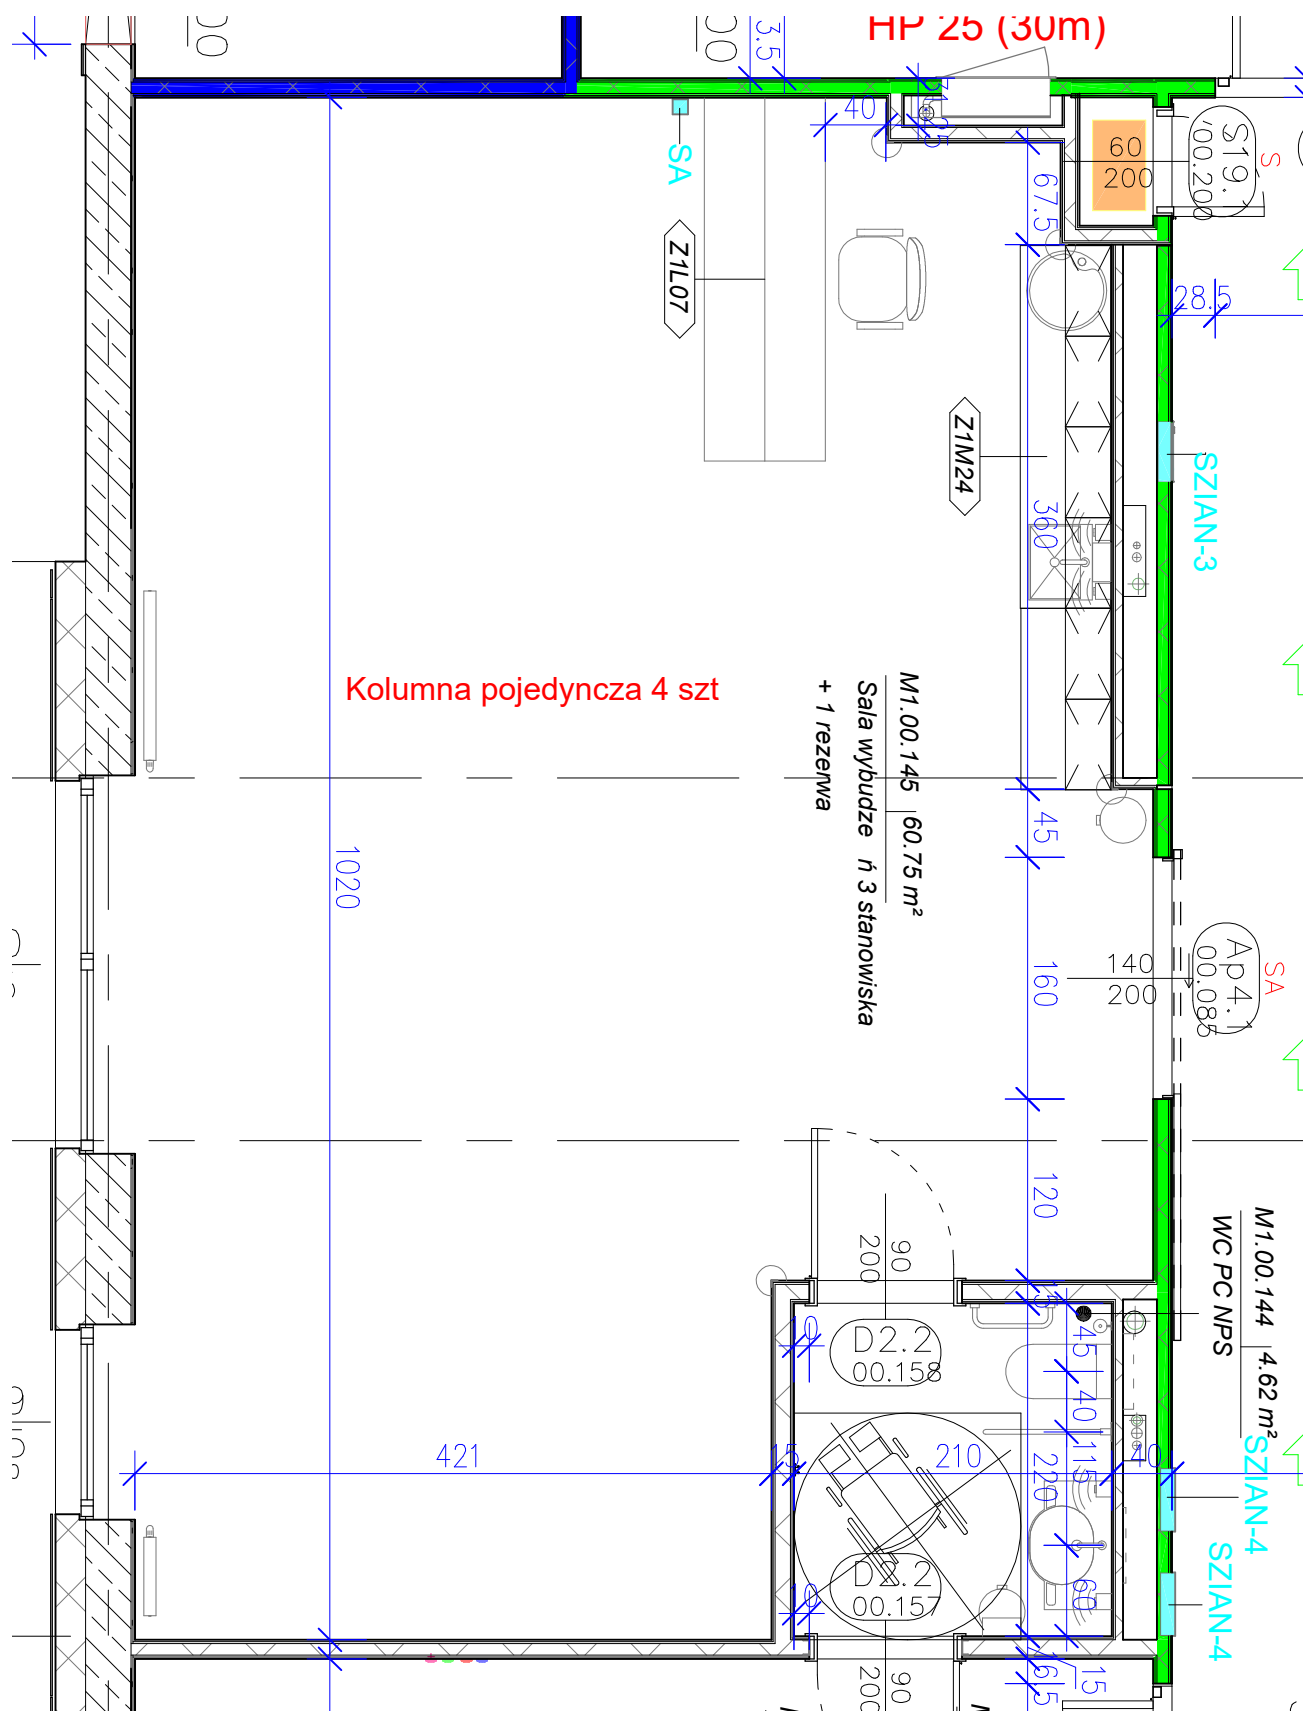




Most medyczny trzystanowiskowy 1 szt




Most medyczny trzystanowiskowy 1 szt

Myjnia do kaczek i basenów 1 szt




Most medyczny jednostanowiskowy 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów 1 szt



Most medyczny jednostanowiskowy 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów 1szt







Myjnia do kaczek i basenów 1 szt



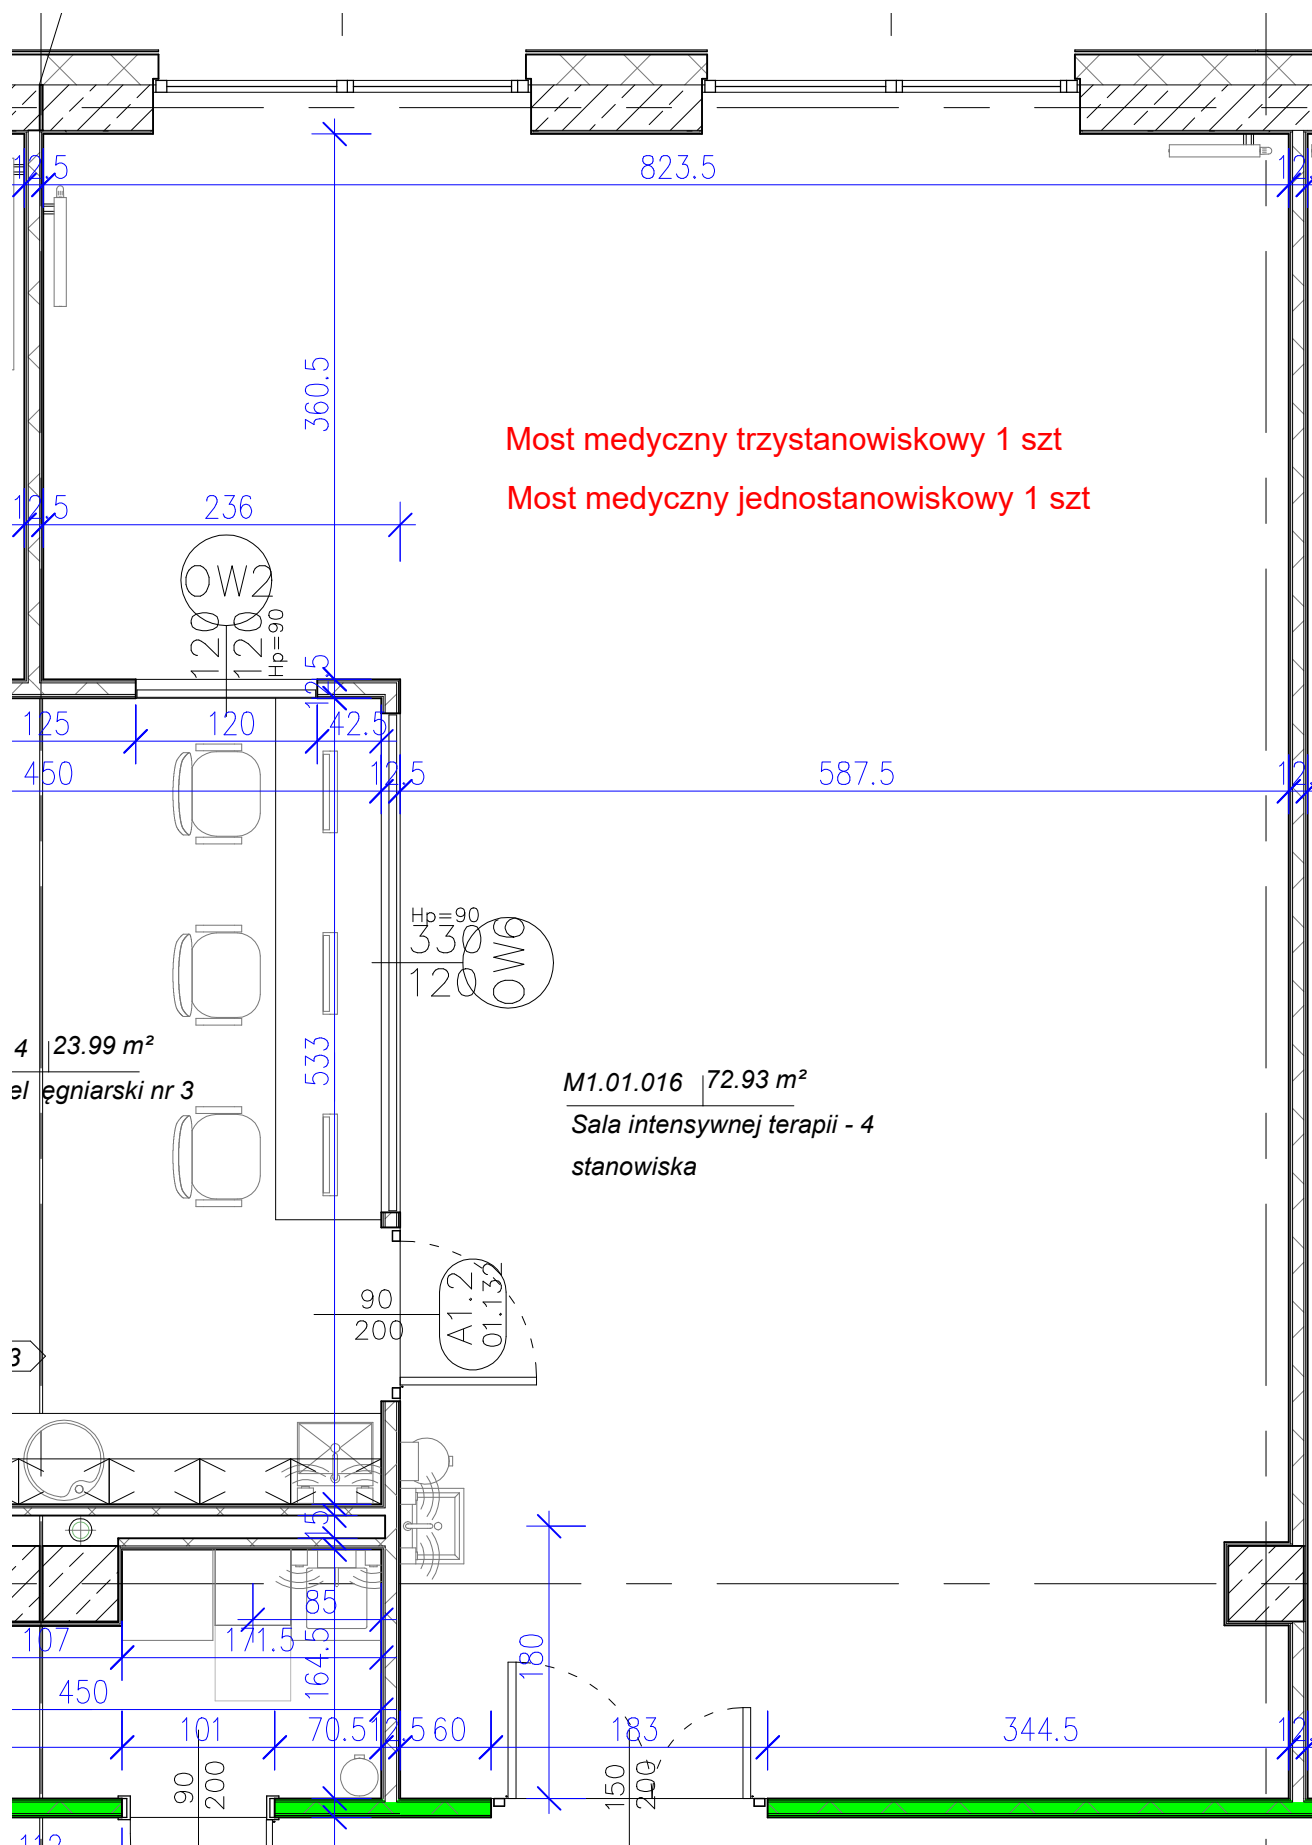










Most medyczny jedno stanowiskowy 3 szt

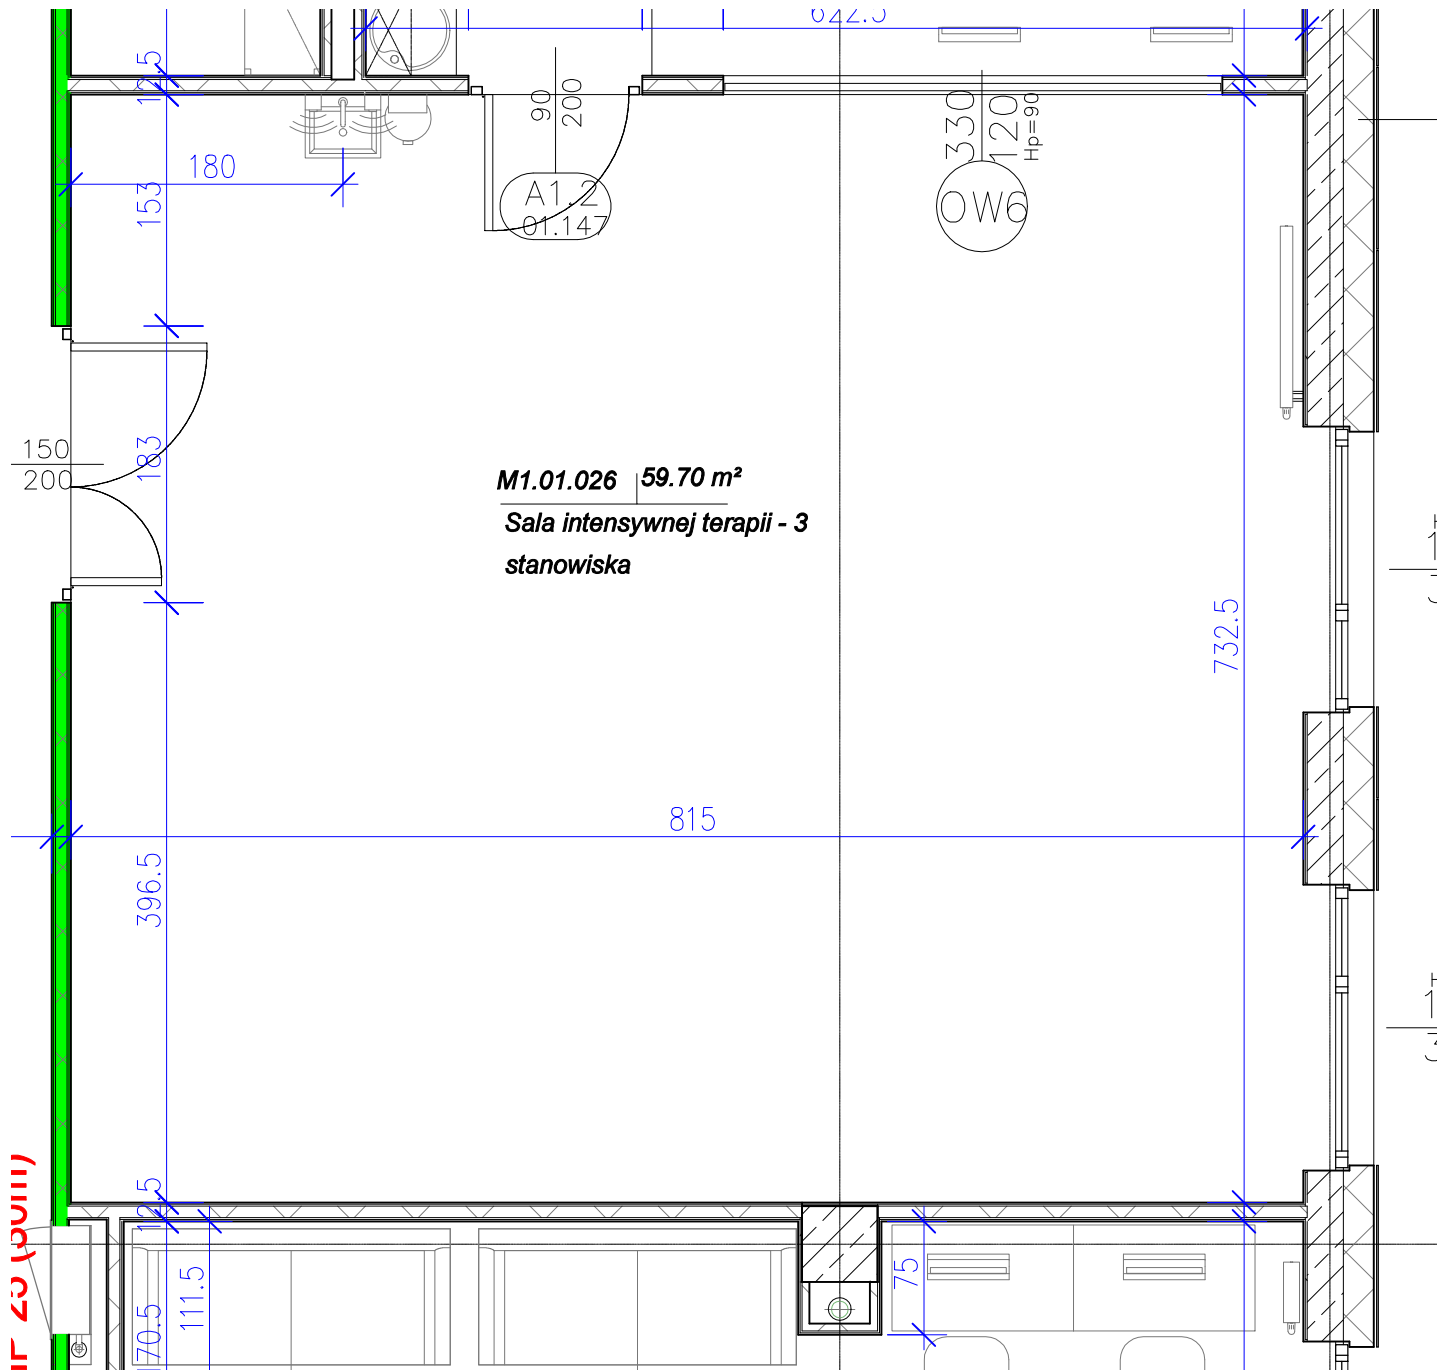


Most medyczny jednostanowiskowy 3 szt

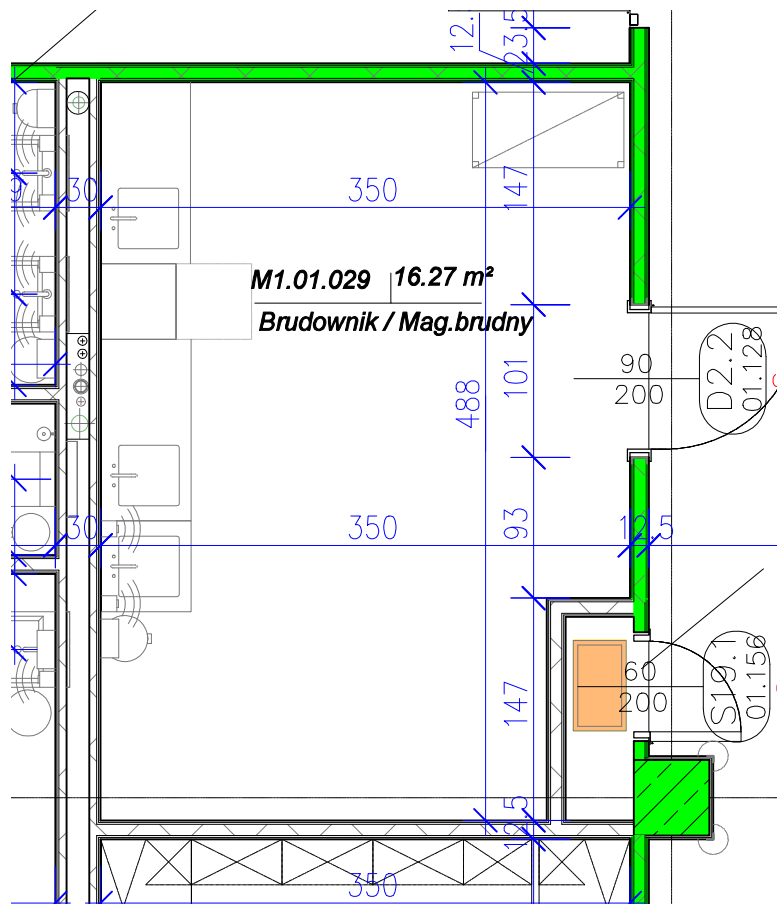

Myjnia do kaczek i basenów 1 szt




Lampa zabiegowa 1 szt




Myjnia do kaczek i basenów 1 szt






Most medyczny jednostanowiskowy 1 szt

Myjnia do kaczek i basenów 1 szt




Most medyczny jednostanowiskowy 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów 1 szt










Myjnia do kaczek i basenów 1 szt

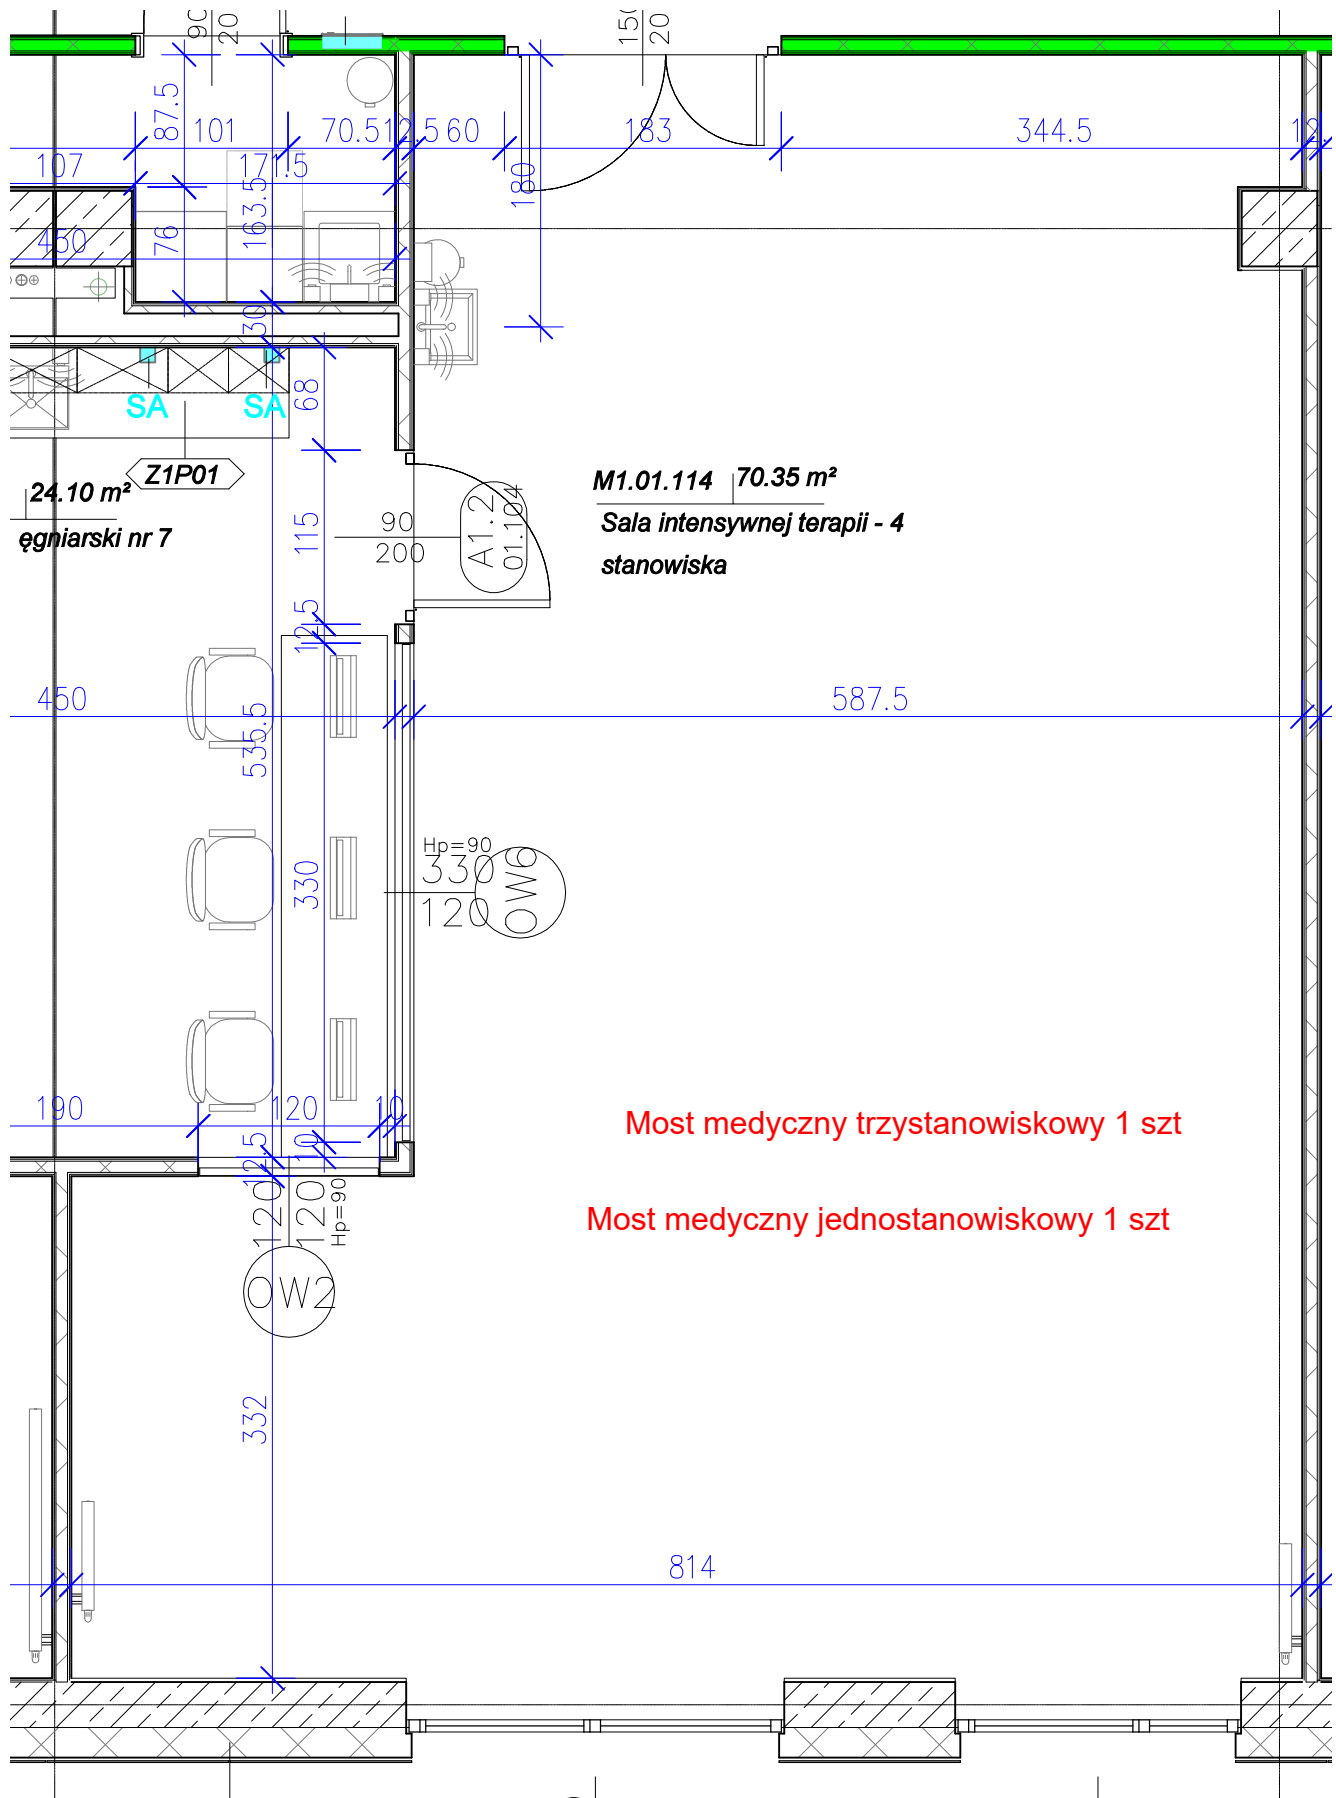



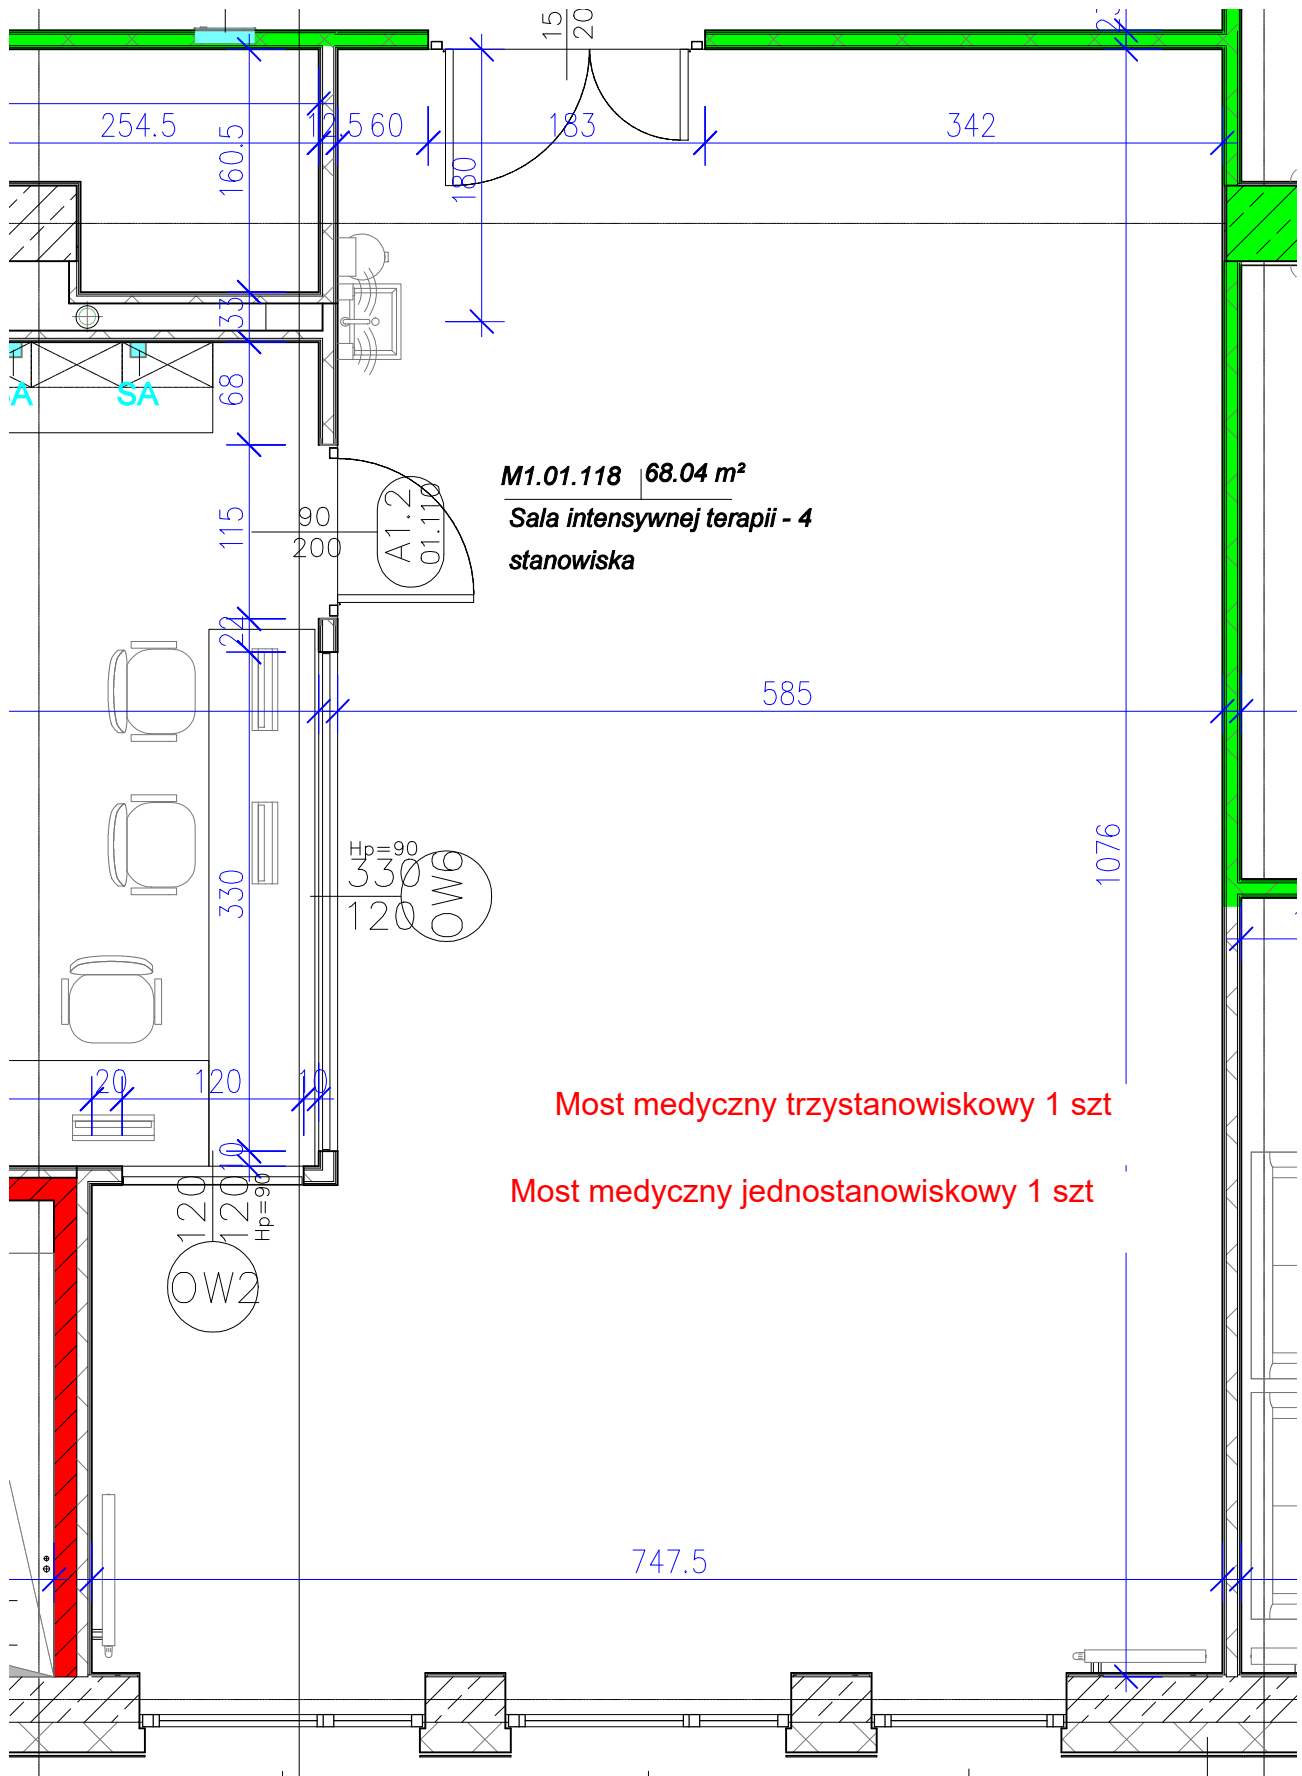






Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Kolumna anestezyjologiczna z windą 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt



Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt

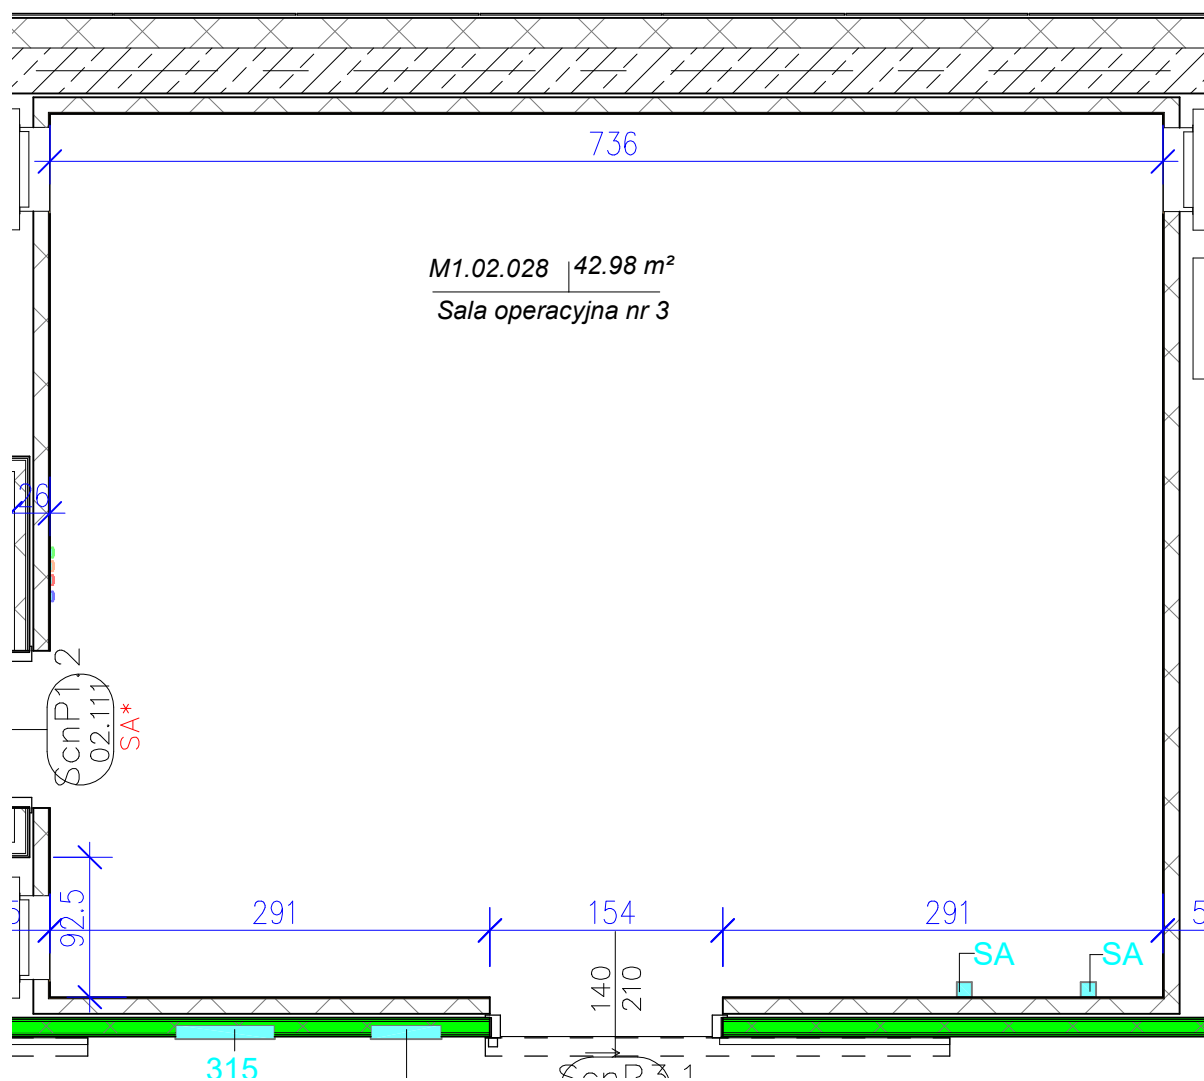

Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt





Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt


Kolumna anestezyjologiczna z windą 1 szt

Lampa operacyjna 1 szt

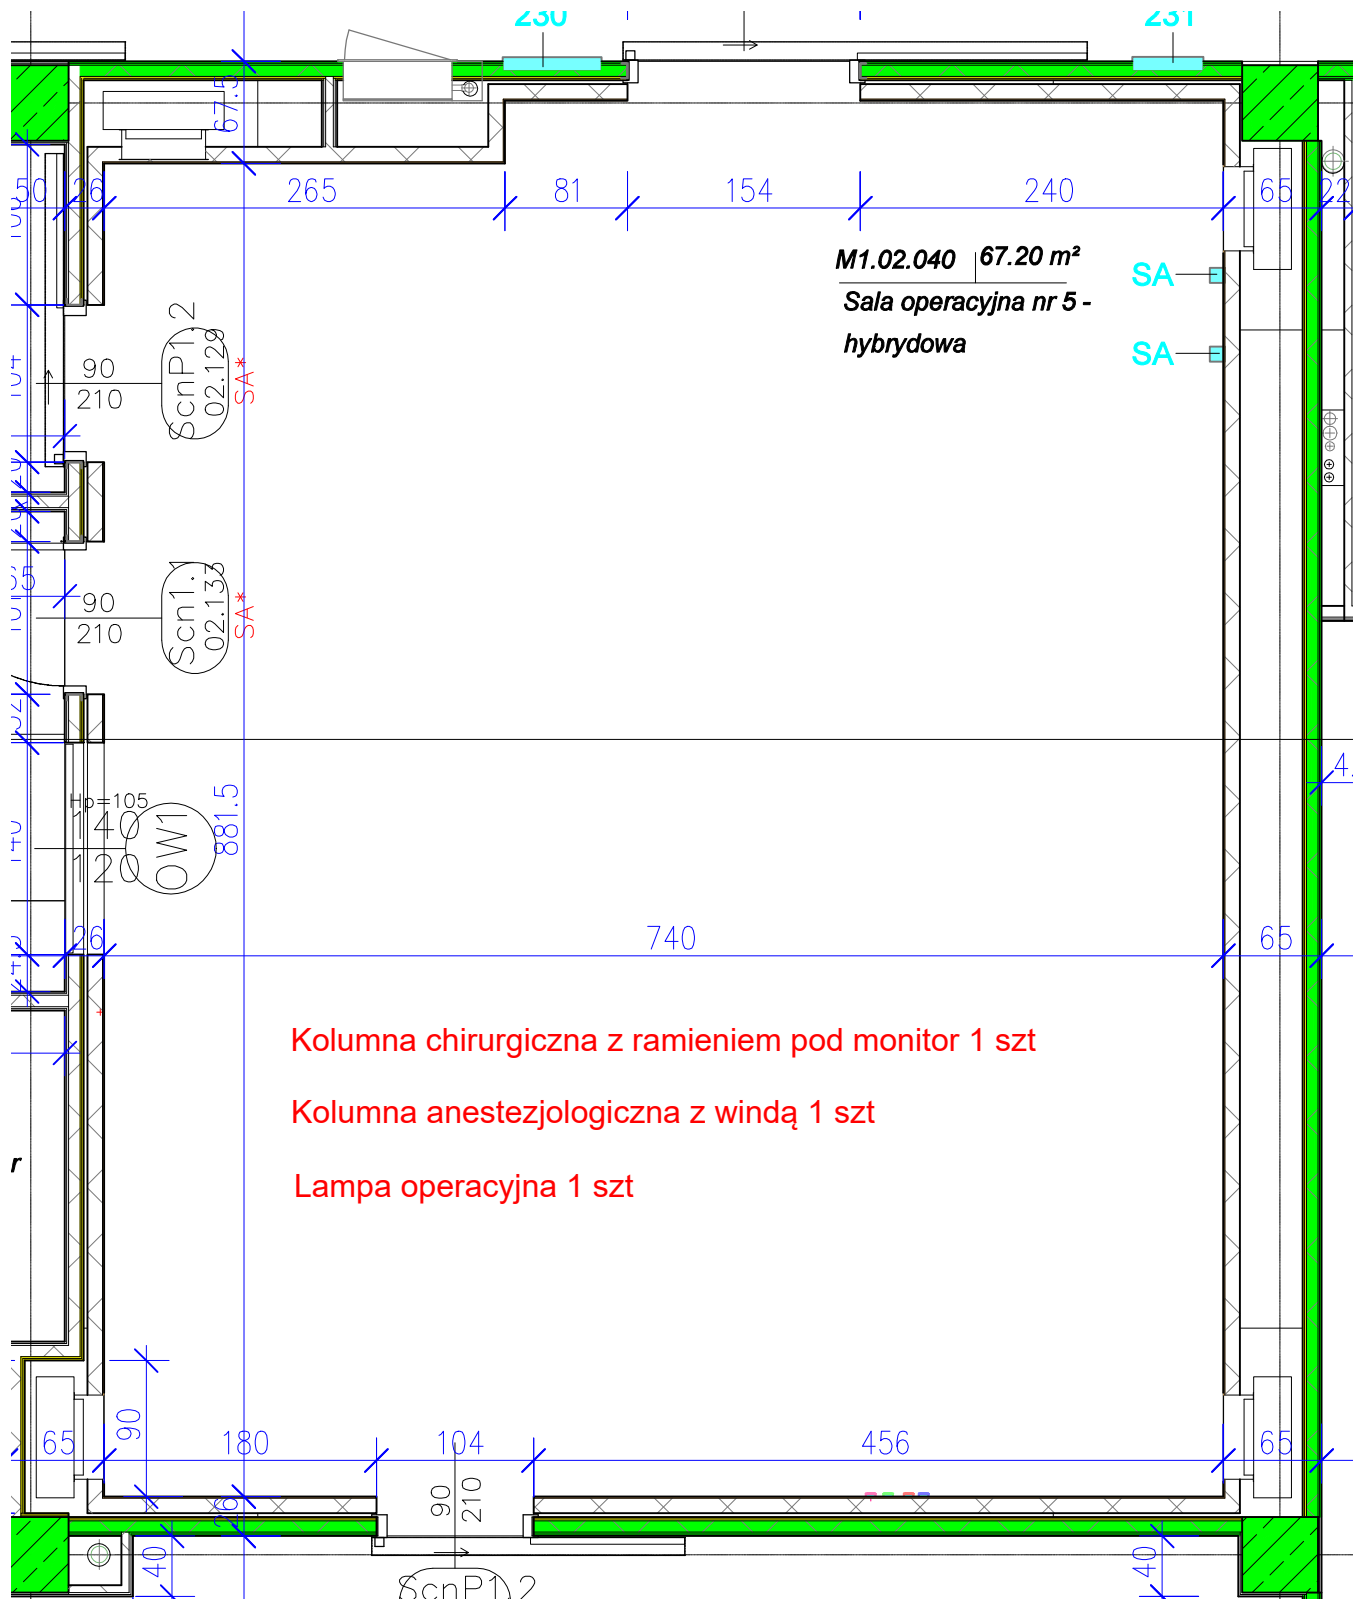


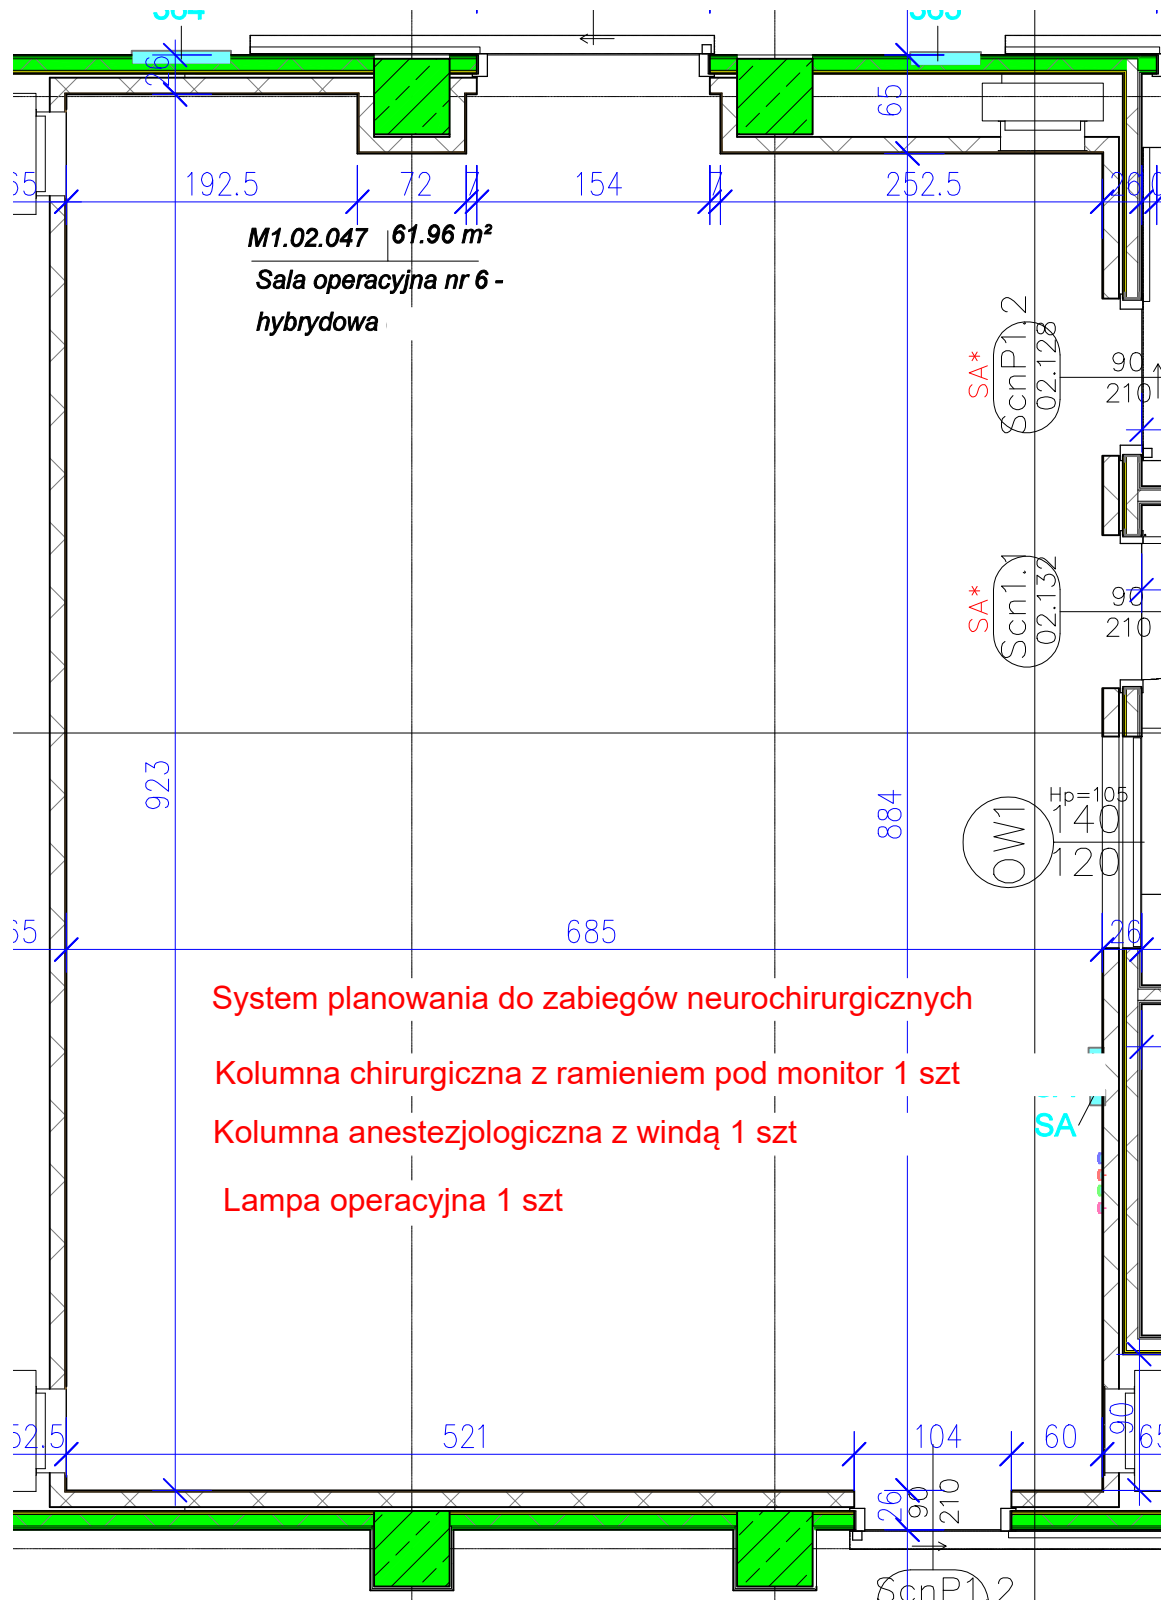


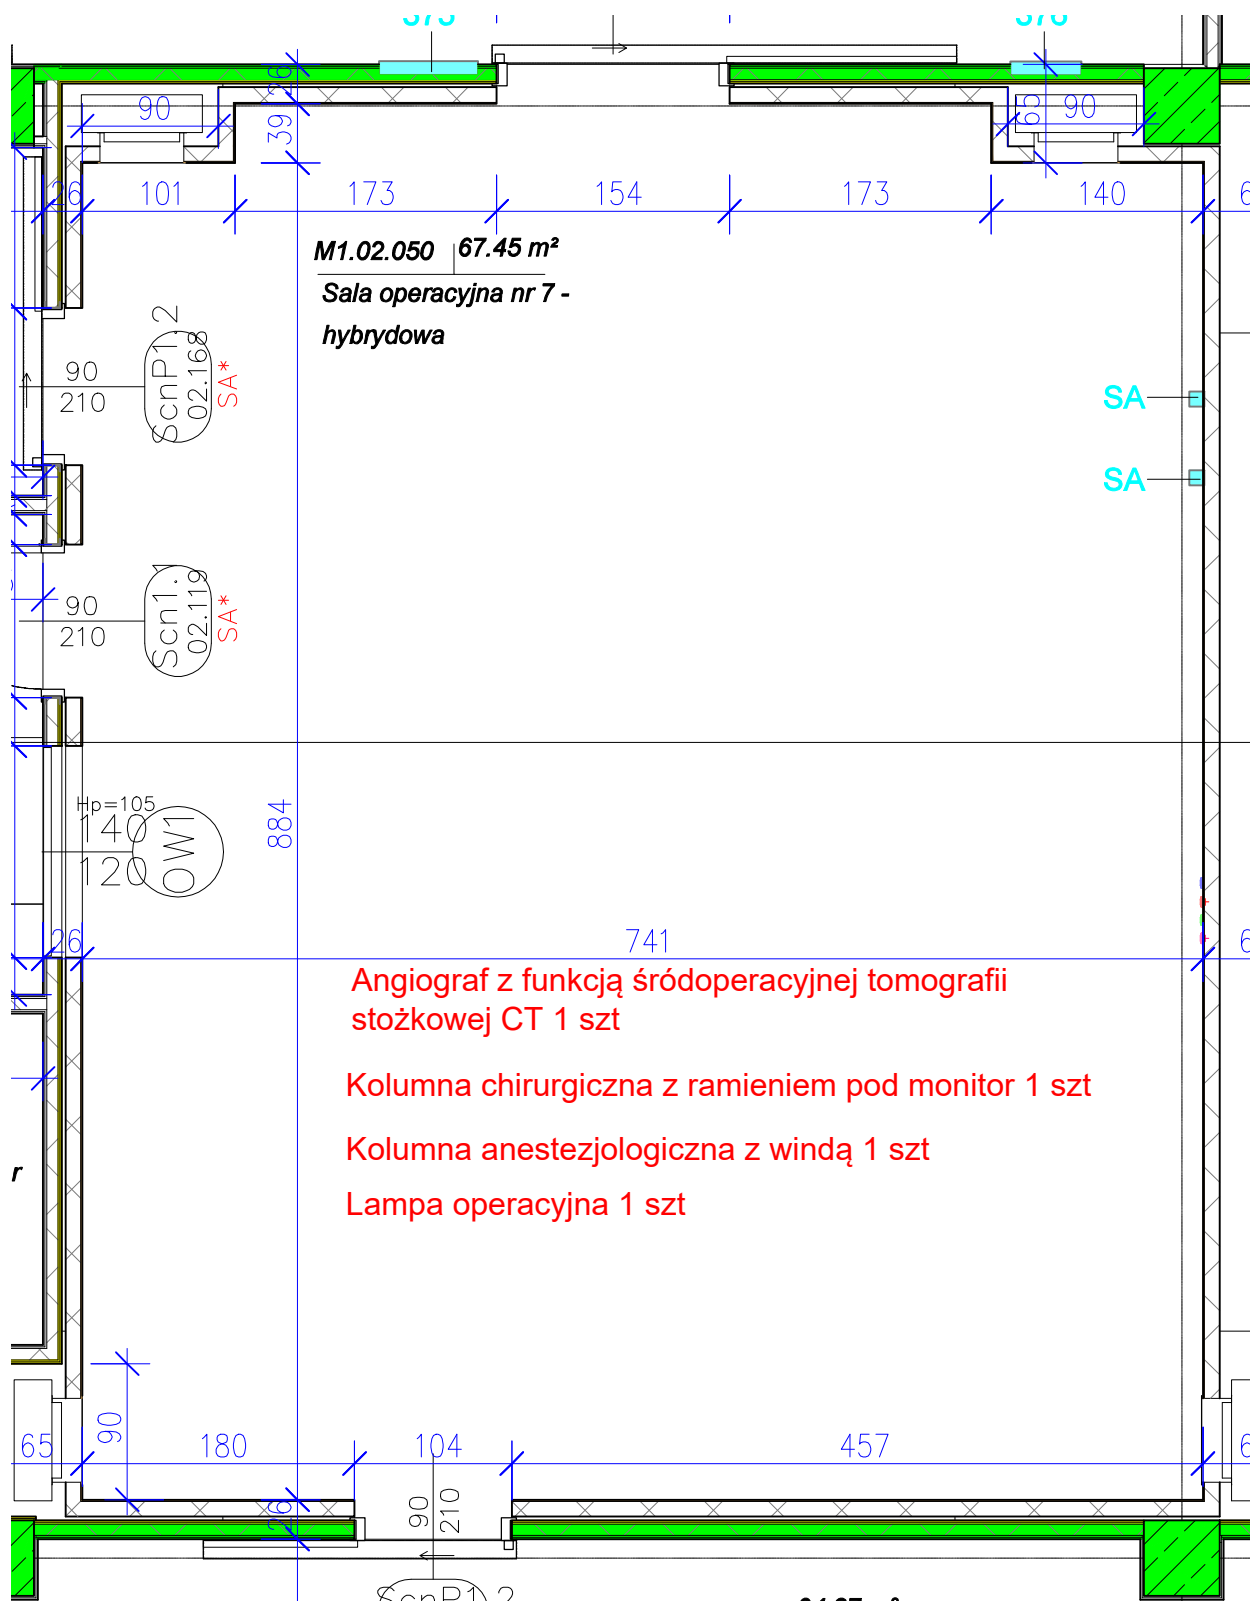






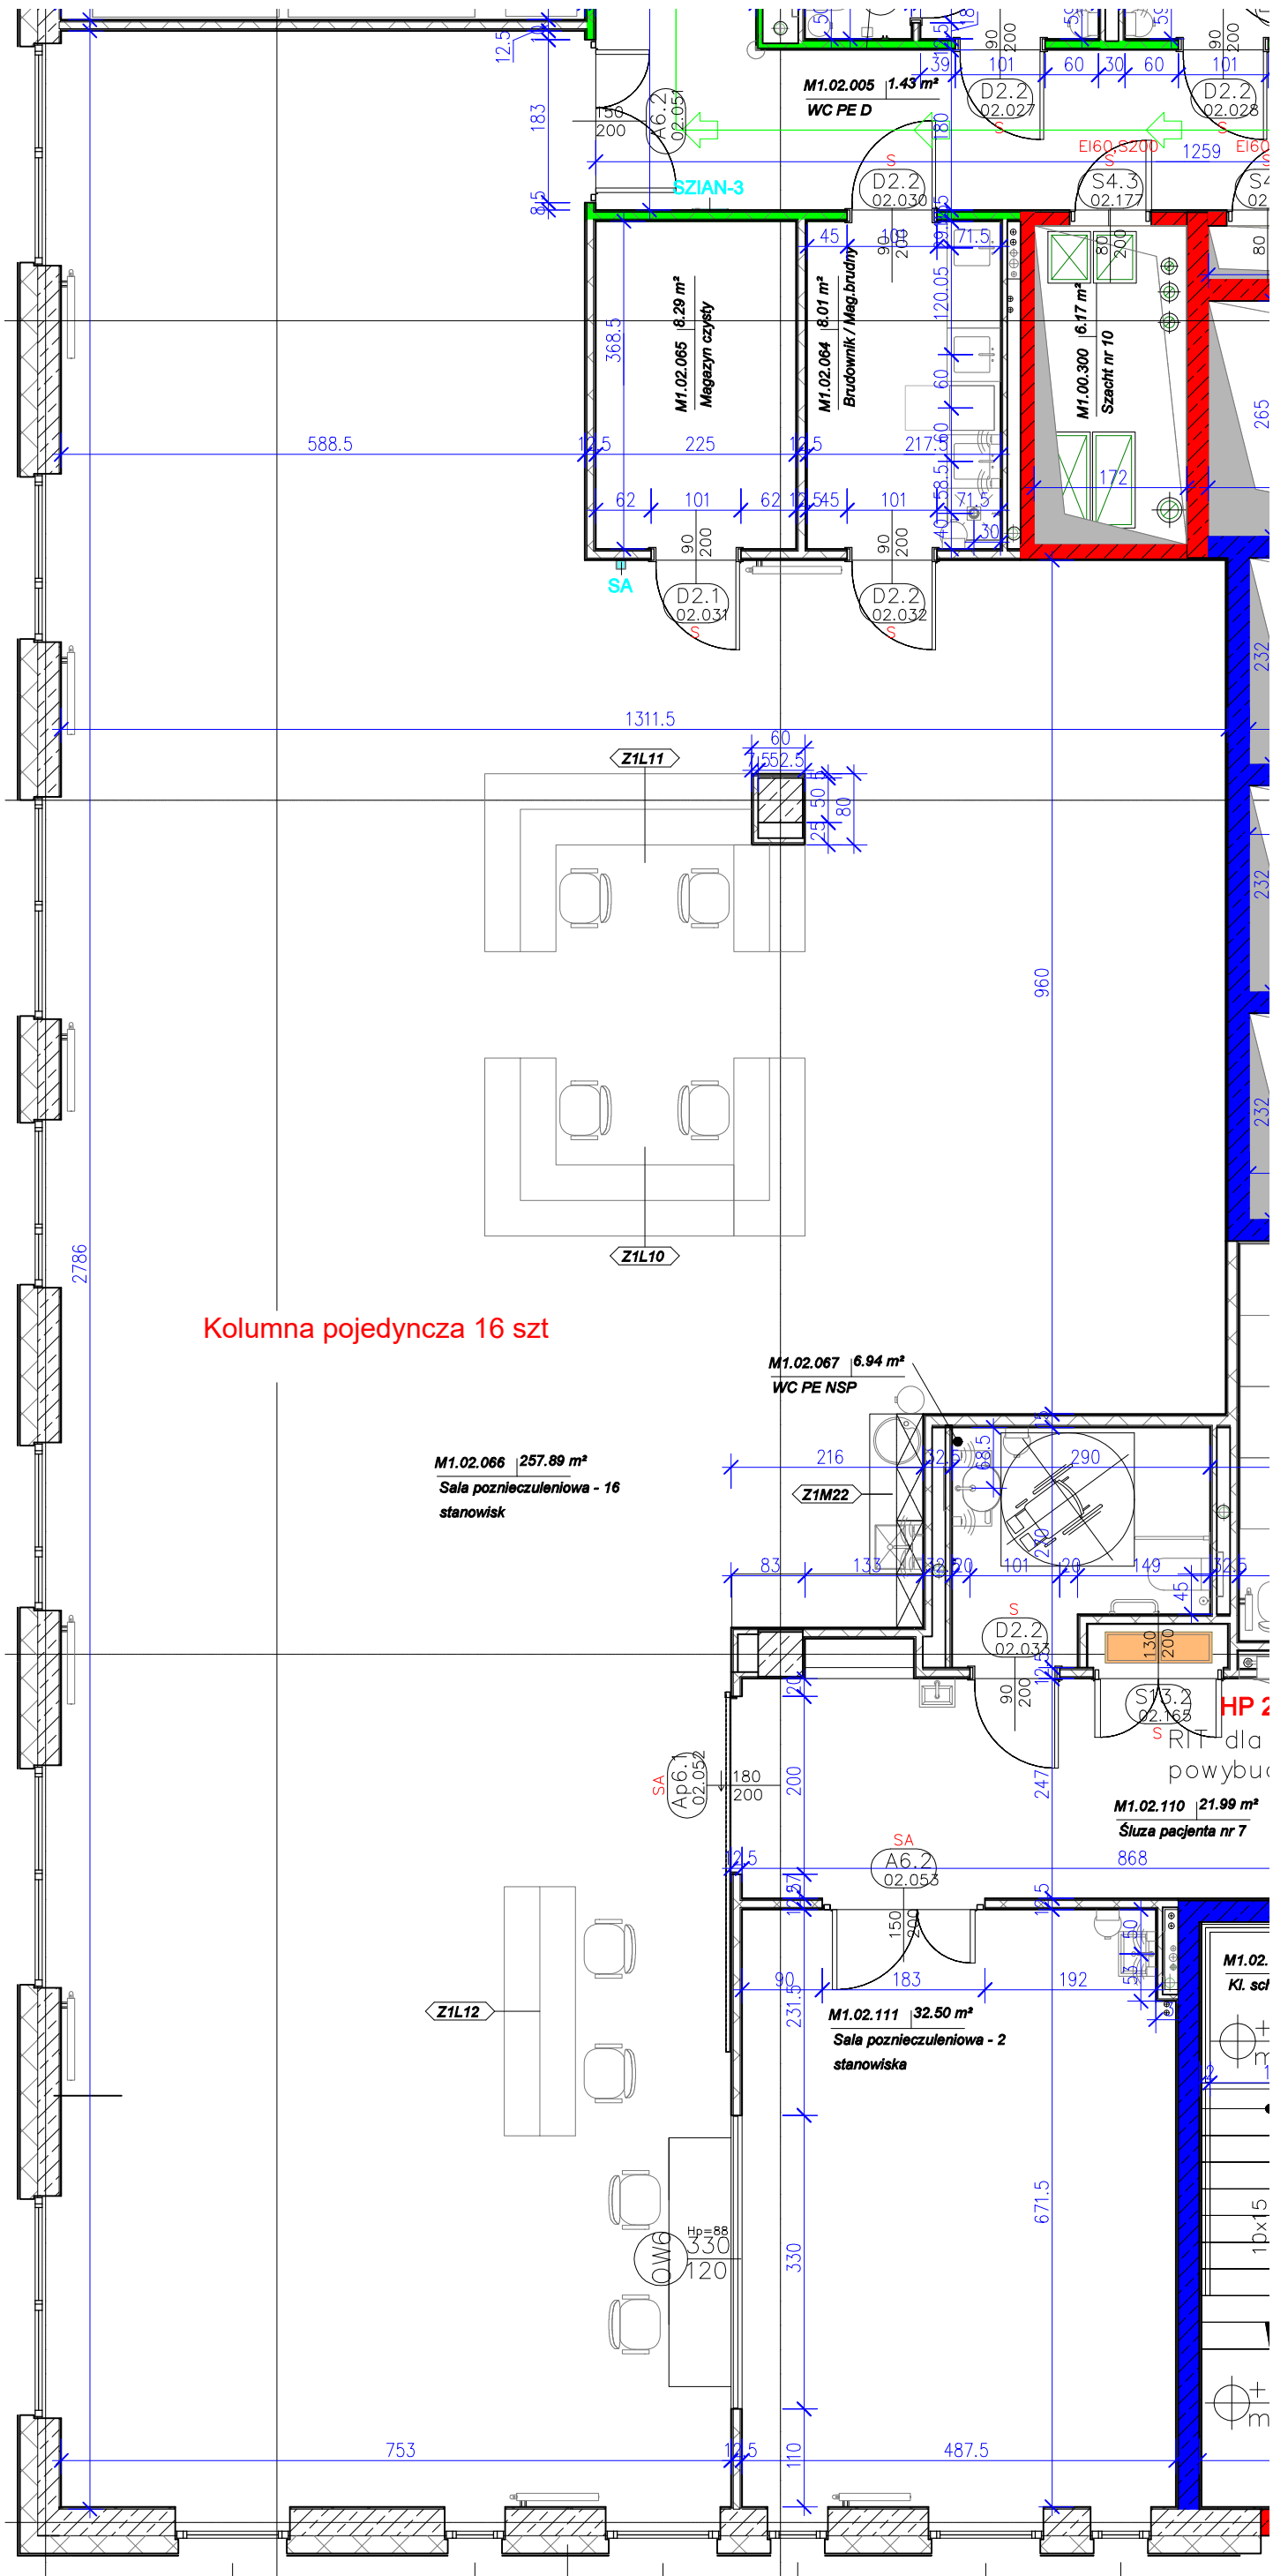




Myjnia do kaczek i basenów 1 szt

RYSUNEK NR 55

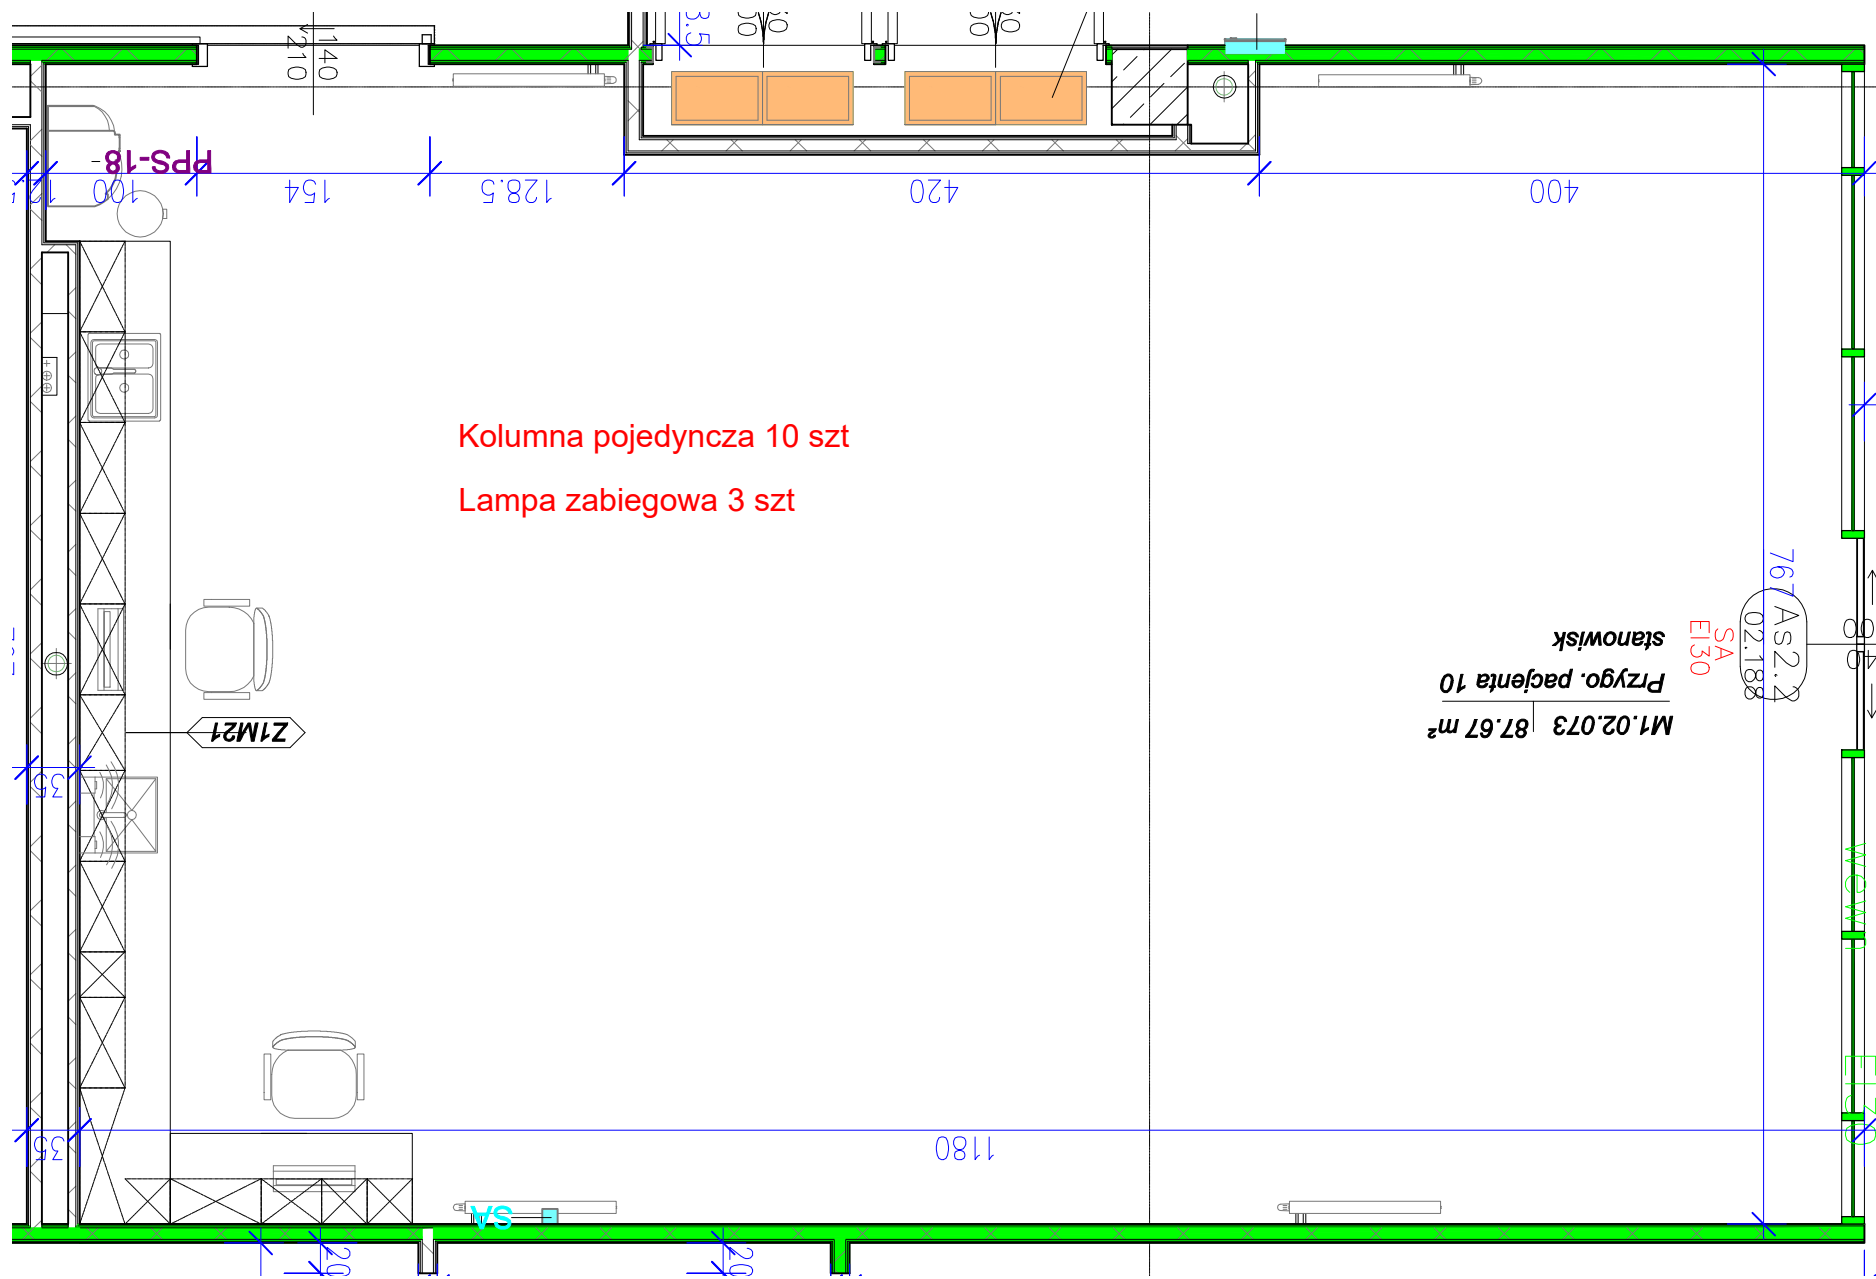





Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą 1 szt

Lampa operacyjna 1 szt

Lampa operacyjna 1 szt

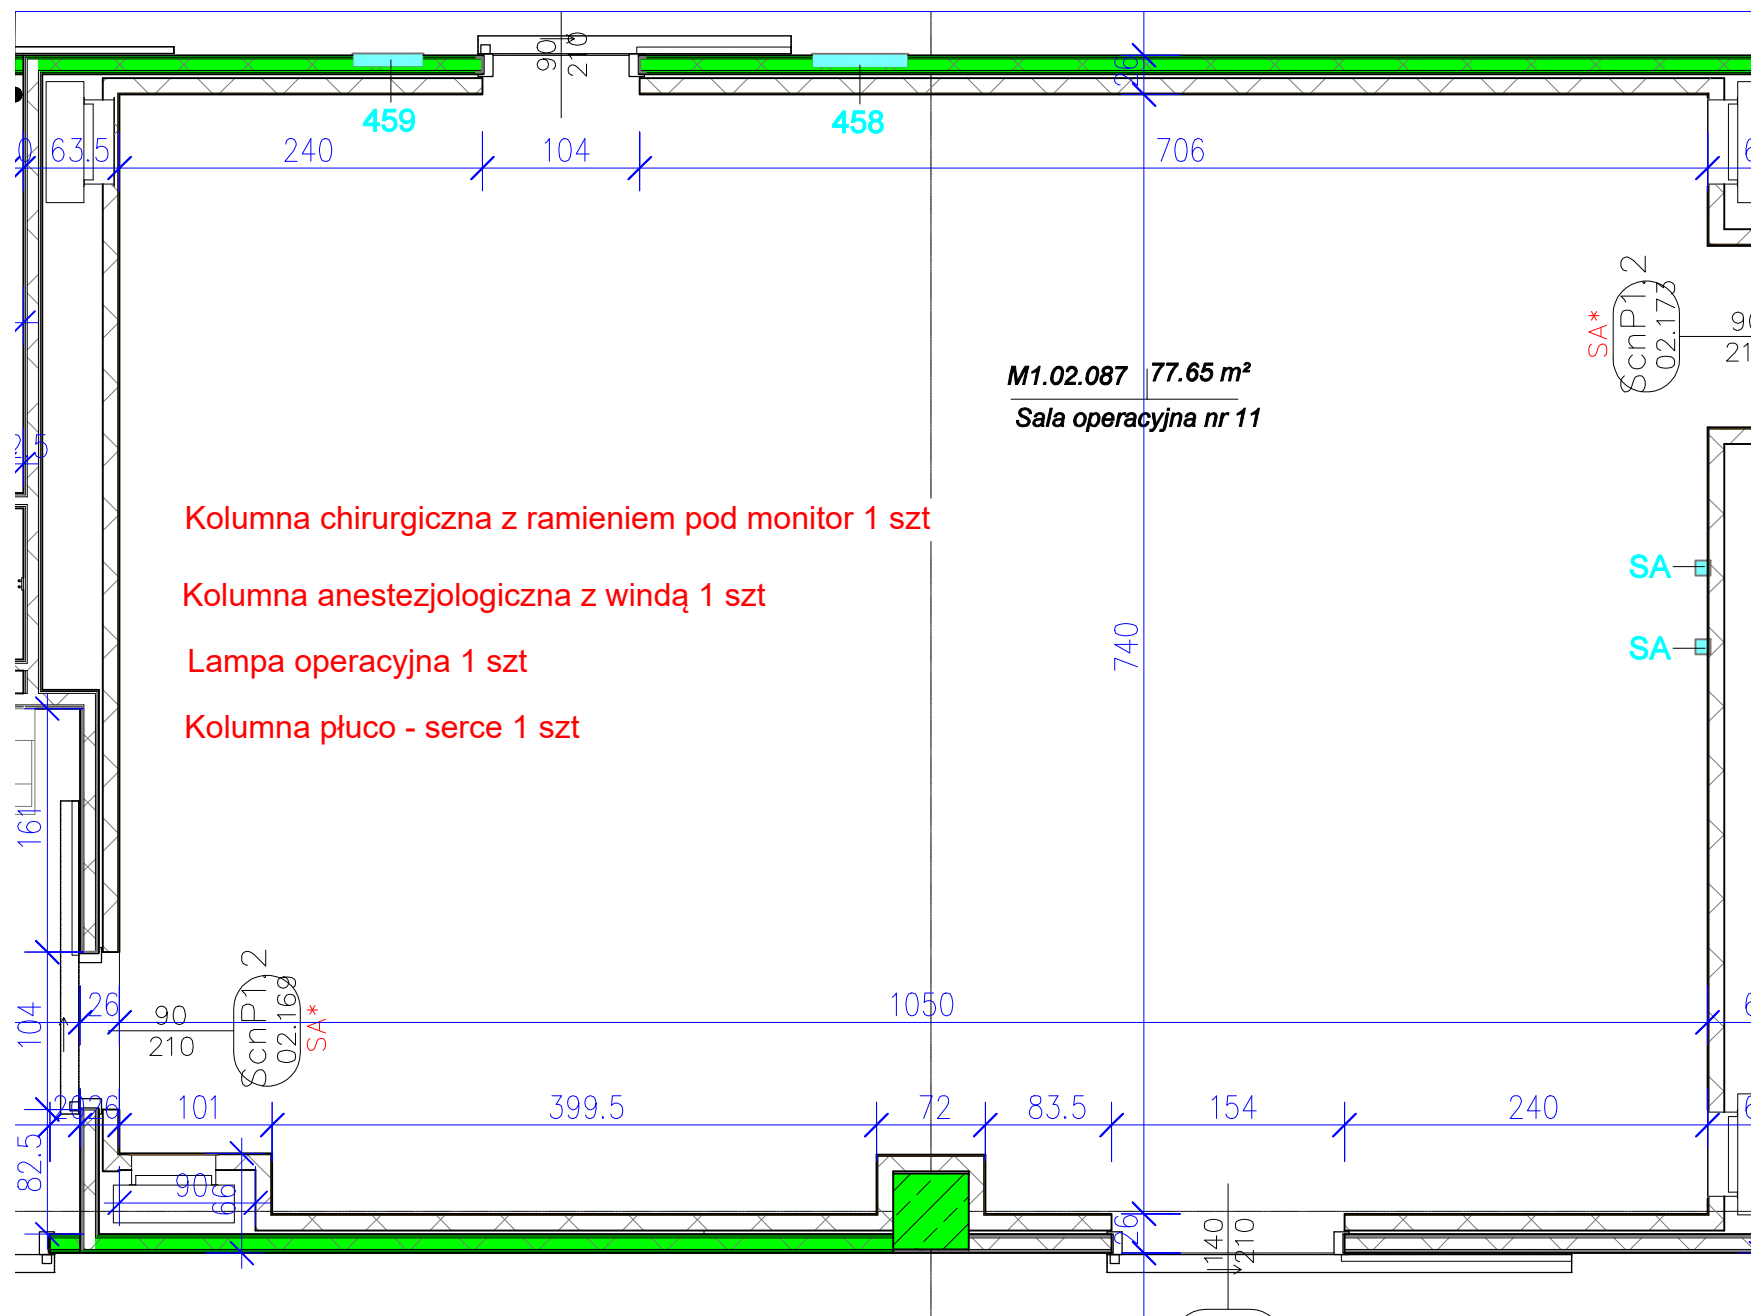


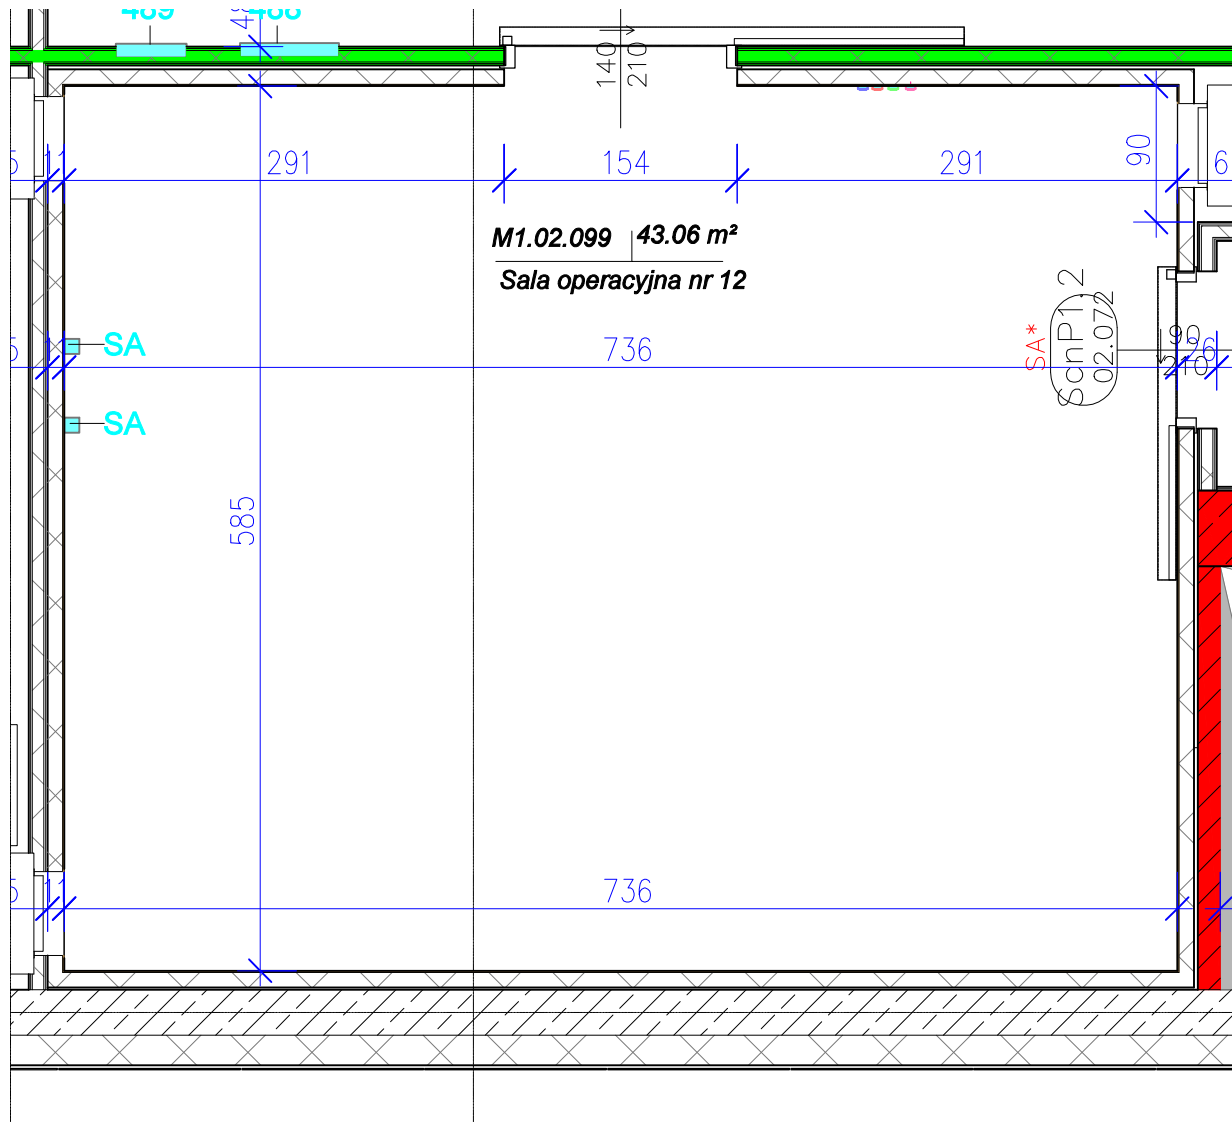

Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą 1szt

Lampa operacyjna 1szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą 1 szt

Lampa operacyjna 1 szt




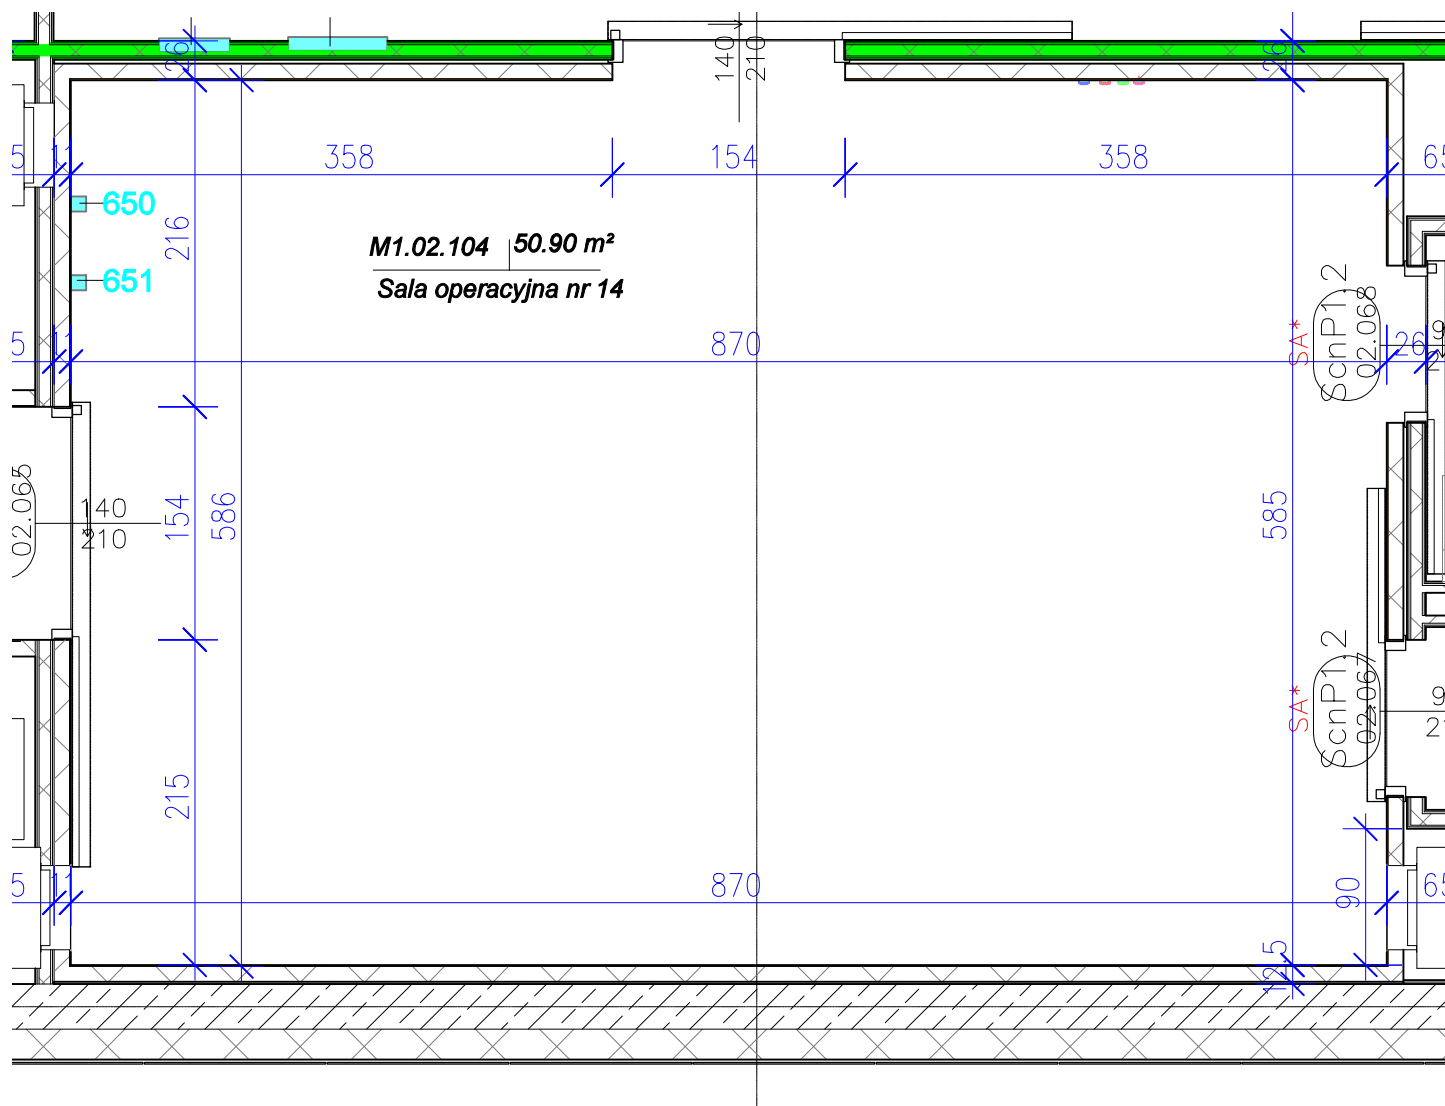

Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Kolumna anestezjologiczna z windą 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1szt

Kolumna anestezyjologiczna z windą 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt




Kolumna pojedyncza 2 szt




Lampa zabiegowa 1 szt



Lampa zabiegowa 1 szt




Lampa zabiegowa 1 szt



Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt



Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt


Lampa operacyjna 1 szt






Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Lampa operacyjna 1 szt




Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor 1 szt

Lampa operacyjna 1 szt

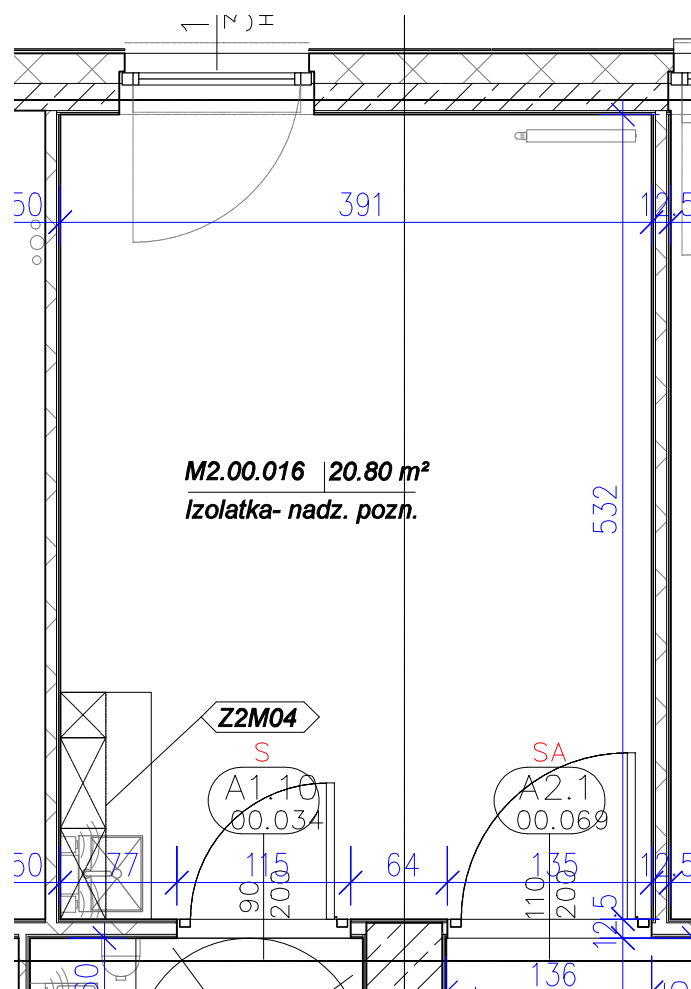


Most medyczny jednostanowiskowy 1 szt


Myjnia do kaczek i basenów 1 szt








Lampa zabiegowa 1 szt




Lampa zabiegowa 1 szt




Myjnia do kaczek i basenów 1 szt






Myjnia do kaczek i basenów 1 szt




Lampa zabiegowa 1 szt




Myjnia do kaczek i basenów 1 szt






Lampa zabiegowa 1 szt




Myjnia do kaczek i basenów 1 szt





Lampa zabiegowa 1 szt





Myjnia do kaczek i basenów 1 szt

