



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ



Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spozmswia.szczecin.pl biuro@spozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,

REGON 810733454, KRS 0000001757

WZAM.2354.10.931.2024

Szczecin, dnia 09.09.2024 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Dostawa materiałów medycznych i rękawic dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

**Nr postępowania: 10/2024.**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1: dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15, pozycja 1, jako produkt równoważny, worki na wymiociny, przezroczyste wykonane z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztywnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, skala pomiarową do 100 ml co 10 ml). Wyrób jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu. Opakowanie a'50 sztuk. Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

#### **Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 2: dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 4**

W nawiązaniu do postępowania zwracam się zapytaniem dotyczącym pakietu 18 pozycja 4 Elektroda do stymulacji zewnętrznej (do defibrylatorów typu Lifepak 20, dla dorosłych): Czy Zamawiający będzie wymagał by zaofertowane elektrody były akcesoriami oryginalnymi, dedykowanymi do Lifepak, zalecanymi do użycia przez producenta defibrylatorów?

#### **Odpowiedź nr 2:**

**Tak, Zamawiający będzie wymagał by zaofertowane elektrody były akcesoriami oryginalnymi, dedykowanymi do Lifepak, zalecanymi do użycia przez producenta defibrylatorów.**

#### **Pytanie nr 3: dotyczy § 7 ust 1 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

- 1) jednostronnego rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy określonej w § 6 ust. 2,
- 2) zwłoki w uzupełnieniu asortymentu w wysokości 0,5% wartości ceny brutto tej partii za każdy dzień zwłoki.

#### **Odpowiedź nr 3:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 4: dotyczy Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe :



Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT i opuszczenia narządu rodnego. Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm.

Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m<sup>2</sup>
- wielkość porów: 0,90 mm

Końce taśmy zwężone, zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachodzącej na siebie.

**Odpowiedź nr 4:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5: dotyczy Pakietu nr 27**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurą do podłączenia do respiratora o dł. 60 cm (z możliwością regulacji w zakresie 20-60 cm, z możliwością ustawienia również wymaganych 40 cm)?

**Odpowiedź nr 5:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6: dotyczy Pakietu nr 27**

Prosimy o możliwość odstąpienia od wymogu „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H<sub>2</sub>O i wydechowy 0,16 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g” są to parametry do określenia wyłącznie w warunkach laboratoryjnych i niemożliwe do uzyskania w typowych warunkach szpitalnych.

Wydajność ogrzewania powietrza jest parametrem bardzo zależnym od temperatury otoczenia i indywidualnych właściwości cieplnych pacjenta.



**Odpowiedź nr 6:**

**Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.**

**Pytanie nr 7: dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści oliwkę do masażu na bazie ozonowanej ekologicznej oliwy z oliwek, nietoksycznej, do stosowania bez przeciwwskazań do użycia i przeznaczoną dla wszystkich grup pacjentów.

Preparat jest wyrobem medycznym i zawiera wyłącznie naturalne składniki: ozonowaną oliwę z oliwek z witaminą E, olejek ze słodkich migdałów, olejek melisowy, diabelski pazur wyciąg z korzenia, ekstrakt z kwiatów arniki górskiej, ekstrakt z liści czarnej porzeczki. Przeznaczony jest do wykonywania masażu terapeutycznego m.in.: przy zapaleniu ścięgien, przykurczach, bólach stawów, obrzękach limfatycznych, „łokciu tenisisty”, w profilaktyce urazów i uszkodzeniu tkanki miękkiej, dla schładzania mięśni, redukcji kwasu mlekowego, dotlenienia tkanek.



**Odpowiedź nr 7:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 8: dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków, w których osłonę produktu po obu stronach stanowi dwuosiowo zorientowana folia polipropylenowa, pozostałe parametry spełnione.

**Odpowiedź nr 8:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9: dotyczy § 7 ust 4 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie mogła przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 2?

**Odpowiedź nr 9:**  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 10: dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2**

Prosimy o informację, czy respirator Oxylog VE300 wyposażony jest w opcję PLUS, czy też nie. Prosimy także o dopuszczenie zestawu oddechowego o dł. 1,5 m lub 3 m.

**Odpowiedź nr 10:**  
**Zamawiający informuje, że Respirator Oxylog VE300 nie jest wyposażony w opcję PLUS. Zamawiający dopuszcza zestaw oddechowy o dł. 1,5 m. Zamawiający nie dopuszcza zestawu oddechowego o dł. 3 m.**

**Pytanie nr 11: dotyczy § 7 ust 4 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

**Odpowiedź nr 11:**  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12: dotyczy Pakietu nr 14**

Czy Zamawiający dopuści sterylną wodę o pojemności 500 ml z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości względem 650 ml, z zastawką upustową o czułości 282 cm H<sub>2</sub>O, o możliwości zastosowania wody przez okres 30 dni potwierdzonej badaniami własnymi producenta, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź nr 12:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13: dotyczy Pakietu nr 18, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycięcie na przewód o wymiarach +/-3mm od podanych rozmiarów?

**Odpowiedź nr 13:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14: dotyczy Pakietu nr 18, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 56x42mm?

**Odpowiedź nr 14:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15: dotyczy Pakietu nr 18, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 43mm?

**Odpowiedź nr 15:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16: dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 1,83m?

**Odpowiedź nr 16:**  
**Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 17: dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o wadze 190g?

**Odpowiedź nr 17:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18: dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z rurą wydechową o długości 50cm?

**Odpowiedź nr 18:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19: dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pakowany w opakowanie papier-folia?

**Odpowiedź nr 19:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odpowiedź nr 20:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 21: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o podwyższonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor czarny, mikrotekstura na całej dłoni plus dodatkowa tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,02mm, na dłoni 0,08+/- 0,02mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 8N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odpowiedź nr 21:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 22: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?





**Odpowiedź nr 22:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 23: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, mikrotekstura na całej rękawicy plus dodatkowa tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1, w tym odporne na 2 kwasy na min. 5 poziomie, odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy min. na poziomie 1. Przebadane na min. 12 cytotatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.?

**Odpowiedź nr 23:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 24: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, o podwyższonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor różowy, mikrotekstura na całej dłoni plus dodatkowa tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na min. 12 cytotatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary S-L kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odpowiedź nr 24:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 25: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37cytotatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 250 szt. ( po 240 szt. dla rozmiaru XL), z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 400op.?

**Odpowiedź nr 25:**  
**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 26: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 10N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytotatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone



badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odpowiedź nr 26:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 27: dotyczy Pakietu nr 18, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o śr. 54mm?

**Odpowiedź nr 27:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28: dotyczy Pakietu nr 18, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wym. 56mmx42mm z otworem na przewód z przecięciem boku?



**Odpowiedź nr 28:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29: dotyczy Pakietu nr 18, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe z języczkiem o średnicy 43mm?

**Odpowiedź nr 29:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30: dotyczy Pakietu nr 24, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje cewników do podawania tlenu sterylnych?

**Odpowiedź nr 30:**

**Zamawiający nie oczekuje cewników sterylnych.**

**Pytanie nr 31: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców; o grubości na palcu 0,09mm, na dłoni 0,08mm, na mankiecie 0,06mm; AQL 1,5. Rękawice zgodne z normą EN ISO 20417, która zastąpiła normę EN 1041. Badanie na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min. 9 substancji na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź nr 31:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców. Rękawice zgodne z normą EN ISO 20417, która zastąpiła normę EN 1041. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź nr 32:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 33: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców; AQL 1,5. Klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii



III typ C. Zgodne z normą EN ISO 20417, która zastąpiła normę EN 1041. Badanie na przenikanie 5 substancji chemicznych, w tym min. 1 substancja na 6 poziomie odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1.

**Odpowiedź nr 33:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 34: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców, dostępnych w rozmiarach XS-L; grubość na dłoni 0,06mm, na mankiecie 0,05mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź nr 34:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź nr 35:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 36: dotyczy Pakietu nr 16, poz. 1-7**

Prosimy o doprecyzowanie ile sztuk uchwytów na rękawice Zamawiający wymaga.

**Odpowiedź nr 36:**

**Zamawiający wymaga sukcesywnego dostarczania 20 uchwytów potrójnych, 10 uchwytów pojedynczych oraz 8 uchwytów na rękawice wyciągane od spodu. Zamawiający wymaga by wszystkie uchwyty były w kolorze białym, kompatybilne z pudełkiem/opakowaniem dostarczanych rękawic diagnostycznych.**

**Pytanie nr 37: dotyczy Pakietu nr 27, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego do respiratora o długości 1,8 m i śr. 22mm, z kolankiem z portem luer i kapturkiem zabezpieczającym układ, z rurą wydechową do podłączenia respiratora o długości 50 cm, opór wdechowy 0,29 mbar i wydechowy 0,38 mbar przy przepływie 15l/min, do zestawu dołączony jest tester szczelności pozwalający zweryfikować integralność przegrody, mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, bez PVC i DEHP, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe?

**Odpowiedź nr 37:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 38: dotyczy Pakietu nr 19**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 19 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy tych produktów do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

**Odpowiedź nr 38:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 39: dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1, 2, 3, 9 i 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 19 poz. 1, 2, 3, 9, 10 formularza szczegółowej oferty cenowej tj.: membrana do kopułki ciśnieniowej, uszczelki do pokrywki, drem pompy do histeroskopii, dren pompy do używania z drenem wielorazowym, membrana do drenu do używania z drenem wielorazowym, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

**Odpowiedź nr 39:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 40: dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1, 2 i 3**

Czy w związku z tym, że opisane w pakiecie nr 19 poz. 1, 2, 3 formularza szczegółowej oferty cenowej wyroby nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny) Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zmiany stawki podatku VAT na 23%?



**Odpowiedź nr 40:****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie nr 41: dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1, 2, 7, 8 i 9**

Czy w związku z tym, że opisany w pakiecie nr 19 poz. 1, 2, 7, 8, 9 formularza szczegółowej oferty cenowej membrany, uszczelki, dreny płuczące, dreny pompy są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 10 szt. i nie są sprzedawane na sztuki, a dostarczane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk (1 op = 10 szt) Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania i skorygowanie wymaganej ilości w przeliczeniu na opakowania oraz podanie ceny jednostkowej netto i brutto za opakowanie?

**Odpowiedź nr 41:****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie nr 42: dotyczy Pakietu nr 19, poz. 3**

Czy w związku z tym, że opisany w pakiecie nr 19 poz. 3 formularza szczegółowej oferty cenowej dreny pompy są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 25 szt. i nie są sprzedawane na sztuki, a dostarczane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk (1 op = 25 szt) Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania i skorygowanie wymaganej ilości w przeliczeniu na opakowania oraz podanie ceny jednostkowej netto i brutto za opakowanie?

**Odpowiedź nr 42:****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie nr 43: dotyczy Pakietu nr 19, poz. 4**

Czy w związku z tym, że opisany w pakiecie nr 19 poz. 4 formularza szczegółowej oferty cenowej pętle tnące są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 6 szt. i nie są sprzedawane na sztuki, a dostarczane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 6 sztuk (1 op = 6 szt) Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania i skorygowanie wymaganej ilości w przeliczeniu na opakowania oraz podanie ceny jednostkowej netto i brutto za opakowanie?

**Odpowiedź nr 43:****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie nr 44: dotyczy Pakietu nr 19, poz. 10**

Czy w związku z tym, że opisany w pakiecie nr 19 poz. 10 formularza szczegółowej oferty cenowej membrany do drenu są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 20 szt. i nie są sprzedawane na sztuki, a dostarczane wyłącznie w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk (1 op = 20 szt) Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania i skorygowanie wymaganej ilości w przeliczeniu na opakowania oraz podanie ceny jednostkowej netto i brutto za opakowanie?

**Odpowiedź nr 44:****Zamawiający wyraża zgodę.****Pytanie nr 45: dotyczy Pakietu nr 19, poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10**

Czy w związku z tym, że opisane w pakiecie nr 19 poz. 1, 2, 7, 8, 9 formularza szczegółowej oferty cenowej membrany, uszczelki, dreny płuczące, dreny pompy są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 10 szt., poz. 3 dreny pompy w opakowania zbiorcze po 25 szt., poz. 4 pętle w opakowania zbiorcze po 6 szt., poz.10 membrany w opakowania zbiorcze po 20 szt. i nie są sprzedawane na sztuki, Zamawiający potwierdzi, że będzie składał zamówienia częściowe na pełne opakowania

**Odpowiedź nr 45:****Zamawiający potwierdza.****Pytanie nr 46: dotyczy § 7 ust 1 pkt 2 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za przekroczenie terminu na uzupełnienie asortymentu każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie do 0,5% wartości ceny brutto partii?

**Odpowiedź nr 46:****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 47: dotyczy § 7 ust 4 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną wysokość kar umownych zapisanych we wzorze umowy §7 ust.4 do 20% łącznego wynagrodzenia brutto?





**Odpowiedź nr 47:****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 48: dotyczy Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

**Odpowiedź nr 48:****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 49: dotyczy Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź nr 49:****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 50: dotyczy § 7 ust 1 pkt 1 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

1) jednostronnego rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% maksymalnej wartości umowy określonej w § 6 ust. 2;

**Odpowiedź nr 50:****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 51: dotyczy Pakietu nr 26**

Czy w Pakiecie nr 26 zamawiający dopuści olej silikonowy o poniższych właściwościach:

- Gęstość (w 22 °C): 0,98 g/cm<sup>3</sup>

- Lepkość (w 25°C) 1000–1500 mPas

- Współczynnik refrakcji (w 20°C) 1,40

pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź nr 51:****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie nr 52: dotyczy § 2 ust. 5 oraz § 9 ust. 2 pkt 1 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §2 ust. 5 projektu umowy oraz w §9 ust. 2 pkt 1) projektu umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu: „Jeżeli cena wyroby zastępczego będzie wyższa niż cena wyrobu ujętego w ofercie, Wykonawca będzie dostarczał wyrób zastępczy po aktualnej cenie rynkowej.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do realizowania umowy ze stratą. Jeśli cena zamiennika będzie wyższa niż towaru ujętego w umowie, Wykonawca będzie dostarczał zamiennik po aktualnej cenie rynkowej.

**Odpowiedź nr 52:****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 53: dotyczy § 6 ust. 3 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wynagrodzenie netto ustalone wg ust. 1 ma charakter stały, jest niezmiennie przez cały czas trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca może zagwarantować stałość cen netto, gdyż nie ma żadnego wpływu na wysokość stawki VAT składającej się na cenę brutto.

**Odpowiedź nr 53:****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 54: dotyczy § 7 ust. 1 i 2 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 1-2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:



- 1) jednostronnego rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy;
- 2) zwłoki w dostawie asortymentu w wysokości .....% wartości ceny brutto tej partii za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 8 ust. 1a pkt 1) i § 10 ust. 1 Umowy.”?

Uzasadnienie:

Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna bazować na wartości jeszcze niezamówionego asortymentu, w przeciwnym wypadku miałyby zawsze tę samą wielkość, niezależnie od stopnia realizacji umowy.

**Odpowiedź nr 54:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 55: dotyczy § 7 ust. 4 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Łączna maksymalna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości umowy, a w przypadku danej zwłoki – 10% wartości towarów pozostających w zwłoce.”?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy suma kar umownych powinna zostać obniżona do 20% wartości umowy, wyższa suma znacząco odbiega od wysokości ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego. Ponadto umowa powinna przewidywać osobny limit naliczania kar umownych dla danej zwłoki w dostawie.

**Odpowiedź nr 55:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 56: dotyczy § 8 ust. 1a Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §8 umowy ustęp nr 1a?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma żadnego wpływu na procedury zakupowe organizowane przez MSWiA. Skoro Zamawiający zawiera umowę to znaczy, że chce zakupić objęty nią towar. Ponadto Wykonawca kalkuluje swoją ofertę w oparciu o założenie, że umowa będzie obowiązywała przynajmniej przez okres wskazany w umowie.

**Odpowiedź nr 56:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 57: dotyczy § 9 ust. 2 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §9 ust. 2 projektu umowy punktów 3) i 4)?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie widzi podstaw do zmniejszenia jego wynagrodzenia.

**Odpowiedź nr 57:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 58: dotyczy § 9 ust. 3 pkt 1 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §9 ust. 3 pkt 1) projektu umowy oraz §9 ust. 4 pkt 1) umowy w ten sposób, że aktualna stawka VAT będzie stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami bez konieczności zawierania aneksu do umowy?

Uzasadnienie:

Strony nie mają żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług, która powinna być stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

**Odpowiedź nr 58:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 59: dotyczy § 9 ust. 4 pkt 5 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §9 ust. 4 pkt 5) projektu umowy w ten sposób, że:

- 1) Poziom zmiany cen lub kosztów wskazany w punkcie a) zostanie obniżony do 4%;
- 2) Obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie f), nie nastąpi poniżej ceny ofertowej?

Uzasadnienie:

- Oferta jest składana w warunkach niepewnej sytuacji gospodarczej, dlatego poziom zmiany kosztów wykonania zamówienia uprawniający do waloryzacji wynagrodzenia powinien zostać obniżony do 4%;
- Cena ofertowa obejmuje prognozy ewentualnych obniżek cen na rynku producenckim, dlatego obniżenie wynagrodzenia nie powinno następować poniżej tej kwoty;



**Odpowiedź nr 59:****Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie nr 60: dotyczy Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 dopuści:


Taśmę w osłonce z regulatorem do pozycjonowania, Materiał: polipropylen monofilamentowy, Długość: 50cm Szerokość: 1,2cm Grubość: 0,46 mm +/-10% Porowatość: 84% +/-5% Gramatura: 67g/m2 +/-10%, Grubość włókien: 120 um, Powierzchnia oczek: 0,23 mm<sup>2</sup>, Średnica oczek: 0,56mm.

Pętla na końcach wykonane z przędzy poliestrowej, pokryta osłonkami termokurczliwymi z silikonu i poliolefiny klasy medycznej. W centralnej części taśmy umieszczony element do pozycjonowania taśmy z możliwością korekty napięcia taśmy w następnej dobie po zabiegu.

**Odpowiedź nr 60:****Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie nr 61: dotyczy Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10?

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie - wymóg zapewnienia sterylności, brak osłonki w środku na odcinku 1,5 cm, gramatura 45 g/m2 (+/- 0,02 g/m2), grubość siatki 0,34 mm (=/- 1%), porowatość 55-60%, grubość nitki 150 μm (+/- 0,5 μm), rozmiar: dł. 45 cm (+/- 0,5 cm), szer. 1,1 cm, brzoży zakończone bezpiecznymi pętelkami

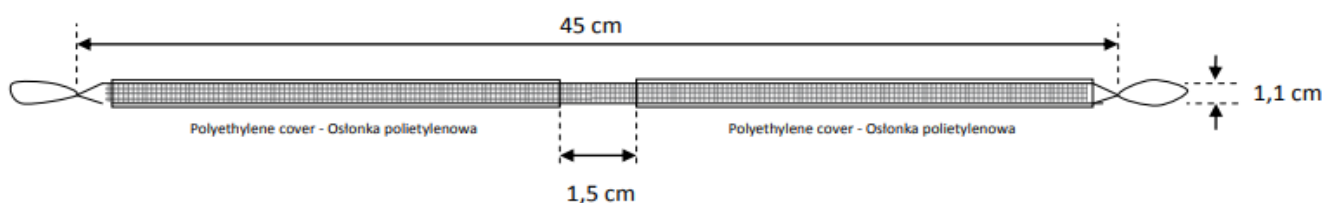

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

**Odpowiedź nr 61:****Zamawiający nie dopuszcza.**

**Z UPOWAŻNIENIA**  
**Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie**  
**Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych**  
**Luiza Reddig**

